



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 32/ZP/2024  
DZP/311/2024

Zgorzelec, dnia 09.10.2024r.

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

#### **Dotyczy przetargu na: Sukcesywne dostawy różnych materiałów do dializ.**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Pytanie 1 dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści cewnik czasowy do hemodializy dwuświatłowy z ramionami prostymi 12 i 14F w dostępnych długościach 15,20,24cm oraz z ramionami zakrzywionymi 12 i 14F w dostępnych długościach 15,20cm, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, przystosowany do kontroli podczas wprowadzania za pomocą RTG, USG, fluoroskopii końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów. W zestawie do implantacji.



#### **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 2 dot. pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści zestaw dializacyjny permanentny (stały) 15,5F, zakładany metodą Seldingera, wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzeplin. Zestaw, w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip). Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm do wyboru przez Zamawiającego



- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,
- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
- osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
- posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
- końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu


Zestaw: Iгла wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru

powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie 3 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik długoterminowy 14F długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm do wyboru przez Zamawiającego nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich wykonany z biokompatybilnego karbotanu cewnik odporny na rozpuszczalniki i na wszystkie powszechnie stosowane roztwory czyszczące na bazie jodu i alkoholu, wytrzymały na rozciąganie, elastyczny, odporny na załamania, posiadający solidne złącza typu luer i zaciski oznaczone kolorami, z nadrukiem objętości na ramionach, obrotowe skrzydełka do mocowania, miękka stopniowana końcówka cewnika ułatwia płynne wprowadzanie i zmniejsza stopień recyrkulacji,

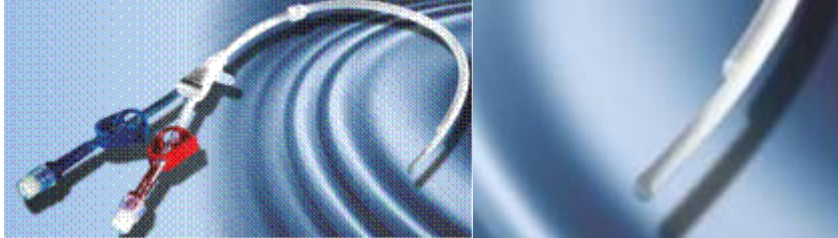

skład zestawu: 1 x cewnik, 1 x 18g x 7cm igła introduktora z zaworem bocznym 1 x 0.035" x 70cm przewodnik nitinolowy z końcówką J, 2 x rozszerzacz naczynia, 1 x introduktor z odrywaną osłonką, 1 x mandryn tunelowy 1 x strzykawka 10ml, 1 x Skalpel nr 11, 2 x Nasadki iniekcyjne, 1 x Bezszywowe urządzenie mocujące 2 x Opatrunek na ranę, 1 x Naklejka identyfikacyjna pacjenta

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

### (ZAPYTANIE NR 2)

#### Pytanie 1 dot. pakietu nr 4 poz. 3

Czy w Pakiecie 4 w pozycji 3 Zamawiający zezwoli na wycenę dializatora z błoną polisulfonową o powierzchni 2,2m<sup>2</sup>, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.**

#### Pytanie 2 dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy w Pakiecie 5 w pozycji 1 Zamawiający zezwoli na wycenę dializatora z klirensiem fosforanów przy Q<sub>b</sub>=300 ml/min ≥ 225, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.**

#### Pytanie 3 dot. pakietu nr 5 poz. 2

Czy w Pakiecie 5 w pozycji 2 Zamawiający zezwoli na wycenę dializatora z klirensiem fosforanów przy Q<sub>b</sub>=300 ml/min ≥ 244, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.**

### (ZAPYTANIE NR 3)

#### Pytanie 1 dot. pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych, średnica 11 FR i 13 FR długość 15 cm, 20 cm, 25 cm – ramiona proste lub zakrzywione do wyboru przez Zamawiającego

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia przewodnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **(ZAPYTANIE NR 4)**

##### **Pytanie 1 dot. pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający w PAKIECIE 10 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR o długościach

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 32 cm, długość całkowita 45 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 37 cm, długość całkowita 50 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **(ZAPYTANIE NR 5)**

##### **Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wydzielenie jako osobnego pakietu linii na 2 wkłucia pakowanych po 24 sztuki w opakowaniu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 2 dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dializatorów konfekcjonowanych w inny sposób, tj. po 24 szt. w opakowaniu (dla wszystkich 3 rodzajów) i spełniających wszystkie pozostałe parametry SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SWZ.**

#### **(ZAPYTANIE NR 6)**

##### **Pytanie 1 dot. projektu umowy § 6 ust. 1, 3**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 3:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
- 2) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 50 zł za każdy przypadek.
3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części niniejszej umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **(ZAPYTANIE NR 7)**

##### **Pytanie 1 dot. pakietu nr 2 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycjach 1 i 2 igły do hemodializy w rozmiarach 15-17G? Pozostałe wymagania bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 2 dot. pakietu nr 4 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycjach 1-3 dializatory niskoprzepływowe suche z błoną polieterosulfonową (PES), pakowane po 24 sztuki i pozwoli na przeliczenie zamawianej ilości opakowań ? Pozostałe wymagania bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**(ZAPYTANIE NR 8)**

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyjątkowych cewników Arrow z powłoką zawierającą chlorcheksydynę i sulfadiazynę srebra, która ma udowodnione licznymi badaniami, działanie nie tylko antybakteryjne ale też przeciwgrzybicze. 12F i 14F z otworami bocznymi. Pozostałe parametry bez zmian. W skład zestawu poza cewnikiem wchodzi prowadnica stalowa na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło (1x dla 12F i 2x dla 14F), skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Karina Suttor**  
**Specjalista ds.**  
**Zamówień Publicznych**

Z poważaniem  
**Z upoważnienia Dyrektora**  
**Radosław Jabłoński**  
**Z-ca Kierownika Działu**  
**Zamówień Publicznych**  
**i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa [https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_zgorzelec](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec)
- 2) A/a

---

Sprawę prowadzi: Karina Suttor  
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.p