



Poznań, dnia 11.03.2019 r.

Dz. Z. P. 02/29/19

Uczestnicy postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.02.2019r. 2019 /S 038 - 084992

WYJAŚNIENIE NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) wyjaśniam:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Część 12 - układ do podgrzewanej biernej tlenoterapii

Czy Zamawiający w części 1 pozycja nr 1 dopuści układ oddechowy zgodny z opisem w SIWZ jednakże długość wdechowego podgrzewanego wynosi 1,2 m?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę zakupu system taśmowy do operacyjnego leczenia WNM o następujących parametrach:

Pkt 1. Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o długości 44 cm i szerokości 1,2 cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 750-2073 μ m. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwzłowej, z pamięcią kształtu wzdłużną i poprzeczną. Gramatura 58 g/m². Grubość taśmy 0,47 mm. Taśma umieszczona w plastikowej osłonce;

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pkt 2. Dwie wielorazowe igły o średnicy ostrza 3,5 mm z uchwytami o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie do zakładania taśmy przez otwory zasłonowe. Igły z zakończeniem kotwicznym umożliwiającym połączenie z pętlami na końcach taśmy.

Odp: Zgodnie z SIWZ






Zestaw 3

Część nr 7, pozycja 1

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli igłę bez filtra o szlifie ołówkowym i otworem bocznym do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków? Należy zaznaczyć, że igła nie może być jednocześnie tępa i posiadać szlif ołówkowy.

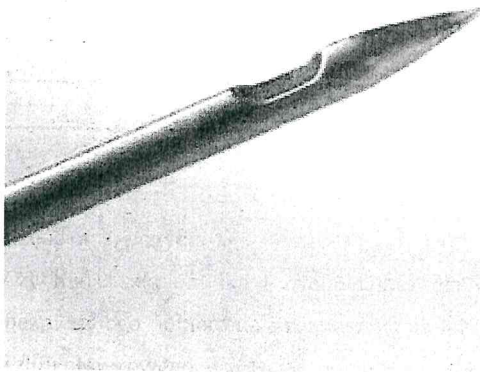

Odp: Tak, zamawiający miał na myśli igłę bez filtra o szlifie ołówkowym.

Część nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków bez filtra w rozmiarze 1,2 x 30 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp: Tak, dopuszczamy igłę w rozmiarze 1,2 x 30 mm, z bezwzględny zachowaniem pozostałych parametrów.

Część nr 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępownicy o długości ok. 52 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Odp: Tak, zamawiający dopuszcza.


Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń:

Wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów. Uniwersalne połączenie 22M/15F - 15M umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów, wersja rozciągliwa umożliwia zapamiętanie kształtu, podwójnie obrotowe kolanko, otwór do odsysania oraz bronchoskopii,

Odp: Zgodnie z SIWZ



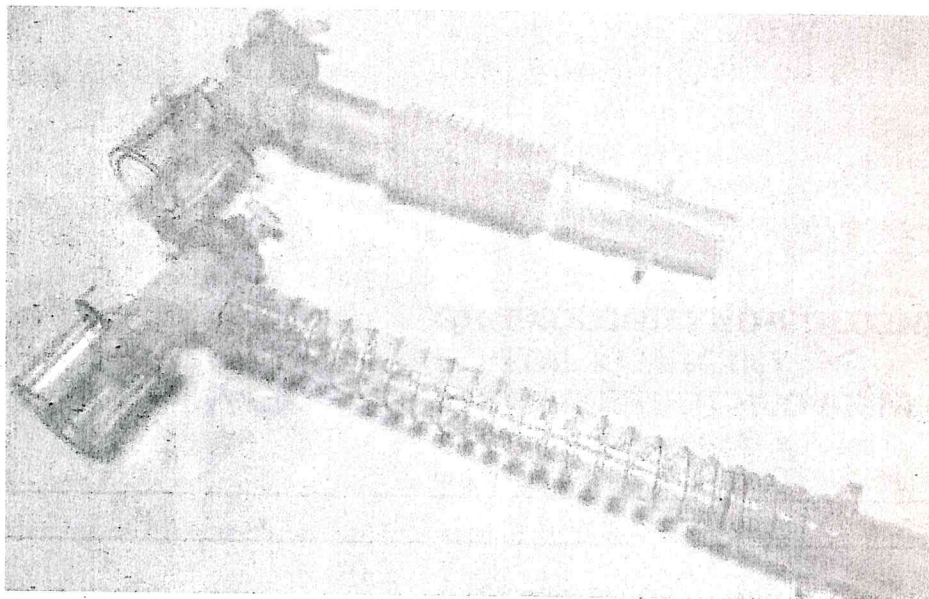

Zestaw 4

1) Dotyczy zapisu umowy:

Prosimy o zniesienie zapisu o realizacji dostaw w trybie awaryjnym w terminie 2 dni roboczych odnośnie części 19 i 20, gdyż asortyment ten wykorzystywany jest w operacjach planowanych i Zamawiający może zaplanować zamówienie ze standardowym 5dniowym wyprzedzeniem.

Odp: Zgodnie z SIWZ

2) Dotyczy zapisu umowy:

Prosimy o zniesienie zapisu o karze za każdy dzień opóźnienia w dostawie w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia.

Odp: Zamawiający nie znosi niniejszego zapisu umowy

3) Dotyczy Części 19 i 20:

W razie wezwania, prosimy o możliwość zaferowania próbek niesterylnych.

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza.

Zestaw 5

1. Dotyczy pakiet 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1, pozycji 1 wymiennika ciepła i wilgoci pakowanego po 20 szt. i możliwości przeliczenia/zmiany zapotrzebowania z 20 na 25 opakowań zbiorczych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala

dr Maciej Sobkowski