



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Znak sprawy: Te 2300-05/2024

Pleszew, dn. 14.02.2024r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Dostawa i montaż mebli i wyposażenia na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Oddział Ginekologiczny.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy Poz. 1 – Wózek zabiegowy

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby wózek zabiegowy posiadał atest higieniczny. Wózki zabiegowe nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 2

Dotyczy poz. 2 – Wózek anestezyjologiczny

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby wózek anestezyjologiczny posiadał atest higieniczny. Wózki anestezyjologiczne nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 3

Dotyczy poz. 3 – wózek do transportu chorych, poz. 4 - wózek do transportu chorych

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby wózki do transportu chorych posiadały atest higieniczny. Wózki transportowe nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 4

Dotyczy poz. 5 – wózek zabiegowy z kuwetami wieszakami na kosz

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby wózek zabiegowy z kuwetami posiadał atest higieniczny. Wózki zabiegowe nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 5

Dotyczy poz. 6 – Wózek wielopoziomowy z możliwością łączenia

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby wózek wielopoziomowy z możliwością łączenia posiadał atest higieniczny. Wózki wielopoziomowe nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 6

Dotyczy poz. 6 – Wózek wielopoziomowy z możliwością łączenia

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby wózek wielopoziomowy z możliwością łączenia posiadał deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Wózek ten nie jest wyrobem medycznym, ani nie posiada żadnych części napędzanych w sposób inny niż siła ludzkich mięśni, nie są mu także stawiane żadne wymagania określone w odrębnych normach czy przepisach. W związku z powyższym nie ma wymogu wydawania deklaracji zgodności dla powyższego wózka. Dodatkowo nie ma też wymogu wydawania dodatkowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w Polsce.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 7

Dotyczy poz. 7 – Podwójny zbieracz, poz. 8 – Pojedynczy zbieracz na odpady lub bieliznę brudną

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby zbieracze posiadały atest higieniczny. Zbieracze odpadów nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 8

Dotyczy poz. 7 – Podwójny zbieracz, poz. 8 – Pojedynczy zbieracz na odpady lub bieliznę brudną

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby zbieracze posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Zbieracze na odpady nie są wyrobem medycznym, ani nie posiadają żadnych części napędzanych w sposób inny niż siła ludzkich mięśni, nie są im także stawiane żadne wymagania określone w odrębnych normach czy przepisach. W związku z powyższym nie ma wymogu wydawania deklaracji zgodności dla powyższych zbieraczy. Dodatkowo nie ma też wymogu wydawania dodatkowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w Polsce.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 9

Dotyczy poz. 9 – Fotelik lekarski z oparciem

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby foteliki lekarskie posiadały atest higieniczny. Foteliki lekarskie nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 10

Dotyczy poz. 10 – Szafa metalowa na sprzęt do sprzątania

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby szafa metalowa posiadała atest higieniczny. Szafy tego rodzaju nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 11

Dotyczy poz. 10 – Szafa metalowa na sprzęt do sprzątania

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby szafy metalowe posiadały deklarację zgodności, deklarację CE oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Szafy tego rodzaju nie są wyrobem medycznym, ani nie posiadają żadnych części napędzanych w sposób inny niż siła ludzkich mięśni, nie są im także stawiane żadne wymogi określone w odrębnych normach czy przepisach. W związku z powyższym nie ma wymogu wydawania deklaracji zgodności dla powyższych szaf. Dodatkowo nie ma też wymogu wydawania dodatkowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w Polsce.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 12

Dotyczy poz. 11 – Wieszak listwowy 5 hakowy na obuwie, poz. 23 – Wieszak listwowy 5 hakowy

12. Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby wieszaki listwowe posiadały atest higieniczny. Wieszaki tego rodzaju nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 13

Dotyczy poz. 11 – Wieszak listwowy 5 hakowy na obuwie, poz. 23 – Wieszak listwowy 5 hakowy

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby wieszaki listwowe posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Wieszaki tego rodzaju nie są wyrobem medycznym, ani nie posiadają żadnych części napędzanych w sposób inny niż siła ludzkich mięśni, nie są im także stawiane żadne wymogi określone w odrębnych normach czy przepisach. W związku z powyższym nie ma wymogu wydawania deklaracji zgodności dla powyższych wieszaków. Dodatkowo nie ma też wymogu wydawania dodatkowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w Polsce.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 14

Dotyczy poz. 12 – Wózek do przewożenia zwłok

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie atestu higienicznego, który w swej treści nie wskazuje konkretnie na wózek do przewożenia zwłok, a obejmuje wyposażenie sekcyjne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia zwłok z atestem higienicznym obejmującym wyposażenie sekcyjne. Wózek musi spełniać pozostałe wymogi.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 15

Dotyczy poz. 12 – Wózek do przewożenia zwłok

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby wózek do przewożenia zwłok posiadał deklarację zgodności, deklarację CE oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Wózek ten nie jest wyrobem medycznym, ani nie posiada żadnych części napędzanych w sposób inny niż siła ludzkich mięśni, nie są mu także stawiane żadne wymogi określone w odrębnych normach czy przepisach. W związku z powyższym nie ma wymogu wydawania deklaracji zgodności dla powyższego wózka. Dodatkowo nie ma też wymogu wydawania dodatkowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w Polsce.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 16

Dotyczy poz. 13 – Szafy

Czy Zamawiający dopuści do przedstawienia atesty higieniczne na płytę wiórową, z której wykonana jest szafa?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy poz. 13 – Szafy

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby szafy posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Do mebli nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 18

Dotyczy poz. 13 – Szafy

Proszę o potwierdzenie, że jako deklarację zgodności z PN-EN 14073-2:2006 Zamawiający ma na myśli świadectwo zgodności z wymaganiami normy PN-EN 14073-2:2006 wystawione przez niezależną od producenta akredytowaną jednostkę badawczą?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19

Dotyczy poz. 14 – Sofa głęboka.

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby sofy posiadały atest higieniczny. Sofy i meble tapicerowane nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 20

Dotyczy poz. 14 – Sofa głęboka

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie Atestu higienicznego na tkaninę, którą będą tapicerowane sofy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 21

Dotyczy poz. 14 – Sofa głęboka

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby sofy posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Do mebli nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 22

Dotyczy poz. 15 – Fotel obrotowy z zagłówkiem, oparcie w całości tapicerowane

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby fotele obrotowe pracownicze oraz fotele obrotowe z zagłówkiem posiadały atest higieniczny. Fotele obrotowe i meble tapicerowane nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 23

Dotyczy poz. 15 – Fotel obrotowy z zagłówkiem, oparcie w całości tapicerowane

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie atestu higienicznego na tkaninę, którą będą tapicerowane fotele obrotowe?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy poz. 15 – Fotel obrotowy z zagłówkiem, oparcie w całości tapicerowane

Proszę o potwierdzenie, że deklaracja zgodności z normą PN-EN 1021:1:2 – dotyczącą trudnopalności dotyczy oświadczenia producenta, że do produkcji danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnopalnych.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25

Dotyczy poz. 15 – Fotel obrotowy z zagłówkiem, oparcie w całości tapicerowane

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby fotele obrotowe z zagłówkiem oraz fotele obrotowe pracownicze posiadały deklarację zgodności, deklarację CE oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Do krzeseł nie wydaje się deklaracji zgodności, nie znakuje się ich także znakiem CE w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 26

Dotyczy poz. 15 – Fotel obrotowy z zagłówkiem, oparcie w całości tapicerowane

Proszę o potwierdzenie, że jako deklarację zgodności z normą PN-EN 1335-1 – dotyczącą zachowania ergonomii, Zamawiający ma na myśli przedstawienie protokołu oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN-EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 27

Dotyczy poz. 15 – Fotel obrotowy z zagłówkiem, oparcie w całości tapicerowane

Proszę o potwierdzenie, że jako deklarację zgodności z normą PN-EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019, Zamawiający ma na myśli certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami norm PN-EN 1335-1:2002 oraz PN-EN 1335-2:2019 wystawiony przez niezależną od producenta jednostkę badawczą?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28

Dotyczy poz. 16 – Stolik z kwadratowym blatem.

Czy Zamawiający dopuści do przedstawienia atesty higieniczne na płytę wiórową, z której wykonany jest blat stolika?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Dotyczy poz. 16 – Stolik z kwadratowym blatem

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby stoliki posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Do mebli nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 30

Dotyczy poz. 17 – Taboret

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby taborety posiadały atest higieniczny. Taborety i siedziska nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higienicznym.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 31

Dotyczy poz. 17 – Taboret

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie atestu higienicznego na tkaninę, którą tapicerowane będą taborety?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy poz. 17 – Taboret

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby taborety posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Do mebli tapicerowanych nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 33

Dotyczy poz. 18 – Nadstawka szafy żaluzjowej 1000

Dotyczy poz. 26 – Szafa żaluzjowa 1000

Dotyczy poz. 35 – Szafa żaluzjowa 800

Dotyczy poz. 36 – Nadstawka szafy żaluzjowej 800

Dotyczy poz. 37 – Szafa żaluzjowa 600

Dotyczy poz. 38 – Nadstawka szafy żaluzjowej 600

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby szafy żaluzjowe oraz nadstawki szaf żaluzjowych posiadały atest higieniczny. Szafy i nadstawki tego rodzaju nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 34

Dotyczy poz. 18 – Nadstawka szafy żaluzjowej 1000

Dotyczy poz. 26 – Szafa żaluzjowa 1000

Dotyczy poz. 35 – Szafa żaluzjowa 800

Dotyczy poz. 36 – Nadstawka szafy żaluzjowej 800

Dotyczy poz. 37 – Szafa żaluzjowa 600

Dotyczy poz. 38 – Nadstawka szafy żaluzjowej 600

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby szafy żaluzjowe oraz nadstawki szaf żaluzjowych posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Szafy oraz nadstawki tego rodzaju nie są wyrobem medycznym, ani nie posiadają żadnych części napędzanych w sposób inny niż siła ludzkich mięśni, nie są im także stawiane żadne wymogi określone w odrębnych normach czy przepisach. W związku z powyższym nie ma wymogu wydawania deklaracji zgodności dla powyższych szaf i nadstawek. Dodatkowo nie ma też wymogu wydawania dodatkowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w Polsce.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 35

Dotyczy poz. 19 – Chłodziarka 35.

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby chłodziarki posiadały atest higieniczny. Dla chłodziarek nie wydaje się tego typu atestów więc wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 36

Dotyczy poz. 20 – Krzesło z podłokietnikiem

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby krzesła z podłokietnikiem posiadały atest higieniczny. Krzesła i meble tapicerowane nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 37

Dotyczy poz. 20 – Krzesło z podłokietnikami

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie atestu higienicznego na tkaninę, którą będą tapicerowane krzesło?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Dotyczy poz. 20 – Krzesło z podłokietnikami

Proszę o potwierdzenie, że deklaracja zgodności z normą PN-EN 1021:1:2 – dotycząca trudnopalności dotyczy oświadczenia producenta, że do produkcji danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnopalnych.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 39

Dotyczy poz. 20 – Krzesło z podłokietnikami

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby krzesła z podłokietnikami posiadały deklarację zgodności, deklarację CE oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Do krzesel nie wydaje się deklaracji zgodności, nie znakuje się ich także znakiem CE w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 40

Dotyczy poz. 21 – Fotel okolicznościowy

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby fotele okolicznościowe posiadały atest higieniczny. Meble tapicerowane nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 41

Dotyczy poz. 21 – Fotel okolicznościowy

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie atestu higienicznego na tkaninę, którą tapicerowane będą fotele?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Dotyczy poz. 21 – Fotel okolicznościowy

Proszę o potwierdzenie, że deklaracja zgodności z normą PN-EN 1021:1:2 – dotycząca trudnopalności w przypadku fotela okolicznościowego odnosi się do zaoferowanej tapicerki.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43

Dotyczy poz. 21 – Fotel okolicznościowy

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby fotele okolicznościowe posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Dla mebli tapicerowanych nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 44

Dotyczy poz. 22 – Sofa nierozkładana dla 3 osób

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby sofy posiadały atest higieniczny. Meble tapicerowane nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 45

Dotyczy poz. 22 – Sofa nierozkładana dla 3 osób

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie atestu higienicznego na tkaninę, którą tapicerowane będą sofy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Dotyczy poz. 22 – Sofa nierozkładana dla 3 osób

Proszę o potwierdzenie, że deklaracja zgodności z normą PN-EN 1021:1:2 – dotycząca trudnopalności dotyczy oświadczenia producenta, że do produkcji danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnopalnych.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47

Dotyczy poz. 22 – Sofa nierozkładana dla 3 osób

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby sofy posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Dla mebli tapicerowanych nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 48

Dotyczy poz. 22 – Sofa nierozkładana dla 3 osób

Proszę o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymagając deklaracji zgodności z normą PN EN 16139:013_07, ma na myśli normę PN-EN 16139:2013_07.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 49

Dotyczy poz. 22 – Sofa nierozkładana dla 3 osób

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymagając deklaracji zgodności z normą (...) PN EN 178:2012, ma na myśli normę PN-EN 1728:201. Norma PN-EN 178 dotyczy tworzyw sztucznych – oznaczania ich właściwości przy zginaniu – nie ma ona zastosowania do mebli.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 50

Dotyczy poz. 22 – Sofa nierozkładana dla 3 osób

Proszę o potwierdzenie, że jako deklarację zgodności z normą PN-EN 16139:013_07, (...) w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych, Zamawiający ma na myśli Świadectwo z badań potwierdzające zgodność z wymaganiami norm PN-EN 1728:2012, PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1022:2007, PN-EN 1730:2013_04, PN-EN 12521:2009?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 51

Dotyczy poz. 24 – Szafa ubraniowa 4 osobowa dwupoziomowa na nóżkach

Dotyczy poz. 25 – Szafa ubraniowa 6 osobowa dwupoziomowa na nóżkach

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby szafki ubraniowe posiadały atest higieniczny. Szafki metalowe nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 52

Dotyczy poz. 24 – Szafa ubraniowa 4 osobowa dwupoziomowa na nóżkach

Dotyczy poz. 25 – Szafa ubraniowa 6 osobowa dwupoziomowa na nóżkach

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby szafki ubraniowe posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Dla szafek ubraniowych nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 53

Dotyczy poz. 27 – Krzesło w całości tworzywowe

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby krzesła w całości tworzywowe posiadały atest higieniczny. Krzesła nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 54

Dotyczy poz. 27 – Krzesło w całości tworzywowe

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby krzesła w całości tworzywowe posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Dla krzesel nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 55

Dotyczy poz. 27 – Krzesło w całości tworzywowe

Proszę o potwierdzenie, że jako deklarację zgodności z normą PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2005, Zamawiający ma na myśli świadectwo z badań potwierdzające zgodność z wymaganiami norm PN EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2005 wystawione przez niezależną od producenta jednostkę badawczą.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 56

Dotyczy poz. 28 – Biurko pracownicze.

Czy Zamawiający dopuści do przedstawienia atest higieniczny na płytę wiórową, z której wykonany jest blat biurka?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Dotyczy poz. 28 – Biurko pracownicze

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby biurka posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Do mebli nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 58

Dotyczy poz. 28 – Biurko pracownicze

Proszę o potwierdzenie, że jako deklarację zgodności z normą PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, Zamawiający ma na myśli świadectwo zgodności z wymaganiami norm PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527 2+A1:2019-08 wystawione przez niezależną od producenta jednostkę badawczą?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 59

Dotyczy poz. 29 – Kontener mobilny

Czy Zamawiający dopuści do przedstawienia atest higieniczny na płytę wiórową, z której wykonany jest kontener?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Dotyczy poz. 29 – Kontener mobilny

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby kontenery posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Do mebli nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 61

Dotyczy poz. 29 – Kontener mobilny

Proszę o potwierdzenie, że jako deklarację zgodności z PN-EN 14073-2:2006 Zamawiający ma na myśli świadectwo zgodności z wymaganiami normy PN-EN 14073-2:2006 wystawione przez niezależną od producenta akredytowaną jednostkę badawczą?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 62

Dotyczy poz. 30 – Szafa skrytkowa

Czy Zamawiający dopuści do przedstawienia atesty higieniczne na płytę wiórową, z której wykonana jest szafa?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Dotyczy poz. 30 – Szafa skrytkowa

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby szafy posiadały deklarację zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Do mebli nie wydaje się deklaracji zgodności w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 64

Dotyczy poz. 31 – Wanna z podnośnikiem.

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby wanna posiadała atest higieniczny. Wanny nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 65

Dotyczy poz. 32 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby szafka posiadała atest higieniczny. Szafki nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 66

Dotyczy poz. 33 – Łóżeczko noworodkowe.

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby łóżeczko posiadało atest higieniczny. Łóżeczka nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 67

Dotyczy poz. 34 – Fotel obrotowy pracowniczy

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby fotele obrotowe pracownicze oraz fotele obrotowe z zagłówkiem posiadały atest higieniczny. Fotele obrotowe i meble tapicerowane nie są poddawane procedurze atestacji pod kątem higieniczności, w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 68

Dotyczy poz. 34 – Fotel obrotowy pracowniczy

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie atestu higienicznego na tkaninę, którą będą tapicerowane fotele obrotowe?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69

Dotyczy poz. 34 – Fotel obrotowy pracowniczy

Proszę o potwierdzenie, że deklaracja zgodności z normą PN-EN 1021:1:2 – dotyczącą trudnopalności dotyczy oświadczenia producenta, że do produkcji danej partii siedzisk zastosuje piankę o właściwościach trudnopalnych.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 70

Dotyczy poz. 34 – Fotel obrotowy pracowniczy

Proszę Zamawiającego o rezygnację z wymogu, aby fotele obrotowe z zagłówkiem oraz fotele obrotowe pracownicze posiadały deklarację zgodności, deklarację CE oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce. Do krzeseł nie wydaje się deklaracji zgodności, nie znakuje się ich także znakiem CE w związku z czym powyższy wymóg nie ma uzasadnienia.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 71

Dotyczy poz. 34 – Fotel obrotowy pracowniczy

Proszę o potwierdzenie, że jako deklarację zgodności z normą PN-EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019, Zamawiający ma na myśli certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami norm PN-EN 1335-1:2002 oraz PN EN 1335-2:2019 wystawiony przez niezależną od producenta jednostkę badawczą?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 72

Dotyczy treści SWZ rozdział V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH – ZADANIE 2:

Dotyczy poz. 1 – Meble o konstrukcji płytowej

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie atestu higienicznego obejmującego cały system mebli? Atest na system mebli potwierdza, że materiały z których wykonane są meble również są atestowane pod kątem higieniczności.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73

Dotyczy poz. 1 – Meble o konstrukcji płytowej

Proszę o rezygnację przez Zamawiającego z wymogu przedstawienia deklaracji zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce, dla mebli nie wydaje się tego rodzaju deklaracji. Meble nie są wyrobem medycznym, ani nie posiadają żadnych części napędzanych w sposób inny niż siła ludzkich mięśni, nie są im także stawiane żadne wymogi określone w odrębnych normach czy przepisach. Dodatkowo nie ma też wymogu wydawania dodatkowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w Polsce.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 74

Dotyczy poz. 2 – Meble medyczne

Proszę o rezygnację przez Zamawiającego z wymogu przedstawienia deklaracji zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce, dla mebli nie wydaje się tego rodzaju deklaracji. Meble nie są wyrobem medycznym, ani nie posiadają żadnych części napędzanych w sposób inny niż siła ludzkich mięśni, nie są im także stawiane żadne wymogi określone w odrębnych normach czy przepisach. Dodatkowo nie ma też wymogu wydawania dodatkowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w Polsce.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 75

Dotyczy poz. 3 – Lada

Proszę o rezygnację przez Zamawiającego z wymogu przedstawienia deklaracji zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce, dla mebli (ład) nie wydaje się tego rodzaju deklaracji. Meble, w tym lada nie są wyrobem medycznym, ani nie posiadają żadnych części napędzanych w sposób inny niż siła ludzkich mięśni, nie są im także stawiane żadne wymogi określone w odrębnych normach czy przepisach. Dodatkowo nie ma też wymogu wydawania dodatkowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w Polsce.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 76

Dotyczy poz. 3 – Lada

Zamawiający wymaga przedstawienia wizualizacji przykładowego wykonania lada dla wymiarów ze specyfikacji, czy w związku z tym Zamawiający udostępni rzuty pomieszczenia, w którym ma zostać zamontowana lada?

Odp.: Tak, Zamawiający załączy PDF z rzutem pomieszczenia gdzie zlokalizowana będzie lada.

Pytanie 77

Dotyczy poz. 3 – Lada

Proszę o potwierdzenie, że dla powyższej wizualizacji Zamawiający nie oczekuje pobrania rzeczywistych pomiarów na etapie złożenia oferty i że wizualizacja ma mieć charakter jedynie poglądowy.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 78

Dotyczy poz. 4 - Szafa ambulatoryjna.

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie atestu higienicznego obejmującego cały system mebli? Atest na system mebli potwierdza, że materiały z których wykonane są meble również są atestowane pod kątem higieniczności.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79

Dotyczy poz. 4 – Szafa ambulatoryjna

Proszę o rezygnację przez Zamawiającego z wymogu przedstawienia deklaracji zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce, dla mebli nie wydaje się tego rodzaju deklaracji. Meble nie są wyrobem medycznym, ani nie posiadają żadnych części napędzanych w sposób inny niż siła ludzkich mięśni, nie są im także stawiane żadne wymogi określone w odrębnych normach czy przepisach. Dodatkowo nie ma też wymogu wydawania dodatkowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu w Polsce.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie 80

Dotyczy poz. 4 – Szafa ambulatoryjna

Zamawiający wymaga przedstawienia wizualizacji przykładowego wykonania lada dla wymiarów ze specyfikacji. Proszę o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i zapis ten w pozycji 4 dotyczącej szafy ambulatoryjnej został umieszczony przypadkowo.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 81

Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych

Dotyczy: Wózek do transportu chorych

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w pkt. 2 tabeli zapisu „Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe”. Zapis ten odnosi się do łóżek, a nie do przedmiotu zamówienia jakim są wózki do transportu chorych.

Odp.: Doszło do omyłki pisarskiej, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

Pytanie 82

Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych

Dotyczy: Wózek do transportu chorych

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu z pkt. 4 tabeli „Funkcja przedłużania leża o min 15 cm”. Zapis ten odnosi się do łóżek, a nie do przedmiotu zamówienia jakim są wózki do transportu chorych.

Odp.: Doszło do omyłki pisarskiej, Zamawiający wykreśla w/w zapis.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 83

Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych

Dotyczy: Wózek do transportu chorych

Prosimy Zamawiającego w pkt. 15 tabeli regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowanej za pomocą dźwigni zlokalizowanej od strony nóg pacjenta.

Odp.: Zamawiający wymaga sterowania w/w funkcjami za pomoc dźwigni zlokalizowanej o strony nóg pacjenta.

Pytanie 84

Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych

Dotyczy: Wózek do transportu chorych

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka z hamulcem centralnym sterowanym jedną stalową, chromowaną rurą – obejmą zlokalizowaną nad kołami od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy? Rozwiązanie takie jest niezwykle wygodne dla personelu.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85

Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych

Dotyczy: Wózek do transportu chorych

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka posiadającego 2 niezależne części osłony podstawy wykonane z ABS, w tym 1 z półką (wytłoczeniem na rzeczy pacjenta), ale bez miejsca na butlę z tlenem. W tym rozwiązaniu zastosowano uchwyt na butlę umieszczony pod leżem wózka.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86

Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych

Dotyczy: Wózek do transportu chorych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający zamiast tworzywowej osłony podwozia metalowy kosz na rzeczy pacjenta, oraz kosz na butlę z tlenem montowany pod leżem wózka?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87

Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych

Dotyczy: Wózek do transportu chorych

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwozia zabudowanego osłoną z tworzywa sztucznego?

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od w/w wymogu.

Pytanie 88

Dotyczy: Wózek zabiegowy 2 błaty góra i dół.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka posiadającego maksymalne obciążenie min. 20 kg.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 89

Dotyczy: Wózek zabiegowy 2 błaty góra i dół

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka z obciążeniem biału min. 10 kg.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 90

Dotyczy: Wózek zabiegowy z kuwetami i wieszakiem na kosz

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka posiadającego maksymalne obciążenie min. 20 kg.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 91

Dotyczy: Wózek zabiegowy z kuwetami i wieszakiem na kosz

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wózka z obciążeniem blatu min. 10 kg.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 92

Dotyczy: Fotelik lekarski z oparciem

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fotelika z zakresem regulacji od 590 mm do 750 mm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 93

Dotyczy: Fotelik lekarski z oparciem

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania fotelika z zakresem regulacji od 590 mm do 790 mm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 94

Pytania do Zamawiającego dot. Pakietu nr 1


Dot. Zał. 37 i 38. Szafa żaluzjowa 600 i nadstawka do szafy żaluzjowej 600.

Czy Zamawiający dopuści szafy metalowe z drzwiami skrzydłowymi polskiego producenta o poniższej specyfikacji:

- Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm.
- Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami.
- Półki przestawne co 25 mm dostosowane do tacek zawieszkowych.
- Szafa wyposażona w zestaw stópek regulujących, umożliwiających wypoziomowanie szafy na nierównej powierzchni.
- Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg.
- Drzwi osadzone w korpusie na zawiasie trzpieniowej.
- Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym.
- Ryglowanie szaf w 2 punktach (górze i dół drzwi).
- Szafa spełnia wymogi przechowywania dokumentów RODO.
- Możliwość wyboru spośród 16 kolorów zarówno frontu jak i korpusu bez dodatkowej opłaty.
- 5 lat gwarancji.

Wymiary: szafa – 600 x 435 x 1990 mm (szer. X gł. X wys.)

Nadstawka do szafy – 600 x 435 x 465 mm (szer. X gł. X wys.)



Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 95

Dot. zał. 35 i 36 – szafa żaluzjowa 800 i nadstawka do szafy żaluzjowej 800.

Czy Zamawiający dopuści szafy metalowe z drzwiami skrzydłowymi polskiego producenta o poniższej specyfikacji:

- Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm.
- Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami.
- Półki przestawne co 25 mm dostosowane do tacek zawieszkowych.
- Szafa wyposażona w zestaw stópek regulujących, umożliwiających wypoziomowanie szafy na nierównej powierzchni.
- Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg.
- Drzwi osadzone w korpusie na zawiasie trzpieniowej.
- Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym.
- Ryglowanie szaf w 2 punktach (górze i dół drzwi).
- Szafa spełnia wymogi przechowywania dokumentów RODO.
- Możliwość wyboru spośród 16 kolorów zarówno frontu jak i korpusu bez dodatkowej opłaty.
- 5 lat gwarancji.
- Wymiary: szafa – 800 x 435 x 1990 mm (szer. X gł. X wys.)
- **Nadstawka do szafy – 800 x 435 x 465 mm (szer. X gł. X wys.)**



Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 96


Dot. Zał. 26 i 18 – szafa żaluzjowa 1000 i nadstawka szafy żaluzjowej 1000

Czy Zamawiający dopuści szafę metalową z drzwiami żaluzjowymi polskiego producenta o następującej specyfikacji:

- Drzwi żaluzjowe wykonane są z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym z 2 kluczami.
- Korpus szafy wykonany ze stali
- Półki przystosowane do zawieszania teczek zawieszkowych.
- Szafa wyposażona w zestaw stópek regulujących, umożliwiających wypoziomowanie szafy na nierównej powierzchni.
- Maksymalne obciążenie półki – do 65 kg.
- Możliwość wyboru koloru korpusu spośród 16 kolorów.
- Możliwość wyboru spośród 6 rodzajów kolorów drzwi żaluzjowych.
- 5 lat gwarancji.

Wymiar szafy: 1000 x 435 x 1990 mm (szer. X gł. X wys.)

Wymiar nadstawki: 1000 x 435 x 465 mm (szer. X gł. X wys.)

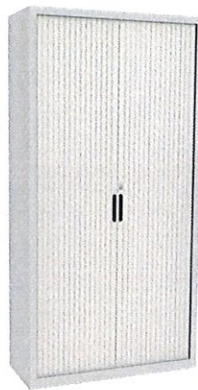

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 97

Dot. Szafa ubraniowa 4 osobowa dwupoziomowa na nóżkach.

Czy Zamawiający dopuści szafę metalową ubraniową 4 osobową dwupoziomową polskiego producenta o następującej specyfikacji:

- Wentylacja szafy odbywa się poprzez perforację WEMO - system otworów wentylacyjnych o nowoczesnym designie (zastrzeżony znak przemysłowy).
- Wykonana z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, pokrytej farbą proszkową.
- Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
- Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych wpływa na sztywność konstrukcji.
- Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie.
- Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik.
- Szafa posiada znak bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który poświadcza troskę o zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika.
- Możliwość wyboru spośród 16 kolorów frontu oraz korpusu bez dodatkowej opłaty.
- 5 lat gwarancji.

Wymiary szafy bez nóżek: 60 x 50 x 180 cm

Szafa może być posadowiona na nóżkach : Wymiary szafy posadowionej na nóżkach: 60 x 50 x 194 cm



Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 98


Dot. Szafa ubraniowa 6 osobowa dwupoziomowa na nóżkach.

Czy Zamawiający dopuści szafę metalową ubraniową 6 osobową dwupoziomową polskiego producenta o następującej specyfikacji:

- Wentylacja szafy odbywa się poprzez perforację WEMO - system otworów wentylacyjnych o nowoczesnym designie (zastrzeżony znak przemysłowy).
- Wykonana z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, pokrytej farbą proszkową.
- Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
- Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych wpływa na sztywność konstrukcji.
- Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie.
- Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik.
- Szafa posiada znak bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który poświadcza troskę o zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika.
- Możliwość wyboru spośród 16 kolorów frontu oraz korpusu bez dodatkowej opłaty.
- 5 lat gwarancji.

Wymiary szafy bez nóżek: 90 x 50 x 180 cm

Szafa może być posadowiona na nóżkach : Wymiary szafy posadowionej na nóżkach: 90 x 50 x 194 cm

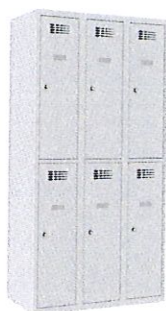

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 99



Dot. Szafa metalowa na sprzęt do sprzątania

Czy Zamawiający dopuści szafę gospodarczą polskiego producenta o następującej specyfikacji:

- Szafa gospodarcza jest przeznaczona do pomieszczeń wewnętrznych suchych i wentylowanych.
- Szafa dostarczana jest w całości i nie wymaga składania.
- 5 lat gwarancji.
- Wzmocnienie dające dużą sztywność drzwi.
- Przegroda pionowa oraz półki są na stałe nitowane do korpusu.
- Szafa jest wentylowana.
- Dostępna w 16 kolorach z palety RAL bez dodatkowej dopłaty.
- Drzwi zamykane wspólnym zamkiem, ryglowane w 2 punktach, z dwoma kluczami w zestawie.
- Otwory w ścianach bocznych służą do łączenia ze sobą, otwory w ścianie tylnej do przykręcania do ściany.
- Konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmocniana spawami, które usztywniają i wzmocniają konstrukcję.
- Korpus wykonany z blachy o gr. 0,6 – 0,8 mm
- Drzwi wykonane z blachy o gr. 0,6 mm
- Rama wykonana z blachy o gr. 0,6 mm
- Wyposażenie szafy: 2 dodatkowe haczyki oraz uchwyty na szczotki - przedział na wiadro i szczotki, 4 półki

Wymiar szafy gospodarczej: 60 x 50 x 180 cm

możliwość posadowienia szafy na nóżkach. Wymiar szafy na nóżkach: 60 x 50 x 194 cm



Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 100

1. Dot. Łóżeczka dla noworodków.

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o poniższych parametrach:

1. Wymiary zewnętrzne całego wózka [mm]: min.: 795 x 480 x 980 [długość x szerokość x wysokość]
2. Wymiary wewnętrzne kojca [mm]:
min.: 645 x 410 x 220 [długość x szerokość x wysokość]
3. Wymiary wewnętrzne materacyka [mm]:
min.: 610 x 380 x 50 [długość x szerokość x wysokość]

STELAŻ:

Wykonany ze stali nierdzewnej chromowanej (stal badana na zawartość soli chromu zredukowana do wartości 0,1 ug/cm² w procesie CR +3), pozbawiony związków mutagennych i rakotwórczych.

4. z funkcją najazdu – konstrukcja stelaża umożliwia:
 - najeżdżanie kojcem nad łóżko matki,
 - przechowywanie łóżeczek w systemie najazdowym poprzez wsunięcie jednego stelaża w drugi stelaż, w celu zmniejszenia powierzchni magazynowej zajmowanej przez łóżeczka
5. Mobilna podstawa z 4 kołami o średnicy 110 mm
6. Pozycja trendelenburga 12 stopni(+/- 2%)
7. 4 kółka o średnicy 110 mm wykonane z polipropylenu nałożonych na łożyskach ślizgowych (w tym 2 z hamulcem)
8. Kojec z przezroczystego tworzywa, gdzie wszystkie krawędzie zagłębienia i wypuklenia mają łagodne zaokrąglone kształty .
9. Kojec wyposażony w materacyk (pianka poliuretanowa, tkanina wodoszczelna, bakteriostatyczna, niepalna, charakteryzująca się wysoką oddychalnością)
10. Powierzchnie wózka łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.
11. Wyrób zgłoszony jako wyrób medyczny do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Zdjęcie poglądowe:



Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 101

Dot. Wanny z podnośnikiem

Czy Zamawiający dopuści wannę o poniższej specyfikacji:

wanna pielęgnacyjna o zaawansowanej konstrukcji, specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do kąpieli pielęgnacyjnych i mycia pacjentów w szpitalach oraz domach opieki, a także w placówkach opieki długoterminowej. Wbudowany mechanizm regulacji wysokości wanny Bathaid ułatwia personelowi wykonywanie czynności higienicznych związanych z codzienną pielęgnacją pacjenta.

Cechy charakterystyczne:

- ergonomiczna konstrukcja, specjalnie wyprofilowana niecka z podporami ramion, przelew z pokrętkiem do zamykania odpływu,
- elektryczne podnoszenie i opuszczanie niecki wanny z regulacją w zakresie 40 cm (siłowniki firmy Linak), obsługa funkcji podnoszenia i opuszczania niecki wanny za pomocą panelu stałego na koronie wanny i/lub pilota ręcznego (opcjonalnie z autoryzacją dostępu), który umożliwi podnoszenie i opuszczanie niecki wanny z dwoma różnymi prędkościami podnoszenia/opuszczania,
- wbudowany układ dezynfekcji wanny, słuchawka przysznica do splukiwania pacjenta,
- uchwyty,
- zagłówki,
- podpórka do nóg regulowana w 3 pozycjach, panel stały do regulacji wysokości.

Wanna dostępna jest w dwóch wersjach:

ECONOMY

Wyposażenie podstawowe:

- bateria termostatyczna wannowa z wbudowaną wylewką,
- elektroniczny wskaźnik temperatury wody w niecce,
- napełnianie niecki wanny przez odkręcenie zaworu.

PREMIUM

Wyposażenie podstawowe:

- pulpit sterowania, bateria termostatyczna z niezależną wylewką, automatyczne napełnianie niecki wanny (jeden poziom zabiegowy),
- elektroniczny wskaźnik temperatury wody w niecce i na wylewce.

Wyposażenie dodatkowe:

AUDIO,

CHROMO - 12 punktów LED z możliwością wyboru efektów świetlnych.

Parametry techniczne wanny


Wymiary (dł. x szer.) [cm]:	199 x 80
Wys. min.-maks. (krawędź niecki) [cm]:	72-112
Głębokość niecki [cm]:	43
Odpływ Ø [cm]:	5
Pojemność do przelewu [l]:	270
Zasilanie [V, Hz]:	230, 50
Masa wanny (ECONOMY/PREMIUM) [kg]:	210/230
Maks. masa pacjenta [kg]:	185
Maks. bezpieczne obciążenie wanny (SWL) [kg]:	400
Maks. czas napełniania do przelewu (ECONOMY/PREMIUM) (przy przepływie ~70l/min) [min]:	~16/~9,5
Maks. czas opróżniania niecki wanny [min]:	~4
Czas podnoszenia/opuszczania wanny (przy maks. obciążeniu 400 kg) [s]:	29/23
Wyrób medyczny:	



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Podnośnik do wanny:

Podnośnik wannowy z regulacją wysokości przeznaczony jest do stosowania w szpitalach, sanatoriach, domach opieki. Stosuje się go do pomocy w podnoszeniu, przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją. Umożliwia opiekunowi przeniesienie pacjenta z łóżka do wanny i z wanny do łóżka.

Może obsługiwać go jedna osoba co pozwala na ergonomiczną pracę personelu. Podnośnik wannowy można używać razem z wanną pielęgnacyjną opisaną powyżej.

Cechy charakterystyczne podnoszenie/opuszczanie,

- mobilny,
- 3 - częściowy blat noszy (+ poduszka),
- regulacja sekcji głowy i nóg,
- wyposażony w panel sterowania i ręczny pilot do regulacji wysokości.
- Podnośnik w wersji siedzącej lub leżącej



pozycja siedząca



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.




Szpital
Akredytowany



pozycja leżąca

Parametry techniczne podnośnika wannowego

Wymiary jako siedzisko (dł. x szer. x wys. (min./maks.)) [cm]:	97 x 76 x 124/184
Wymiary jako nosze (dł. x szer. x wys. (min./maks.)) [cm]:	97 x 184 x 124/184
Wymiary noszy (dł. x szer.) [cm]:	43 x 184
Szerokość siedziska [cm]:	43,5
Wysokość uchwyty [cm]:	119
Średnica skrętu [cm]:	115
Średnica kółek (z/bez hamulca) [cm]:	12,5/10
Napięcie wejściowe [V, Hz]:	100-240, 50-60
Pojemność akumulatora [Ah]:	2,9
Masa podnośnika [kg]:	95
Maks. bezpieczne obciążenie podnośnika (SWL) [kg]:	160
Czas podnoszenia/opuszczania [s]:	42/35
Wyrób medyczny:	

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 102

Automat do bielizny

Czy Zamawiający może potwierdzić, że automat do bielizny w szatni damskiej i szatni męskiej jest przedmiotem zamówienia? Czy Zamawiający udostępni specyfikację oczekiwanego automatu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie potwierdza. Automat do bielizny nie jest w zakresie zamówienia.

Pytanie 103

Wózek do transportu chorych

1. Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej 2040mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez funkcji przedłużania leża?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Punkt 10 i 28 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z 3 tunelami na kasetę RTG- pod oparciem pleców, w części środkowej i w części nożnej?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Punkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z uchwytami do przetaczania (po obu stronach)- metalowymi, lakierowanymi proszkowo z osłoną gumową? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z zakresem regulacji wysokości w zakresie 600-900mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną przy pomocy sprężyn gazowych. Dźwignie do regulacji umieszczone od strony nóg pacjenta?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu piątego koła?

Odp.: Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z w/w wymogu.

8. Punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, składające się z dwóch poprzeczek poziomych oraz 5 pionowych? Barierki poszerzają wymiar gabarytowy wózka ale jednocześnie szerokość całkowita mieści się w wymaganym przez zamawiającym zakresie- 790 mm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Punkt 26 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem z pokrowcem ze skaju o grubości 8 cm, wodoszczelny, z uchwytami do przenoszenia?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 104

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

1. Punkt 1 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której korpus wykonany jest z profili stalowych? Ramki i czoła szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS (o grubości 2cm)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, w której tylna część blatu wyposażona jest w reling na haczyk wykonany ze stali chromowanej? W oferowanym modelu szafki brak dodatkowego uchwytu na szklankę?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę składającą się z 1 szuflady oraz kontenera dolnego (zamykanego drzwiami), pomiędzy którymi znajduje się otwarta przestrzeń na prasę o wysokości 165 mm – dostęp z przodu oraz z tyłu szafki.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, w której Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład, ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części. Wysokość szuflady 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach ślizgowych umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie i domykanie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę w której kontener dolny wyposażony jest w odejmowany, lakierowany wkład, łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość kontenera dolnego 410 mm? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wymiarach zewnętrznych:

- wysokość - 860 mm
- szerokość szafki - 510 mm
- głębokość - 390 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7. Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z możliwością wyboru kolorów frontów szuflad spośród 10 kolorów? Kolor ramy szafki i jej blatu natomiast dostępny jest jedynie w kolorze RAL 9002?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 105

Pytania do postępowania przetargowego dot. Szaf z płyty meblowej, biurek, kontenerów

W opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały rozwiązania sugerujące tylko jednego producenta co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Proszę o dopuszczenie poniższych parametrów do poszczególnego przedmiotu zamówienia:
do szaf

- szafy skręcane nie klejone ma to zasadnicze znaczenie ze względu na możliwości wymiany poszczególnych elementów w przypadku ich uszkodzeń jako oddzielne elementy a nie całej szafy co jest ekonomicznie jest korzystniejsze dla użytkownika po drugie szafy skręcane są łatwiejsze i bezpieczniejsze w rozładunku i ustawienia w miejscu docelowym i w transporcie oraz nie generują potrzeby dużej ilości transportu co negatywnie wpływa na środowisko.
 - Łączenia elementów płytowych poziomych z elementami płytowymi pionowymi zapewniają sztywne, bez klejowe zespolenie za pomocą złącz składających się z trzpieni i zaczepów z gniazdami. Związanie elementów następuje w wyniku tzw. napięcia montażowego
 - Boki, fronty oraz ściana tylna wykonana z płyty dwustronnie laminowanej, trójwarstwowej, atestowanej o całkowitej grubości 18mm.
 - Wieńce górny, dolny oraz półki wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, trójwarstwowej, atestowanej o grubości 25mm.
 - Wszystkie widoczne krawędzie szafy zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowym PUR zabezpieczającą przed szkodliwym działaniem wilgoci i wysokiej temperatury.
 - Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm. Celem zapewnienia wysokiej jakości, podkreślenia walorów estetycznych oraz doskonałej wytrzymałości w trakcie użytkowania mebla krawędzie oklejone maszynowo.
 - wszystkie Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. W celu ułatwienia montażu mebla oraz ze względów praktycznych podpórki półek nabijane, samozaciskające się. Podpórki półki metalowe, „L” kształtne
 - szafy o głębokości 43 cm i wysokości 5 OH co odpowiada wysokości min 192 cm + stelaż metalowy z nóżkami 8 cm
- Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 106

Pytanie do biurek pracowniczych

W opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały rozwiązania sugerujące tylko jednego producenta co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Proszę o dopuszczenie szaf o poniższych rozwiązaniach nie gorszych niż :

- Noga biurka spawana z trzech profili o przekroju kwadratu o wymiarach 50x50mm, wykonana z blachy o grubości 2mm w kształcie odwróconej litery „U”. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40mm, wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2,5mm. Zależnie od długości, w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10mm pomiędzy blatem biurka a stelażem tzw. „Błat pływającym”. W nogach biurka wspawane ceowniki służące połączeniu trawersów z nogami. W dolnej części nogi wbita plastikowa stopka której kolnierz nachodzi od spodu na profil nogi.
- Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. Błat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o grubości 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm. Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power portów
- Opcjonalnie do stelaża biurka za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym montowana jest blenda, (przesłona dolna) z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18mm. Błat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 107

Pytanie do kontenerów

Kontener podbłatowy wymiar szer.43,2xgl. 57,5x wys. 59,8 cm

- Kontener wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości całkowitej 18mm. Płyta wiórowa użyta do produkcji mebla laminowana, impregnowanym laminatem, trójwarstwowa, atestowana posiadająca atest na higieniczność zgodny z normą E1-EN-PN14322.
- Korpus kontenera: plecy i boki oraz wieniec dolny wykonane z płyty o grubości 18mm, wieniec górny – TOP - płyta o grubości 25mm.
- Plecy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji oraz ochrony przed kurzem.
- wszystkie krawędzie elementów płytowych oklejone maszynowo ABS o grubości 2mm i 0,5mm. Krawędzie wąskie korpusu oklejone obrzeżem ABS 0,5, fronty oraz wieniec górny - TOP – obrzeże ABS 2mm.
- Kontener wyposażony w trzy szuflady metalowe (standard CE), wzmocnione prowadnice rolkowe bez cichego domyku.
- Szuflady wyposażone w blokadę wysuwu szuflad. Nośność szuflady 25kg, wysuw szuflad 70% oraz górną szufladę z piórnikiem (piórnik jako oddzielna szuflada)
- Szuflady wyposażone w zamek centralny, z wpuszczaną w korpus i przykręcaną centralną listwą zamykającą oraz dwa klucze łamane.
- Kontener mobilny, na kółkach tworzywowych $\phi=40$ mm, dwa kółka z funkcją -stop. Wszystkie fronty kontenerów z uchwytem.
- korpusy kontenerów z szufladami dostarczane w całości.
- Łączenia płytowych elementów poziomych, z płytowymi elementami pionowymi konstrukcji korpusów kontenerów zespolone za pomocą złącz składających się z metalowych śrub i metalowych zaczepów z gniazdami, kółkami oraz klejone. Nie dopuszcza się mebla skręcanego za pomocą metalowych wkrętów np. typu konfirmat.
- Wszystkie otwory konstrukcyjne na śruby i zaczepy służące do połączenia elementów korpusu kontenerów wykonane maszynowo z zastosowaniem specjalnego oprzyrządowania i specjalistycznych obrabiarek celem uzyskania precyzyjnych, o powtarzających się parametrach (głębokość, wymiary, rozstaw), estetycznych i wysokiej jakości połączeń.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 108

poz. 27. Pytanie Krzesło stacjonarne w całości tworzywowe na czterech nogach bez podłokietników

Proszę o dopuszczenie poniższych parametrów dla wskazanego krzesła

Wymagane wymiary:

- Wysokość krzesła 820 mm
- Szerokość krzesła 550 mm
- Szerokość siedziska 455 mm
- Szerokość oparcia 450 mm
- Głębokość krzesła 530 mm
- Głębokość siedziska 460 mm
- Wysokość siedziska 440 mm
- Wysokość oparcia 370 mm

Krzesło posiada następujące cechy i wyposażenie :

- Funkcja sztaplowania 10 sztuk
- Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy
- Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 25 mm w najszerszym miejscu



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



- Oparcie w całości wykonane z tworzywa
- Oparcie w całości o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach
- Siedzisko wykonane w całości z tworzywa. Dostępne 5 kolorów plastiku
- Siedzisko wykończony od spodu plastikowym panelem maskującym Dostępne 5 kolorów plastiku
- Możliwość wykonania siedziska w dwóch kolorach plastiku inny na siedzisku i inny kolor maskownicy .Dostępne 5 kolorów plastiku
- Stelaż czterożożny wykonany ze stalowej rury o średnicy 18 mm
- Nogi zakończona plastikowymi stopkami
- Miejsca spawania konstrukcji niewidoczne, ukryte pod plastikowym panelem siedziska

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 109

Poz. 15. Pytanie do fotela obrotowego z zagłówkiem

Proszę o dopuszczenie poniższych parametrów dla wskazanego krzesła

Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, o wymiarach:

- Wysokość całkowita: 1205-1465 mm,
- Szerokość oparcia: 445 mm,
- Wysokość oparcia: 575 – 660 mm,
- Szerokość siedziska: 490 mm,
- Głębokość siedziska: 430 – 490 mm,
- Wysokość siedziska: 425 – 535 mm,
- Wysokość podłokietników nad siedziskiem: 185 mm – 260 mm,
- szerokość całkowita: 685 mm,
- głębokość całkowita: 670 mm.

Krzesło posiada oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną.

Oparcie posiada osłonę wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym.

Oparcie i siedzisko w kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami.

Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu.

Szkielet siedziska wykonane ze sklejki o grubości min. 11 mm

Pianka na oparciu o grubości min. 20 mm i właściwości trudnopalne. Pianka na siedzisku o grubości min. 50 mm i właściwości trudnopalne

Krzesło wyposażone w regulowany zagłówek

Tapicerka wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach,

Łącznik oparcia z mechanizmem wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja podłokietnika nylonowa czarna nakładka termopoliuretanowa (TPU)

Podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium efekt chrom.

Kółka miękkie Fi 65 mm przeznaczone na twarde podłoże.

W 1/3 tyłu siedziska znajduje się wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz poprawiający komfort użytkownika.

Oparcie z regulacją wysokości za pomocą przycisku w dolnej części oparcia.

Krzesło posiada mechanizm Synchro z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynną regulację siły odchylania oparcia, i regulację wysokości siedziska góra-dół.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Krzesła tapicerowane materiałem powlekany zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici i parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność: 300 000 cykli,
- Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2),
- Odporność na światło minimum >7,
- Gramatura: min. 680 g/m²,
- Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester,
- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi,
- Duża odporność na różnice temperatury,
- Odporność na urynię i krew i pot,
- Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 110

Dotyczy pakietu nr 1 - Wózek zabiegowy 2 blaty góra i dół (załącznik nr 4)

Czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny o podanych poniżej parametrach, którego funkcjonalność jest taka sama lub lepsza, jak w przypadku produktów opisanych w SWZ?

Lp.	PARAMETR/ WARUNEK
I.	Parametry techniczne
1.	Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
2.	Konstrukcja wykonana z profili 25x25x1,5 mm (+/- 10 mm)
3.	Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, wykonane z blachy o grubości 1,2 mm
4.	Odległość między blatem, a półką wynosi 445mm
5.	Stolik wyposażony w zaokrąglony uchwyt do prowadzenia, wykonany z rurki fi 20x20 mm (+/- 10 mm) znajdujący się przy krótszym boku (umieszczony poziomo)
6.	Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) montowanych na trzpieniu koła
7.	W kółkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzącej podłoża.
8.	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego
9.	Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 750x650 mm (+/- 10 mm)
10.	Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 865x720x880 mm (+/- 10 mm)
II.	Pozostałe warunki
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (atest PZH)
2.	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób
3.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 111

Dotyczy pakietu nr 1 – wózek zabiegowy z kuwetami wieszakiem na kosz (załącznik nr 5)

Czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny o podanych poniżej parametrach, którego funkcjonalność jest taka sama lub lepsza, jak w przypadku produktów opisanych w SWZ?

Lp.	PARAMETR/ WARUNEK
I.	Parametry techniczne
1.	Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
2.	Konstrukcja wykonana z profili 25x25x1,5 mm (+/- 10 mm)
3.	Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, wykonane z blachy o grubości 1,2 mm
4.	Odległość między blatem, a półką wynosi 445mm
5.	Stolik wyposażony w zaokrąglony uchwyt do prowadzenia, wykonany z rurki fi 20x20 mm (+/- 10 mm) znajdujący się przy krótszym boku (umieszczony poziomo)
6.	Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) montowanych na trzpieniu koła
7.	W kółkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzącej podłoża.
8.	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego
9.	Wymiary blatu (dłxszxw) w mm: 750x650 mm (+/- 10 mm)
10.	Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 865x720x880 mm (+/- 10 mm)
11.	Przy krótszym boku stelaż z pokrywą (na odpadki) i pojemnik na cewniki
II.	Pozostałe warunki
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (atest PZH)
2.	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób
3.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 112

Dotyczy pakietu nr 1 – podwójny zbieracz (załącznik nr 7)

Czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny o podanych poniżej parametrach, którego funkcjonalność jest taka sama lub lepsza, jak w przypadku produktów opisanych w SWZ?

Lp.	PARAMETR/ WARUNEK
I.	Parametry techniczne
1.	Stelaż do worków foliowych 120l - podwójny, z pokrywami
2.	Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki
3.	Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worków
4.	Wózek wyposażony w dwie pokrywy satynowe (matowe) lub malowane proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego) podnoszone nożnie
5.	Pokrywy po otwarciu zatrzymują się w pozycji 90°
6.	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm)
7.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
9.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
10.	Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 860x580x1050 mm (+/-10 mm)
II.	Pozostałe warunki
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (atest PZH)
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 113

Dotyczy pakietu nr 1 – pojedynczy zbieracz na odpady lub bieliznę brudną (załącznik nr 8)

Czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny o podanych poniżej parametrach, którego funkcjonalność jest taka sama lub lepsza, jak w przypadku produktów opisanych w SWZ?

Lp.	PARAMETR/ WARUNEK
I.	Parametry techniczne
1.	Stelaż do worków foliowych 120l – pojedynczy z pokrywą
2.	Wózek wyposażony w obręcz na worek
3.	Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worków
4.	Wózek wyposażony w jedną pokrywą satynową (matową) lub malowaną proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego) podnoszone nożnie
5.	Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°
6.	Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm)
7.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
9.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
10.	Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 415x580x1050 mm (+/-10 mm)
II.	Pozostałe warunki
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (atest PZH)
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 114

Dotyczy pakietu nr 1 – wieszak listwowy 5 hakowy na obuwie (załącznik nr 11):

Czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny o podanych poniżej parametrach, którego funkcjonalność jest taka sama lub lepsza, jak w przypadku produktów opisanych w SWZ?

Lp.	PARAMETR/WARUNEK
I.	Parametry techniczne
1.	Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
2.	Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie
3.	Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków
4.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
5.	Wymiary: H=1800 mm (+/- 20 mm)
	Wyposażenie: 3x Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz z wycięciem z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszxwys w mm): 575x280x265 2x Wieszak do obuwia, ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia chirurgicznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszxwys w mm): 570x180x300
II.	Pozostałe warunki
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (atest PZH)
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 115

Dotyczy pakietu nr 1 – wózek do przewożenia zwłok (załącznik nr 12):

Czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny o podanych poniżej parametrach, którego funkcjonalność jest taka sama lub lepsza, jak w przypadku produktów opisanych w SWZ?

Lp.	PARAMETR/WARUNEK
I.	Parametry techniczne
1.	Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304),
2.	Górna rama wyposażona w system rolek umożliwiający załadunek tac lub trumien oraz mechanizm zabezpieczania tac przed wysuwem
3.	Rama wyposażona w 4 koła o średnicy 125mm, każde z hamulcem
4.	Rama wyposażona w dwa odbojniki w przedniej części wózka
5.	Maksymalne obciążenie robocze: 250 kg
6.	Wyposażenie wózka: - taca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Konstrukcja spawana. Taca z dwoma płozami pod spodem i uchwytem, po jednej z krótszej krawędzi. Wymiary (dłxszxwys) w mm: 2200x670x80 - pokrywa na tacę wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Konstrukcja spawana. Pokrywa z dwoma uchwytami na dłuższym boku. Wymiary (dłxszxwys) w mm: 2065x740x340
7.	Wymiary wózka (dłxszxwys) w mm: 2480x850x820
II.	Pozostałe warunki
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (atest PZH)
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 116

Dotyczy pakietu nr 1 – wieszak listwowy 5 hakowy (załącznik nr 23):

Czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny o podanych poniżej parametrach, którego funkcjonalność jest taka sama lub lepsza, jak w przypadku produktów opisanych w SWZ?

Lp.	PARAMETR/ WARUNEK
I.	Parametry techniczne
1.	Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
2.	Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie
3.	Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków
4.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
5.	Wymiary: H=1800 mm (+/- 20 mm)
6.	Wyposażenie: 2x kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszxwys w mm): 575x280x135 3x Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz z wycięciem z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszxwys w mm): 575x280x265
II.	Pozostałe warunki
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (atest PZH)
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 117

Dotyczy pakietu nr 1 – fotelik lekarski (załącznik nr 9):

Czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny o podanych poniżej parametrach, którego funkcjonalność jest taka sama lub lepsza, jak w przypadku produktów opisanych w SWZ?

Lp.	PARAMETR/WARUNEK
I.	Parametry techniczne
1.	Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym
2.	Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm
3.	Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych
4.	Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym
5.	Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej)
6.	Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (górze – dół, przód – tył)
7.	Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
8.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
9.	Taboret z obręczą pod nogi
10.	Dopuszczalne obciążenie 135 kg
11.	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
12.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
13.	Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 480x480x490/630 mm (+/- 10 mm)
II.	Pozostałe warunki
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (atest PZH)
2.	Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób
3.	Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 118

Dotyczy pakietu nr 1 – fotelik lekarski (załącznik nr 9):

Czy Zamawiający dopuści fotelik o wymiarach zewnętrznych (wymiar podstawy x zakres regulacji) w mm: 480x480x490/630 mm z podstawą trójramienną z obręczą pod nogi, z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) oraz dopuszczalnym obciążeniem 135 kg?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 120

Dotyczy pakietu nr 1 – wózek wielopoziomowy z możliwością łączenia (załącznik nr 6):

Czy Zamawiający dopuści wyrób równoważny o podanych poniżej parametrach, którego funkcjonalność jest taka sama lub lepsza, jak w przypadku produktów opisanych w SWZ?

Lp.	PARAMETR/WARUNEK
I.	Parametry techniczne
1.	Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny, wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
2.	Wózek wyposażony w szafkę z drzwiami, z dwoma półkami
3.	Drzwi pojedyncze otwierane skrzydłowo
4.	Błat szafki wyposażony w relingi zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów znajdujących się na blacie
5.	Błat o wymiarach (dłxszxw) w mm 600x600 mm (+/- 10 mm)
6.	Z tyłu szafki zamontowana obręcz na worek foliowy (pojemność worka 120l)
7.	Obręcz z pokrywą podnoszoną nożnie
8.	Na obręczy klipsy tworzywowe służące do podtrzymania worka
9.	Wózek na czterech kółkach fi 100 mm (w tym dwa z blokadą) (+/-10 mm)
10.	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
11.	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego
12.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
13.	Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm : 640x1190x1100 mm (+/-10 mm)
II.	Pozostałe warunki
1.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (atest PZH)
2.	Certyfikat jakości EN ISO 9001

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 121

Pytania do Zamawiającego dot. Przedmiotowych środków dowodowych – zapis SWZ rozdział V:
Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
Materiały informacyjne producenta potwierdzające spełnienie parametrów oraz:

Zadanie 1

Poz.1 - Wózek zabiegowy

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce – czy Zamawiający ma na myśli deklarację zgodności CE producenta i wpis/zgłoszenie do URW MiPB potwierdzające, że jest to wyrób medyczny?

Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymogu atestu higienicznego, CE oraz Deklaracji zgodności. Wymagana będzie karta katalogowa potwierdzająca spełnienie wymogów zapisanych w SWZ.

Poz.2 - Wózek anestezyjologiczny

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce – czy Zamawiający ma na myśli deklarację zgodności CE producenta i wpis/zgłoszenie do URW MiPB potwierdzające, że jest to wyrób medyczny?

Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymogu atestu higienicznego, CE oraz Deklaracji zgodności. Wymagana będzie karta katalogowa potwierdzająca spełnienie wymogów zapisanych w SWZ.

Poz.3 - Wózek do transportu chorych

- Atest higieniczny – prosimy o wykreślenie zapisu, ze względu na fakt, że wózki do transportu chorych nie podlegają atestacji higieniczności.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w zapisu.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności CE producenta,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce – czy Zamawiający ma na myśli deklarację zgodności CE producenta i wpis/zgłoszenie do URW MiPB potwierdzające, że jest to wyrób medyczny?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485

Poz.4 - Wózek do transportu chorych

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska polegająca na błędnie wprowadzonej nazwie? Czy w tej pozycji powinien być: wózek zabiegowy 2 błądy górą i dół?

Odp.: Tak, nastąpiła omyłka pisarska.

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności CE producenta,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce – czy Zamawiający ma na myśli deklarację zgodności CE producenta i wpis/zgłoszenie do URW MiPB potwierdzające, że jest to wyrób medyczny?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Poz.5 - Wózek zabiegowy z kuwetami wieszakami na kosz

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności CE producenta,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce – czy Zamawiający ma na myśli deklarację zgodności CE producenta i wpis/zgłoszenie do URW MiPB potwierdzające, że jest to wyrób medyczny?,

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485

Poz.6 - Wózek wielopoziomowych z możliwością łączenia

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce – Proszę o wykreślenie zapisu, wózek wielopoziomowy z możliwością łączenia nie są wyrobami medycznymi, objęte są 23% stawką podatku VAT.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

Poz.7 - Podwójny zbieracz

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce - Proszę o wykreślenie zapisu, podwójne zbieracze nie są wyrobami medycznymi, objęte są 23% stawką podatku VAT.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

Poz.8 – Pojedynczy zbieracz na odpady lub bieliznę brudną

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce - Proszę o wykreślenie zapisu, Pojedynczy zbieracz na odpady lub bieliznę brudną nie są wyrobami medycznymi, objęte są 23% stawką podatku VAT.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis

Poz.9 – Fotelik lekarski z oparciem

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności CE producenta,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce, - czy Zamawiający ma na myśli deklarację zgodności CE producenta i wpis/zgłoszenie do URW MiPB potwierdzające, że jest to wyrób medyczny?,

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485

Poz.10 – Szafa metalowa na sprzęt do sprzątania

- Atest higieniczny - proszę o wykreślenie zapisu producent nie posiada atestu higienicznego
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności CE producenta,
- Certyfikat TUV GS – dotyczący bezpieczeństwa użytkowania, - proszę o wykreślenie zapisu ponieważ szafy metalowe na sprzęt do sprzątania nie posiadają Certyfikatu bezpieczeństwa użytkowania.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia w/w zapis.

- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce - Proszę o wykreślenie zapisu, szafy metalowe na sprzęt do sprzątania nie są wyrobami medycznymi, objęte są 23% stawką podatku VAT.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Poz.11 – Wieszak listwowy 5 hakowy na obuwie

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce - Proszę o wykreślenie zapisu, wieszaki listwowe 5 hakowe na obuwie nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

Poz.12 – Wózek do przewożenia zwłok

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce - Proszę o wykreślenie zapisu, wózek do przewożenia zwłok nie jest wyrobem medycznym, jest objęty 23% stawką podatku VAT.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracje zgodności CE producenta – producent nie wystawia takiego dokumentu dla tego wyrobu,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485

Poz.13 – Szafy

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, szafy nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracje zgodności z PN:EN 14073-2:2006
- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001,

Poz.14 – Sofa głęboka

- Atest higieniczny,- proszę o wykreślenie zapisu, sofę nie podlegają atestacji higieniczności

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, sofę nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

Poz.15 – Fotel obrotowy z zagłówkiem, oparcie w całości tapicerowane

- Atest higieniczny – producent nie posiada atestu higienicznego na cały produkt

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, fotele obrotowe z zagłówkiem nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracje zgodności CE producenta,- proszę o wykreślenie zapisu. Meble, krzesła, fotele nie podlegają certyfikacji CE.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

Do wyrobów, dla których nie ma obowiązku nadawania znaku CE należą:

1. MEBLE BEZ ZNAKU CE

Najbardziej popularną grupą wyrobów niepodlegających oznakowaniu CE są meble. Nie można nadać znaku CE na szafę, półki, krzesła, łóżka, lamy sklepowe, regały ani inne elementy wyposażenia domu, biura lub sklepu. Wyjątkiem będą tylko te meble, które zawierają na stałe wbudowane elementy elektryczne (np. oświetlenie) lub inne modyfikacje (np. regał z



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



wbudowanym kominkiem, szafki otwierane na pilota). Takie wyjątkowe meble podlegają pod oznakowanie CE na mocy odpowiednich dyrektyw, np. niskonapięciowej (LVD 2006/95/WE) i o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC 2004/108/WE). Jednak w przeważającej większości meble nie będą posiadały znaku CE i będzie to zgodne z prawem. <https://www.certios.pl/szkolenia/oznaczenie-ce/ogolne-ce/201-wyroby-nie-podlegajace-oznakowaniu-ce>

- Deklaracja zgodności z normą PN EN 1021:1:2 – dotyczącą trudnopalności,
- Deklaracja zgodności z normą PN EN 1335-1 – dotyczącą zachowania ergonomii,
- Deklaracja zgodności z normą EN 1335-1: 2002 oraz EN 1335-2:2019
- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

Poz.16 – Stolik z kwadratowym blatem

- Atest higieniczny
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, stoliki nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001,

Poz.17 – Taboret

- Atest higieniczny – producent nie posiada atestu na gotowy produkt

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, taborety nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001,

Poz.18 – Nadstawka szafy żaluzjowej 1000

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, Nadstawki do szaf żaluzjowych nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Certyfikat TUV– dotyczący bezpieczeństwa użytkowania, proszę o dodanie zapisu lub równoważny.

Odp.: Tak, Zamawiający dodaje w/w zapis.

Poz.19 – Chłodziarka

- Atest higieniczny – proszę o wykreślenie zapisu, lodówki, chłodziarki nie posiadają atestu higieniczności

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, chłodziarki nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Poz.20 – Krzesło z podłokietnikami

- Atest higieniczny – proszę o wykreślenie zapisu – producent nie posiada atestu higienicznego na gotowy produkt

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,

- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, krzesła z podłokietnikami nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracje zgodności CE producenta, proszę o wykreślenie zapisu. Meble, krzesła, fotele nie podlegają certyfikacji CE.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracja zgodności z normą PN EN 1021:1:2 – dotyczącą trudnopalności,

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

Poz.21 – Fotel okolicznościowy

- Atest higieniczny – proszę o wykreślenie zapisu – producent nie posiada atestu higienicznego na gotowy produkt

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,

- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, fotele okolicznościowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracja zgodności z normą PN EN 1021:1:2 – dotyczącą trudnopalności,

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Poz.22 – Sofa nierozkładana dla 3 osób

- Atest higieniczny – proszę o wykreślenie zapisu – producent nie posiada atestu higienicznego na gotowy produkt,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,

- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, sofy nierozkładane nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracja zgodności z normą PN EN 1021:1, PN EN 1021:2 – dotyczącą trudnopalności,

- Deklaracje zgodności z normą PN EN 16139:013_07, PN EN 178:2012, PN EN 1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12521:2009 w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych,

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001

Poz.23 – Wieszak listwowy 5 hakowy

- Atest higieniczny,

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,

- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, wieszaki listwowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Poz.24 – Szafa ubraniowa 4 osobowa dwupoziomowa na nóżkach

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, szafy ubraniowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Certyfikat TUV GS – dotyczący bezpieczeństwa użytkowania, proszę o dodanie zapisu lub równoważny

Odp.: Tak, Zamawiający dodaje w/w zapis.

Poz.25 – Szafa ubraniowa 6 osobowa dwupoziomowa na nóżkach

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, szafy ubraniowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Certyfikat TUV GS – dotyczący bezpieczeństwa użytkowania, proszę o dodanie zapisu lub równoważny

Odp.: Tak, Zamawiający dodaje w/w zapis.

Poz.26 – Szafa żaluzjowa 1000

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, szafy żaluzjowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Certyfikat TUV GS – dotyczący bezpieczeństwa użytkowania, proszę o dodanie zapisu lub równoważny

Odp.: Tak, Zamawiający dodaje w/w zapis.

Poz.27 – Krzesło stacjonarne w całości tworzywowe

- Atest higieniczny – producent ni posiada atestu higienicznego

Odp.: Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, krzesła stacjonarne tworzywowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracja zgodności z normą EN 16139:2013, EN 1728:2012, EN 1022:2005,

Poz.28 – Biurko pracownicze

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, biurka nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracja zgodności z normą PN:EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08,

Poz.29 – Kontener mobilny

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, kontenery nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracja zgodności z normą PN EN 14073-2:2006,
- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001,

Poz.30 – Szafa skrytkowa

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, szafy skrytkowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001,

Poz.31 – Wanna z podnośnikiem

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce – czy Zamawiający ma na myśli deklarację zgodności CE producenta i wpis/zgłoszenie do URW MiPB potwierdzające, że jest to wyrób medyczny?
- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001,

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Poz.32 – Szafka przyłóżkowa z białem bocznym

- Atest higieniczny- proszę o wykreślenie zapisu, producent nie posiada atestu higienicznego

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- czy Zamawiający ma na myśli deklarację zgodności CE producenta i wpis/zgłoszenie do URW MiPB potwierdzające, że jest to wyrób medyczny?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 13485:2012,
- Deklaracje zgodności CE producenta,

Poz.33 – Łóżeczko noworodkowe

- Atest higieniczny, producent nie posiada atestu higienicznego

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
- czy Zamawiający ma na myśli deklarację zgodności CE producenta i wpis/zgłoszenie do URW MiPB potwierdzające, że jest to wyrób medyczny?,

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, lub PN-EN ISO 10993-1:2010 oraz PN-EN ISO 14971:2012

- Deklaracje zgodności CE producenta,



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Poz.34 – Fotel obrotowy pracowniczy

- Atest higieniczny – proszę o wykreślenie zapisu producent opisanych foteli nie posiada atestu higienicznego

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,
Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, fotele obrotowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- potwierdzenie wykonania w systemie zarządzania jakością ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,

- Deklaracje zgodności CE producenta – proszę o wykreślenie zapisu, Meble, fotel, krzesła nie podlegają certyfikacji CE,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Deklaracja zgodności z normą PN EN 1021:1:2 – dotyczącą trudnopalności,

- Deklaracja zgodności z normą EN 1335-1:2002, 1335-2:2019

Poz.35 – Szafa żaluzjowa 800

- Atest higieniczny,

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,

- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, szafy żaluzjowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Certyfikat TUV GS – dotyczący bezpieczeństwa użytkowania, proszę o dodanie zapisu lub równoważny

Odp.: Tak, Zamawiający dodaje w/w zapis.

Poz.36 – Nadstawka szafy żaluzjowej 800

- Atest higieniczny,

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,

- Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, szafy żaluzjowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Certyfikat TUV GS – dotyczący bezpieczeństwa użytkowania, proszę o dodanie zapisu lub równoważny

Odp.: Tak, Zamawiający dodaje w/w zapis.

Poz.37 – Szafa żaluzjowa 600

- Atest higieniczny,

- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji,

Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, szafy żaluzjowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis.

- Certyfikat TUV GS – dotyczący bezpieczeństwa użytkowania, proszę o dodanie zapisu lub równoważny

Odp.: Tak, Zamawiający dodaje w/w zapis



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Poz.38 – Nadstawka szafy żaluzjowej 600

- Atest higieniczny,
- Karta katalogowa potwierdzające parametry wymagane w specyfikacji, Deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do obrotu w Polsce- Proszę o wykreślenie zapisu, szafy żaluzjowe nie są wyrobem medycznym, są objęte 23% stawką podatku VAT,

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla w/w zapis

- Certyfikat TUV GS – dotyczący bezpieczeństwa użytkowania, proszę o dodanie zapisu lub równoważny

Odp.: Tak, Zamawiający dodaje w/w zapis

Treść niniejszego pisma staje się częścią specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są ją uwzględnić w swoich ofertach.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

Błażej Gorczyński

Sporządziła:
Aleksandra Prażucha
Dział Zamówień Publicznych