



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 28/ 248 /2019

Wrocław, dnia 09.07.2019 r.

## INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa urządzeń medycznych”.

Pytanie nr 1 – Zadanie nr 16 - Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2150mm? Parametr ten tylko w nieznacznym sposób odbiega od oczekiwanego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o długości całkowitej 2150mm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 2 – Zadanie nr 16 - Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne leża na poziomie 15 stopni? Jest to parametr powszechnie stosowany w wózkach do przewożenia chorych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 3 – Zadanie nr 16 - Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający zamiast kosza na butle z tlenem dopuści rozwiązanie równoważne w postaci uchwytu na butle z tlenem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 4 – Zadanie nr 16 - Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uchwytu na rolkę z pokryciem higienicznym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 5 – Zadanie nr 16 - Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści obciążenie wózka 225kg? Parametr ten tylko w nieznacznym sposób odbiega od oczekiwanego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o dopuszczalnym obciążeniu 225 kg. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 6 – Zadanie nr 30 - Podnośnik dla pacjentów niepełnosprawnych – pkt 1

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia od 58 cm do 159 cm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podnośnika z zakresem podnoszenia od 58 cm do 159 cm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 7 – Zadanie nr 30 - Podnośnik dla pacjentów niepełnosprawnych – pkt 3

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o całkowitej długości ramy 100 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podnośnika o całkowitej długości ramy 100 cm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 8 – Zadanie nr 30 - Podnośnik dla pacjentów niepełnosprawnych – pkt 4

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem regulacji szerokości podstawy od 61 do 84 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podnośnika z zakresem regulacji szerokości podstawy od 61 do 84 cm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 96 – Zadanie nr 30 - Podnośnik dla pacjentów niepełnosprawnych – pkt 5

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z baterią kadmowo-niklową, dającą niskie napięcie 24V

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podnośnika z baterią kadmowo-niklową, dającą niskie napięcie 24V. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 10 – Zadanie nr 30 - Podnośnik dla pacjentów niepełnosprawnych - pkt 6

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z bateriami 2x12V, 5A

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podnośnika z bateriami 2x12V, 5A. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 11 – Zadanie nr 30 - Podnośnik dla pacjentów niepełnosprawnych – pkt 9

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z podwójnymi kołami tylnymi z blokadą

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podnośnika z podwójnymi kołami tylnymi z blokadą. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 12 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1szt. Pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek medyczny, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych kolumnach aluminiowych, a ściany tylnia i boczne wykonane są z wytrzymałego, odpornego na dezynfekcję, nierdzewnego kompozytu aluminium?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 13 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1szt. Pkt. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek medyczny, o wymiarach:

- wysokość: 970mm,
- szerokość: 650mm,
- głębokość: 475mm,

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 14 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek medyczny, wyposażony w 5 szuflad:

- 4 górne o wysokości użytkowej 110mm,
- 1 dolna o wysokości użytkowej 230mm,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 15 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek medyczny, którego szuflady nie są wykonane w formie tworzywowego odlewu? Oferujemy wózek o solidnych szufladach wykonanych z aluminium, na prowadnicach z samo-dociąganiem, łatwo i szybko demontowane w celu np. dokładniejszej dezynfekcji bez wykorzystania narzędzi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 16 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek medyczny, którego fronty szuflad nie posiadają miejsca na karteczkę identyfikacyjną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego którego fronty szuflad nie posiadają miejsca na karteczkę identyfikacyjną. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 17 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek medyczny, bez dodatkowych pojemników szuflady, zaopatrzone za to w konfigurowalne podziałki ułatwiające organizację przestrzeni z możliwością całkowitego demontażu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 18 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek medyczny wyposażony w wysoce mobilny układ jezdy składający się z 4 podwójnych kół, w tym 2 z blokadą, a 1 z blokadą kierunkową, o średnicy 100mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone dla lepszej stabilności wózka na planie prostokąta?




**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 19 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek medyczny, wyposażony w:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,
- uchwyt do przetaczania,
- pojemnik do zużytych igieł,
- pojemnik na cewniki,
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,
- uchwyt na butlę z tlenem,
- 3 szyny sprzętowe o regulowanych wysokościach po bokach wózka, do mocowania osprzętu dodatkowego, np.: kosza kolanowego, kubeków na odpady itd.,
- 2 tworzywowe kosze na odpady z pokrywkami mocowane z boku wózka,

Na kolejnej stronie zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

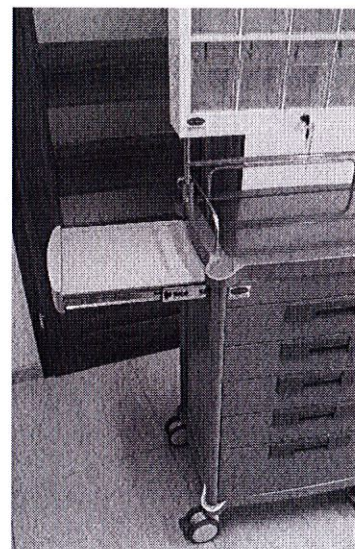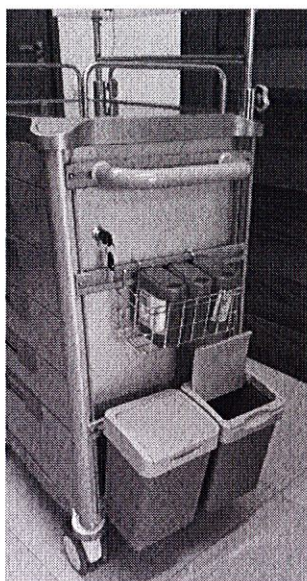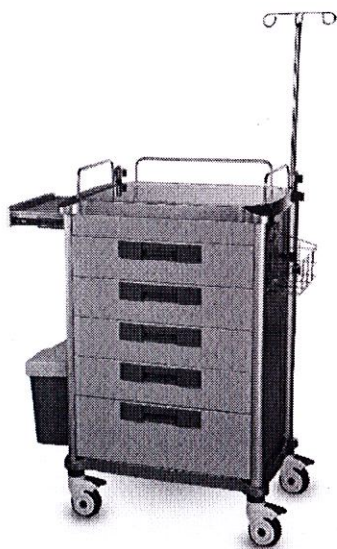

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 20 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym szkielet, blat górny i szuflady wykonane są z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, wysokoodpornego tworzywa polietylenu (równoważny do BAYDUR)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 21 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrzne: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, szerokość (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 22 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym tylko szuflady główne będą zamykane na klucz?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 23 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający czoła szuflad z przezroczystymi okienkami/tabliczkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 24 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową mobilność i zwrotność wózka (w prostokącie)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 25 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający „zintegrowanych dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 26 – Zadanie nr 7. Wózek medyczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie w nieznaczny sposób zwiększa jego gabaryty?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 27 – Zadanie nr 1. Tonometr brzdotykowy – 1 szt.

Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający dopuści Tonometr bezdotykowy o następujących parametrach:

- Zakres pomiaru ciśnienia śródocznego 0 - 60 mmHg (0 - 8hPa)
- Dokładność pomiaru 0.1 mmHg
- Tonometr - jednostka główna. Wymiary W/S/D 460 (W) x 300 (S) x 480 (H) mm
- Waga ok. 18 kg
- Napięcie zasilania Napięcie 100 VAC - 240 VAC
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Pobór mocy Pobór mocy max 45VA
- Zasilanie DC 12V 5A

- Zasilacz Zewnętrzny, medyczny
- INPUT: 100-240V ~1,5A
- OUTPUT: 12V --5A
- Drukarka Wbudowana, termiczna
- Wyświetlacz 7", dotykowy, kolorowy LCD
- Zakres regulacji podbródka 69 mm
- Zakres regulacji sekcji ruchomej 85 mm (oś X ); 40 mm (oś Y ); 50 mm (oś Z )
- Podbródek Regulowany elektrycznie (góra/dół)
- Pamięć urządzenia Wewnętrzna pamięć flash
- Karta SD
- Baza danych Pojemność: do 4000 pacjentów x 100 badań x 3 pomiary (dla każdego oka)

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 28 – Zadanie nr 5. USG okulistyczny z sondą typu B i bimetryczną – 1szt.  
Czy zamawiający dopuści aparat USG w konfiguracji jak w poniższej tabeli:

1	Przenośny ultrasonograf okulistyczny o wymiarach konsoli 47,5 x27x15 (cm) oraz wadze 5 kg. Konsola wyposażona w demontowalne, łatwe w czyszczeniu uchwyty na sondy.
2	Dedykowany komputer przenośny o parametrach: Wyświetlacz 15,6" Full HD, dysk 16 GB RAM, 512GB M.2 SSD + 1TB HDD, system operacyjny Windows 10.
3	Możliwość podłączenia jednocześnie 3 głowic
4	Możliwość pracy w trybie A z biometrią i kalkulacją soczewki oraz w trybie prezentacji B
5	System archiwizacji oraz eksportu danych
6	Możliwość zapisu badania na nośnikach zewnętrznych (Pamięci USB)
7	Możliwość tworzenia raportów badania
8	Możliwość zastosowania 4 rodzajów głowic
9	Możliwość regulacji transmitowanej energii w trybie obrazowania B-Scan.
10	Opcjonalnie Możliwość pracy w środowisku DICOM
11	Możliwość rozbudowy o sondy: - UBM o częstotliwości 40 MHz - sondę A standaryzowaną diagnostyczną o częstotliwości 8 MHz.
12	Dedykowana drukarka do raportów <i>Sonda B do tylnego odcinka oka</i>
13	Możliwość nakładania skanu A na obraz trybu B
14	Możliwość pomiarów odległości, kątów, dodawania komentarzy.
15	Częstotliwość pracy sondy 10MHz
16	Szybkość akwizycji obrazów – 25 ramek na sekundę
17	Nagrywanie filmu z badania 10 sekund
18	Możliwość obróbki nagranych filmów z badań
19	Regulowane wzmocnienie sondy w zakresie 27-90 dB
20	Głębokość skanowania 48mm
21	Kąt skanowania stopni
22	Zakres dynamiczny regulowany czterostopniowo
23	Rozdzielczość osiowa 50 mikronów
24	Rozdzielczość poprzeczna 100 mikronów

<b>Sonda A-skan biometryczna</b>	
25	Kalkulacja soczewek IOL, min. 4 formuły (Holladay-I, SRK-T, Haigis, HofferQ)
26	Szybkość akwizycji 50 klatek na sekundę
27	Nagrywanie filmu z badania 5 sekund
28	Tryb immersyjny lub kontaktowy
29	Głowica ze światłem fiksacyjnym
30	Częstotliwość głowicy 10 MHz
31	Zakres pomiaru 40mm
32	Wbudowany system rozpoznawania echa, z automatyczną detekcją echa twardówkowego
33	Statystyka: średnia i odchylenie standardowe
34	Ilość punktów na osi X 2048
35	Dokładność pomiaru: - kliniczna: 100 mikronów - elektroniczna: 50 mikronów
36	Automatyczna lub manualna rejestracja obrazu

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 29 – Zadanie nr 16 Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 2110 mm co tylko nieznacznie różni się od wymaganego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych o długość całkowitej 2110 mm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 30 – Zadanie nr 16 Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający mając na uwadze parametry użytkowe dopuści i będzie wymagał aby regulacja oparcia pleców odbywała się w zakresie 0 - 87° co jest parametrem zdecydowanie lepszym od wymaganego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 31 – Zadanie nr 16 Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych, w którym przechył Trendelenburga wynosi 12°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 32 – Zadanie nr 16 Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający mając na uwadze wysokie parametry użytkowe dopuści i będzie wymagał aby wózek posiadał na wyposażeniu drugi wieszak kroplówki chowany pod leżem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 33 – Zadanie nr 16 Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający mając na uwadze wysokie parametry użytkowe dopuści i będzie wymagał aby wózek posiadał maksymalny udźwig na poziomie 250 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych, który posiada maksymalny udźwig na poziomie 250 kg. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 34 – Zadanie nr 16 Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych, który nie posiada uchwytu na rolkę?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 35 – Zadanie nr 16 Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.

Czy Zamawiający mając na uwadze wysokie parametry użytkowe dopuści i będzie wymagał aby wózek posiadał półkę na monitor z pasami oraz miejscem na kartę pacjenta?

Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka poniżej:

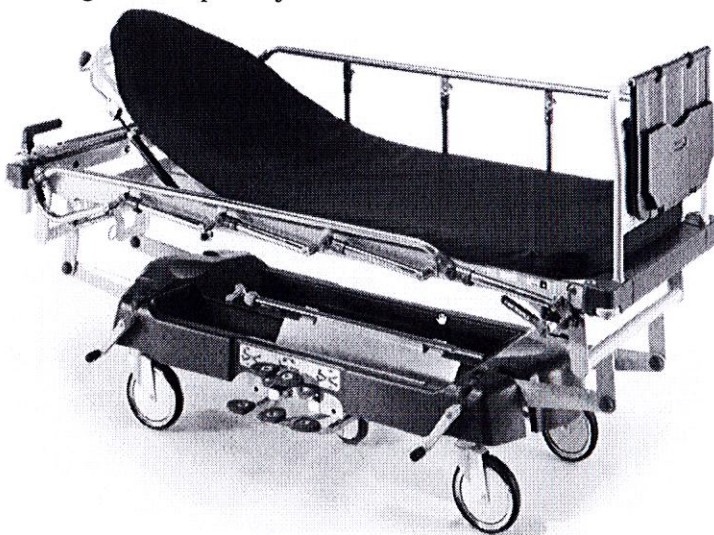

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych o powyższych funkcjonalnościach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 36 – Zadanie nr 13 materac przeciwodleżynowy

Czy Zamawiający dopuści zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy spełniający poniższy opis?

- Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3
- Materac przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni.
- System pracy 3 do 1 co oznacza iż w czasie 1/3 cyklu co trzecia komora pozostaje bez powietrza, tj komory nr 1,4,7,10, 13, 16 pozostają bez powietrza przez 1/3 czasu trwania cyklu, następnie zostają napełnione powietrzem, a komory nr 2,5,8,11,14,17 zostają opróżnione, po czym następuje zmiana na komory 3,6,9,12,15,18.
- 3 aktywne przewody powietrzne łączące pompę z materacem doprowadzające powietrze do komór, umożliwiające pracę w systemie 3 do 1.
- Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund(istotne w czasie zagrożenia życia pacjenta i konieczności szybkiego spuszczenia powietrza z materaca celem prowadzenia skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej).
- Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta.
- Wysokość komór materaca 12,5 cm
- Materac kładziony na standardowym materacu szpitalnym
- Wymiary materaca 90x200cm
- Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) 180kg
- Możliwość współpracy pompy z materacem z dwoma warstwami komór powietrznych i udźwigu min. 250kg.
- Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiału). Posiada system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania).

- Powlekane koszulki na spodzie pokrowca materaca przyczyniające się do zmniejszenia sił tarcia u pacjentów przebywających w pozycji siedzącej i w ten sposób zapobiegających uszkodzeniom skóry u tych pacjentów.
- Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór.
- Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
- Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca przeciwodrażynowego o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 37 – Zadanie nr 17 Wózek medyczny wielofunkcyjny

Czy Zamawiający będzie wymagał aby szkielet wózka, blat główny oraz czoła szuflad wykonane są z tworzywa poliuretanowego typu Baydur, które charakteryzuje się o wiele większą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne niż ABS oraz lekkością?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższej charakterystyce. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 38 – Zadanie nr 17 Wózek medyczny wielofunkcyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny, wielofunkcyjny spełniający poniższy opis?

- Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad oraz wnętrze szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo poliuretanowe, typu Baydur zapewniające prawidłową eksploatację i dezynfekcję.
- Wymiary zewnętrzne wózka:
  - wysokość : 91 cm;
  - głębokość: 71,5cm,
  - szerokość: 83 cm;
- Wózek wyposażony w 5 szuflad o wysokości :
  - \*2 szuflady o wysokości 150 mm.
  - \*3 szuflada o wysokości 100 mm.
- Czoła szuflad z wysokoodpornego tworzywa
- Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji
- Pojemniki 2 szuflad z podziałami wewnętrznymi
- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka
- Wyposażenie podstawowe wózka:
  - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,
  - uchwyt zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie,
  - pojemnik do zużytych igieł wraz z uchwytem
  - kosz z systemem otwierania za pomocą stopy,
  - wieszak kroplówki teleskopowy,
- Deklaracja zgodności
- Kolor frontów szuflad do wyboru przez użytkownika

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższej charakterystyce. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 39 – Zadanie nr 16- Wózek do przewożenia chorych -1 szt.- pkt 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 do 65 °?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**



Pytanie nr 40 – Zadanie nr 16- Wózek do przewożenia chorych -1 szt. - pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją pozycji Trendelenburga wynoszącą 18 °?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 41 – Zadanie nr 16- Wózek do przewożenia chorych -1 szt. - pkt 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 150mm, z blokadą centralną i kierunkową? Blokada uruchamiana za pomocą tworzywowej dźwigni nożnej umieszczona nad kołami od strony nóg pacjenta oznaczone kolorystycznie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 42 – Zadanie nr 16- Wózek do przewożenia chorych -1 szt. - pkt 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 170 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 43 – Zadanie nr 14 pompa infuzyjna strzykawkowa szt 2 – pkt 8.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej o masie pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie do 2,3 kg

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej o powyższej wadze. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 44 – Zadanie nr 14 pompa infuzyjna strzykawkowa szt 2 – pkt 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z pełnym mocowaniem strzykawki przy włączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 45 – Zadanie nr 14 pompa infuzyjna strzykawkowa szt 2 – pkt 16

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pompy z zakresem infuzji 0,1-999 ml/godz

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 46 – Zadanie nr 14 pompa infuzyjna strzykawkowa szt 2 – pkt 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z możliwością programowania infuzji w jednostkach masy: mg, µg, ng, IU, mEq, mmol – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy infuzyjnej o powyższej charakterystyce. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 47 – Zadanie nr 14 pompa infuzyjna strzykawkowa szt 2 – pkt 26

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pompy z 9 poziomami ciśnienia okluzji pokrywającymi zakres 75-900 mmHg

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 48 – Zadanie nr 14 pompa infuzyjna strzykawkowa szt 2 – pkt 41

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pompy bez alarmu rozłączenia linii-spadku ciśnienia, w zamian oferującej wskaźnik graficzny w postaci manometru stale informujący o aktualnym ciśnieniu w linii

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 49 – Zadanie nr 14 pompa infuzyjna strzykawkowa szt 2 – pkt 51

Prosimy o dopuszczenie pompy w której możliwość połączenia z komputerem centralnym realizowana może być przewodowo, lub bez przewodowo jedynie przez stację dokującą.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 50 – Zadanie nr 13 materac przeciwodleżynowy

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy do leczenia odleżyn do III stopnia (według standardów organizacji European Pressure Ulcer Advisory Panel) ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca przeciwodleżynowego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 51 – Zadanie nr 13 materac przeciwodleżynowy

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy zbudowany z 18 komór, napełnianych co trzecia w stałym cyklu 6-minutowym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca przeciwodleżynowego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 52 – Zadanie nr 13 materac przeciwodleżynowy

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, którego komory wykonane są z elastycznego PCV, natomiast pokrowiec materaca z rozciągliwego poliuretanu ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca przeciwodleżynowego o powyższej funkcjonalności. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 53 – Zadanie nr 16 wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o leżu składającym się z 4 segmentów z możliwością regulacji kąta nachylania segmentu pleców oraz segmentu nóg?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 54 – Zadanie nr 16 wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o kącie przechyłu Trendelenburga 12 stopni oraz anti-Trendelenburga również 12 stopni ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 55 – Zadanie nr 16 wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia mechanizmu regulacji przechyłów TB i antiTB w blokadę?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 56 – Zadanie nr 16 wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta wyposażony w podwójne koła w osłonach antystatycznych o średnicy 150 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 57 – Zadanie nr 16 wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci miejsca w podstawie wózka na butlę z tlenem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 58 – Zadanie nr 16 wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania wyposażenia wózka do przewożenia chorych w uchwyt na rolkę z pokryciem higienicznym ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 59 – Zadanie nr 16 wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o maksymalnym bezpiecznym obciążeniu równym 220 kg ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 60 – Zadanie nr 17 wózek medyczny wielofunkcyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny wielofunkcyjny o wymiarach zewnętrznych: wysokość 100 cm, głębokość 65 cm, szerokość 83 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 61 – Zadanie nr 17 wózek medyczny wielofunkcyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady o wysokości: 160 mm w przypadku 3 szuflad oraz jednej, dolnej o wysokości 240 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 62 – Zadanie nr 17 wózek medyczny wielofunkcyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 obrotowe koła, w tym 2 z blokadą, z elastycznym nie brudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach tworzących układ prostokąta ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 63 – Zadanie nr 17 wózek medyczny wielofunkcyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego burty blatu wyposażone są w zintegrowane uchwyty do prowadzenia wózka, rozmieszczone po dwóch stronach wózka ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka medycznego o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 64 – Zadanie nr 17 wózek medyczny wielofunkcyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek w kolorze białym z szufladami posiadającymi wstawki w różnych kolorach, do wyboru przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 65 – Zadanie nr 30 podnośnik pacjenta

Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta o zakresie podnoszenie 100 - 200 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 66 – Zadanie nr 30 podnośnik pacjenta

Czy Zamawiający dopuści podnośnik o długości ramy 112 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podnośnika o długości ramy 112 cm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 67 – Zadanie nr 18 Tor wizyjny

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie asortymentu w zadaniu nr 18. Czy wymagany do zaoferowania jest przewód wysokociśnieniowy do podłączenia insuflatora ze źródłem CO<sub>2</sub> (butlą), czy przewód niskociśnieniowy dostosowany do podłączenia do zasilania z centralnej instalacji gazów medycznych Szpitala tj. z punktu poboru gazów wyposażonego we wtyk typu AGA, długość przewodu min. 4 metry?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaoferowania zarówno przewodu wysokociśnieniowego do podłączenia insuflatora ze źródłem CO<sub>2</sub> (butlą) oraz przewodu niskociśnieniowy dostosowanego do podłączenia do zasilania z centralnej instalacji gazów medycznych Szpitala tj. z punktu poboru gazów wyposażonego we wtyk typu AGA o długości przewodu min. 4 metry każdy?**

Pytanie nr 68 – Zadanie nr 18 Tor wizyjny

Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy jest wyrobem modułowym, dowolnie konfigurowalnym przez użytkownika, składającym się:

- z modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym oznakowanym CE w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i posiada stawkę VAT 8% oraz

- z modułów wyposażenia wózka takich jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO<sub>2</sub>, uchwyt kamery, uchwyt stojaka, szyna sprzętowa, nieoznakowanych znakiem CE, gdyż nie podlegają one pod ustawę o wyrobach medycznych i nie są objęte deklaracją zgodności, i posiadają stawkę VAT 23%,

Zamawiający odstąpi o wymogu dostarczenia deklaracji zgodności oraz zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu oferowanego sprzętu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla wyrobów tzw. niemedycznych, nie podlegających ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i odstąpi o wymogu dostarczenia deklaracji zgodności w takim przypadku.**

Pytanie nr 69 – Zadanie nr 18 Tor wizyjny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia zakresie poz. koszt druciany do mycia i sterylizacji, spełniającego wszystkie wymagania opisane w formularzu parametrów technicznych, które nie są w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i odstąpi o wymogu wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE.*

Pytanie nr 70 – Zadanie nr 32 Zestaw do endoskopowych zabiegów laparoskopowych

W związku z faktem, iż Zamawiający wprowadził wymóg w zadaniu nr 32 w punkcie nr 66 – zasilania insuflacji dostosowanej do podłączenia do zasilania z centralnej instalacji gazów medycznych Szpitala tj. z punktu poboru gazów wyposażonego we wtyk typu AGA, długość przewodu min 4 metry, to czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania przewodu wysokociśnieniowego CO<sub>2</sub>, przeznaczonego do zasilania insuflacji wyłącznie z butli i wstępnie opisanego w zadaniu nr 32 podpunkt 65?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaoferowania zarówno przewodu wysokociśnieniowego do podłączenia insuflatora ze źródłem CO<sub>2</sub> (butlą) oraz przewodu niskociśnieniowy dostosowanego do podłączenia do zasilania z centralnej instalacji gazów medycznych Szpitala tj. z punktu poboru gazów wyposażonego we wtyk typu AGA o długości przewodu min. 4 metry każdy?*

Pytanie nr 71 – Zadanie nr 18 i 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 56 dni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 72 – Zadanie nr 18 i 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej o której mowa we wzorze umowy §11 ust. 1 pkt. 2) z 1% na 0,5%?

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 73 – Zadanie nr 18 i 32

W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami SIWZ, a zestawieniem parametrów technicznych tj. \*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub wartości parametru)” prosimy o informację czy katalogi potwierdzające spełnianie parametrów opisanych w załączniku parametry techniczne, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą czy też na wezwanie Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca, który nie poda w tabeli nr strony zawierającej potwierdzenie wymaganego parametru, odnotował to dopiero na dokumentach dostarczanych na wezwanie. Zamawiający wymaga w tym przypadku zaznaczenie w materiałach informacyjnych obszaru który potwierdza spełnienie parametru poprzez wskazanie przy nim liczby porządkowej z tabeli.*

Pytanie nr 74 – Dotyczy SIWZ rozdział III ust. 7 pkt. 5), załącznik nr 2 projekt umowy §8 ust. 2, pkt. 5)

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu w rozdziale III ust. 7 pkt. 5), załączniku nr 2 projekcie umowy §8 ust. 2, pkt. 5).

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 75 – Dotyczy załącznik nr 2 projekt umowy §11 ust.1 pkt. 1), ust. 2.

Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej potencjalnych kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy na 5 % wartości umownej brutto.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 76 – Dotyczy załącznik nr 2 projekt umowy §11 ust.1 pkt. 2)

Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej potencjalnych kar umownych na 0,5% wartości umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 77 – Dotyczy SIWZ / Umowy dla: Zadanie nr 7 Wózek medyczny 1 szt. i Zadanie nr 17 Wózek medyczny wielofunkcyjny 2 szt.

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu uruchomienia, wymogu obecności przedstawiciela Wykonawcy przy rozpakowywaniu wyrobu oraz wymogu udzielenia instruktażu w zakresie obsługi wyrobów medycznych zaoferowanych w Zadaniu nr 7 i Zadaniu nr 17, w jednym, w dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Do Zamawiającego oferowany wyrób (wózek) dostarczany jest gotowy do użytku – żadne czynności montażowe czy związane z uruchomieniem nie są zatem konieczne. Nie ma zatem także potrzeby, aby przedstawiciel Wykonawcy był obecny przy czynności rozpakowania wyrobów. Oferowany wózek jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponadto ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych sprzętów przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Prosimy o stosowne zmiany w SIWZ / załącznikach / projekcie umowy (w szczególności z rezygnacji z wymogu uruchomienia w § 2, wymogu udzielenia instruktażu w § 4 pkt 3), wymogu nierozpakowywania wyrobów w § 5 pkt. 1) projektu umowy; wymogu podpisania protokołu z przeprowadzonego instruktażu w § 6 ust. 2 projektu umowy).

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 78 – Dotyczy SIWZ / Umowy dla: Zadanie nr 7 Wózek medyczny 1 szt. i Zadanie nr 17 Wózek medyczny wielofunkcyjny 2 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dokonywania bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji w zakresie Zadania nr 7 i Zadania nr 17, zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy? Producent oferowanych wózków takowych przeglądów nie wymaga, co możemy poświadczyć stosownym dokumentem (oświadczenie producenta). Utrzymanie tego wymogu (nawet w zakresie 1 przeglądu gwarancyjnego rocznie) może doprowadzić do niezasadnego wzrostu ceny oferowanego produktu. Prosimy o stosowne zmiany w SIWZ / załącznikach / projekcie umowy (w szczególności wykreślenie postanowienia zawartego w § 8 ust. 2 pkt 1) projektu umowy).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 pkt 1) projektu umowy, w sytuacji gdy producent nie wymaga przeglądów okresowych, Zamawiający odstępuje od tego wymogu. Tym samym zapis o ich wykonywaniu nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy nie ma zastosowania. Zamawiający wymaga w takiej sytuacji oświadczenia producenta w tym zakresie.**

Pytanie nr 79 – Dotyczy SIWZ / Umowy dla: Zadanie nr 7 Wózek medyczny 1 szt. i Zadanie nr 17 Wózek medyczny wielofunkcyjny 2 szt.

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych przewidzianych w § 11 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 3) z poziomu odpowiednio 1% oraz 0,5% do poziomu odpowiednio 0,1-0,2% za każdy dzień opóźnienia. Przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych w wysokości 0,1%-0,2% za każdy dzień zwłoki/opóźnienia. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy/innych załącznikach.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 80 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dotykowym ekranem LCD o przekątnej 10,1 i wysokiej rozdzielczości 800x480 pikseli? Oferowany kardiomonitor ma wysokiej jakości ekran z szeroką regulacją jasności oraz pozwala jednocześnie wyświetlić 13 krzywych dynamicznych. Przy tej wielkości ekranu są to wystarczające parametry aby zapewnić optymalną pracę na oddziale.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ekranu o przekątnej 10,1" oraz dopuści zaoferowanie ekranu o rozdzielczości 800x480 pikseli. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 81 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o konstrukcji spełniającej wszelkie normy i certyfikaty dla placówek ochrony zdrowia wymagane obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami prawa, w tym również

odporność na zachłapania i wnikanie ciał stałych na poziomie IPX1 oraz zgodność m.in. z normą EN 60601-1, EN 60601-2 oraz EN 61000-3-2?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora kompaktowego o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.*

Pytanie nr 82 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 9 oraz poz. 13

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć alarmów (ponad 200) wraz z zapisem wszystkich mierzonych parametrów oraz krzywej parametru, który wywołał alarm o regulowanej długości od 8 do 32 sekund bez dodawania zdarzeń alarmowych ręcznie?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora kompaktowego o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.*

Pytanie nr 83 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w wyświetlanie informacji w 8 niezależnych trybach wyświetlania takich jak – duże znaki, tryb minitrendów, oxyCRG, tryb 7 EKG, tryb parametrów życiowych, tryb standardowy, tryb gotowości, tryb nocny z możliwością zdefiniowania niezależnych ustawień dotyczących m.in. alarmów oraz parametrów pomiarowych i układu wyświetlania danych? Oferowane kardiomonitora przeznaczone są na jeden oddział (oddział ginekologii) więc przełączanie trybów blok operacyjny czy oddział intensywnej opieki medycznej nie ma większego zastosowania.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 84 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w ręczne oraz automatyczne, na podstawie danego typu pacjenta, ustawianie granic alarmowych na jednym wspólnym ekranie dla wszystkich parametrów? Ustawianie parametrów granicznych na jednym ekranie jest bardzo prostą i szybką czynnością, co więcej konfiguracja alarmów zazwyczaj jest jednorazową czynnością dla danego pacjenta i nie wymaga późniejszej ingerencji.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora kompaktowego o powyższych funkcjonalnościach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.*

Pytanie nr 85 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trzystopniową regulacją czasu wyciszenia alarmów 60, 120, 180 sekund oraz z możliwością wyciszenia na stałe (opcja chroniona hasłem użytkownika)? Oferowane czasy wyciszenia alarmów są najbardziej popularne i użyteczne w zastosowaniach na oddziale ginekologii.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora kompaktowego o powyższych funkcjonalnościach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.*

Pytanie nr 86 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 16

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wyświetlaniem informacji o pozostałym czasie pracy baterii w postaci wskaźnika graficznego na głównym ekranie kardiomonitora i z możliwością sprawdzenia czasu w menu serwisowym? Oferowany kardiomonitor pracuje na baterii co najmniej 4h. Poza tym wskaźnik graficzny jest bardziej widoczny i czytelny niż możliwość sprawdzenia w menu/systemie ile godzin pracy na baterii pozostało.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 87 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 18

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcję szybkiego przyjęcia pacjenta z wyborem jedynie płci i stymulatora (tak/nie) oraz z możliwością późniejszego uzupełnienia pozostałych danych takich jak MRN, imię, nazwisko, wiek, wzrost, waga, data i godzina przyjęcia itd. a także przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych, ale bez wyboru obligatoryjnych pól do uzupełnienia, które spowalniają cały proces przyjęcia? Jest to dużo szybsza i prostsza metoda pozwalająca na poświęceniu większej ilości czasu dla pacjenta.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora kompaktowego o powyższych funkcjonalnościach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.*

Pytanie nr 88 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 19

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony fabrycznie w narzędzia serwisowe do sprawdzenia stanu poszczególnych elementów kardiomonitora oraz przeprowadzenie aktualizacji itd.? Jest to lepszy parametr gdyż nie wymaga żadnych dodatkowych zakupów opcjonalnych narzędzi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora kompaktowego o powyższych funkcjonalnościach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 89 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 22

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o funkcję synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN bez połączenia szeregowego, ale z wykorzystaniem protokołu HL7? Połączenie szeregowe jest już bardzo rzadko używane, bardzo wolne i podlega wielu zakłóceniom.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora kompaktowego o powyższych funkcjonalnościach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 90 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 29 oraz poz. 32 oraz poz. 38

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor pozwalający na monitorowanie SpO2 w technologii własnej producenta, zbieżnej w wynikach do technologii Nellcor, Masimo oraz FAST, bez możliwości stosowania jednocześnie wszystkich czujników z powyższych technologii? Technologia FAST jest charakterystyczna dla jednego producenta kardiomonitorów i tylko on może zaoferować tę technologię oraz czujniki tej technologii pomiaru, a co za tym idzie tylko ten jeden producent spełnia wymagania niniejszych punktów.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 91 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 33

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z szerszym zakresem pomiaru ciśnienia od 10 do 290 mmHg oraz z zakresem pomiaru pulsu 40-240bpm? Pomiar pulsu i tak zazwyczaj dokonywany jest z pomiaru saturacji SpO2.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 92 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 36

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia w 2 kanałach – możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy od -50 do +300 mmHg. Możliwość stosowania przetworników jednorazowych różnych producentów? Jest to parametr tylko i wyłącznie dotyczący możliwości rozbudowy kardiomonitora, poza tym praktycznie bezużyteczny na oddziale ginekologii.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 93 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 37

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o kapnometrię w równoważnej technologii natywnej producenta, z zakresem pomiarowy 0-150 mmHg oraz możliwością pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych? Niniejszy punkt dotyczy tylko i wyłącznie możliwości rozbudowy i nie ma wpływu na funkcjonowanie oferowanego kardiomonitora na oddziale ginekologii.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora kompaktowego o powyższych funkcjonalnościach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 94 - dotyczy zadania nr 11 kardiomonitor kompaktowy - poz. 40

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną z wydrukiem 3 kanałów i szerokością papieru 48 mm, pozostałe parametry bez zmian? Niniejszy punkt dotyczy tylko i wyłącznie możliwości rozbudowy i nie ma wpływu na funkcjonowanie oferowanego kardiomonitora na oddziale ginekologii.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 95 - dotyczy zadania nr 20 – aparat EKG

Czy zamawiający dopuści aparat EKG, fabrycznie nowy, nieużywany, z pełną gwarancją oraz oryginalnie zapakowany wyprodukowany w IV kwartale 2018 roku - listopad?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG wyprodukowanego w IV kwartale 2018 roku.**

Pytanie nr 96 - Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy:

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu

umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

**Odpowiedź:** *Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy.*

Pytanie nr 97 - Dotyczy SIWZ, §8 ust. 2 pkt. 5) projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „wymiany elementu/podzespołu na nowy w przypadku jego 3-krotnej awarii.”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkowało musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 98 - Dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §11 ust. 1 pkt. 2) i 3) na następujące:

„1) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w danym zadaniu - w wysokości 0,5% wartości brutto dostarczonej ze zwłoką partii towaru, za każdy dzień zwłoki

2) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto uszkodzonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki”.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 99 - Dotyczy zadanie nr 8:

1) SIWZ rozdz. III pkt. 7. 1) oraz zał. 2 do SIWZ wzór umowy par. 8 ust. 2 pkt. 1

Prosimy o odstąpienie od wskazanego zapisu dla pakietu nr 8. Zwracamy uprzejmie uwagę, że producent nie przewiduje przeglądów dla samej głowicy.

2) SIWZ rozdz. III pkt. 7. 5) oraz zał. 2 do SIWZ wzór umowy umowa par. 8 ust. 2 pkt. 5

Prosimy o usunięcie w zakresie pakietu nr 8.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dla Zadania nr 8 – Głowica liniowa - modyfikuje zapisy umowy (tj. Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie par. 8 ust 2 pkt 1 tj.:*

**Było:**

„2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:

- 1) bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,
- 2) przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
- 3) naprawy wyrobów medycznych w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy urządzenia poza granicami kraju Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 14 dni roboczych,



- 4) w przypadku konieczności dostarczenia wyrobów medycznych do serwisu, Zamawiający może przesłać je niezwłocznie za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Wykonawcy,
- 5) wymiany wyrobów medycznych na nowe w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej,
- 6) przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej,”

Jest:

„2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:

- 1) ~~bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,~~
- 2) przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
- 3) naprawy wyrobów medycznych w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy urządzenia poza granicami kraju Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 14 dni roboczych,
- 4) w przypadku konieczności dostarczenia wyrobów medycznych do serwisu, Zamawiający może przesłać je niezwłocznie za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Wykonawcy,
- 5) ~~wymiany wyrobów medycznych na nowe w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej,~~
- 6) przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej,”

Pytanie nr 100 - Dotyczy zadania nr 8 – głowica liniowa pkt 11

Czy Zamawiający dopuści czoło głowicy o wymiarach 38,4mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści czoło głowicy o wymiarach 38,4mm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 101 - Dotyczy zadania nr 8 – głowica liniowa

Prosimy o usunięcie pkt 14, 15. Zwracamy uprzejmie uwagę, że prowadnica jest dodatkowym akcesorium do głowicy. Pozostawienie takich zapisów spowoduje wzrost wartości oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy liniowej bez prowadnicy do biopsji SG-4. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.**

Pytanie nr 102 - Dotyczy zadania nr 8 – głowica liniowa- zał. 2 do SIWZ par. 4 ust. 4 pkt. b-f

Prosimy o usunięcie wskazanych pkt. b-f w zakresie pakietu 8. Zapisy są nieadekwatne do przedmiotu umowy – zgodnie z uzasadnieniem w pytaniu nr 1.

**Odpowiedź: Zamawiający dla Zadania nr 8 – Głowica liniowa - modyfikuje zapisy umowy (tj. Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie par. 4 ust 4 pkt 1 tj.:**

Było:

- „4) dostarczenia wraz z dostawą w wersji papierowej i elektronicznej następujące dokumenty:
  - a) instrukcję obsługi wyrobów medycznych w języku polskim,
  - b) pisemną informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej wyrobów medycznych tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,
  - c) zestawienie elementów wskazanych przez producenta do okresowej wymiany,
  - d) zestawienie elementów zużywalnych,

- e) zestawienie materiałów eksploatacyjnych,
- f) pisemną informację czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.”

Jest:

„4) dostarczenia wraz z dostawą w wersji papierowej i elektronicznej następujące dokumenty:

- a) instrukcję obsługi wyrobów medycznych w języku polskim,
- b) ~~pisemną informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej wyrobów medycznych tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,~~
- e) ~~zestawienie elementów wskazanych przez producenta do okresowej wymiany,~~
- d) ~~zestawienie elementów zużywalnych,~~
- e) ~~zestawienie materiałów eksploatacyjnych,~~
- f) ~~pisemną informację czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.”~~

Pytanie nr 103 - Dotyczy zadania nr 8 – głowica liniowa - zał. 5 do SIWZ

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerty wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych (w tym spółki z siedzibami poza EOG), w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o dodanie następujących zapisów jako par. 6’ , które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych:

- 1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.
- 2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem <http://www.siemens.com/shs-subcontractors>  
Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
- 3) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
- 4) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.  
Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania
  - a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
  - b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
- 5) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.
- 6) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie

danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- 7) W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. załącznik nr 5 do SIWZ) poprzez dodanie w par. 6 po pkt 6 powyższego zapisu.**

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
mgr inż. Jolwiga Raziuk

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

*Jacob*  
*pl*