



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 20.07.2020

**NZZ/36/P/20**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
Dostawa sprzętu jednorazowego w zakresie elektrofizjologii

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

**Pytanie nr 1:**

Bardzo proszę o przesłanie projektu umowy w innym formacie niż 7z., ponieważ nie jesteśmy w stanie jej zweryfikować, ponieważ wyświetlany jest błąd pliku.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Projekty umów zostały spakowane w formacie 7z.

Spakowany katalog należy pobrać na komputer, a następnie za pomocą programu np. 7-Zip rozpakować go.  
Nie jest wyświetlany wówczas żaden błąd pliku.

**Pytanie nr 2:**

Pytanie do postępowania dotyczące załącznika 3D;

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 3D do SIWZ poprzez dodanie do par. 2 nowego ust. 5 o treści:  
„Zamawiający będzie pobierał z depozytu wyroby medyczne/produkty lecznicze począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. Wyroby medyczne/produkty lecznicze, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z depozytu przez Zamawiającego

**Odpowiedź na zapytanie:**

**Modyfikuje się zapisy załącznika nr 3D do SIWZ – Projekt umowy depozytu**

**W §2 po ustępie 4 dodaje się nowy ustęp, który otrzymuje brzmienie:**

**5.**

„Zamawiający będzie pobierał z depozytu wyroby medyczne/produkty lecznicze począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. Wyroby medyczne/produkty lecznicze, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z depozytu przez Zamawiającego.”

**Pytanie nr 3:**

**Dotyczy projektu umowy – załącznik 3A do siwz**

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §1 ust.5 umowy o pkt.:

„5.1. W trakcie trwania umowy każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu ważności. Każda ze stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego się w depozycie.

**Odpowiedź na zapytanie:**


Zamawiający wskazuje, iż wielkość depozytu określa załącznik nr 1 SIWZ.

**Modyfikuje się zapisy załącznika nr 3A do SIWZ – Projekt umowy dostawy**

**W §1 po ustępie 5 dodaje się nowy ustęp, który otrzymuje brzmienie:**

**6.**

„W trakcie trwania umowy każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania depozytu pod kątem terminu ważności.”



**Pytanie nr 4:**

**Dotyczy projektu umowy – załącznik 3D do siwz**

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §3 ust. 1 umowy o pkt:

„1.1. W trakcie trwania umowy każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu ważności. Każda ze stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego się w depozycie”.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wskazuje, iż wielkość depozytu określa załącznik nr 1.

**Modyfikuje się zapisy załącznika nr 3D do SIWZ – Projekt umowy depozytu**

**W §3 po ustępie 1 dodaje się nowy ustęp, który otrzymuje brzmienie:**

**1a**

„W trakcie trwania umowy każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania depozytu pod kątem terminu ważności.”

**Pytanie nr 5:**

**Dotyczy projektu umowy – załącznik 3D do siwz**

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §3 ust. 1 umowy o pkt.:

„1.2. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania powierzonych w depozyt wyrobów medycznych/produktów leczniczych\* we właściwych dla tych wyrobów medycznych/produktów leczniczych\* warunkach i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. Za asortyment uszkodzony uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe).”

**Odpowiedź na zapytanie:**

**Modyfikuje się zapisy załącznika nr 3D do SIWZ – Projekt umowy depozytu**

**W §3 ustęp 3 dodaje się na końcu zapis.**

„Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania powierzonych w depozyt wyrobów medycznych/produktów leczniczych\* we właściwych dla tych wyrobów medycznych/produktów leczniczych\* warunkach i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. Za asortyment uszkodzony uważany jest również towar rozsterylizowany”

**Pytanie nr 6:**

do pakietu 9

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 i stworzenie osobnego zadania na te pozycje.

Posiadamy elektrody niesterowalne o następujących parametrach:

Pozycja 1

Spacing 2mm, 5 mm, 10 mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm

Dostępne 6 krzywizn do wyboru : MPA, MPB, RVA, RVB, HIS, CS oznaczone kolorystycznie

Pierścienie platynowo -irydowe płaskie

Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Pozycja 2


Spacing 2mm, 5 mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm

Dostępne 6 krzywizn do wyboru : MPA, MPB, RVA, RVB, HIS, CS oznaczone kolorystycznie


Pierścienie platynowo – irydowe płaskie

Pozostałe warunki SIWZ spełnione





Poniżej zdjęcie krzywizn.

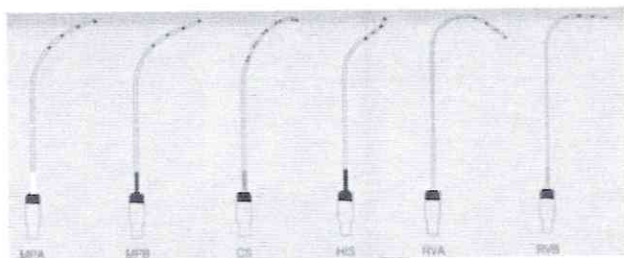

Przed podjęciem decyzji proponujemy przekazanie bezpłatnej próbki i przetestowanie produktu w pracowni.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

Pytanie 2 do pakietu 10.

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 i stworzenie osobnego zadania na elektrody niesterowalne.

Posiadamy w ofercie produkty o następujących parametrach:

**Pozycja 1**

Elektrody 4 lub 6 polowe o stałych krzywiznach

6 rodzajów krzywizn : MPA, MPB, RVA, RVB, HIS, CS oznaczonych kolorystycznie

Odległości biegunów : 2mm, 5 mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm

Pierścienie platynowo – irydowe płaskie

Pozostałe warunki SIWZ spełnione


**Pozycja 2**

6 rodzajów krzywizn do wyboru : MPA, MPB, RVA, RVB, HIS, CS oznaczonych kolorystycznie

specjalna krzywizna do CS

Spacing : 2 mm, 5mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm

Poniżej zdjęcie proponowanych krzywizn.

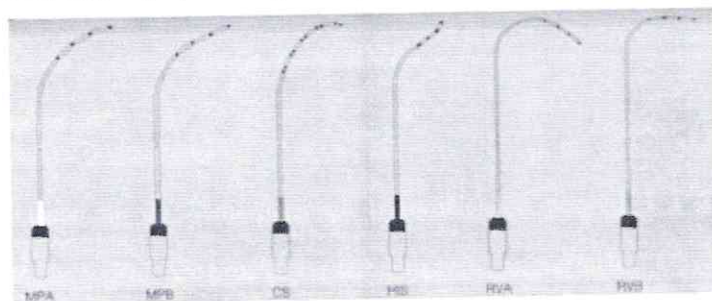

Przed podjęciem decyzji proponujemy przekazanie bezpłatnej próbki i przetestowanie produktu w pracowni.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Kierownik  
Dział Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
mgr Marek Bryk