



INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku**”.

Pytanie 1, dotyczy pakiet 4, poz.1-4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców w przypadku wątpliwości do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaofiarowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaofiarowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2, dotyczy pakiet 7, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 cewnika Foley'a dwudrożny w rozmiarze od CH12 do CH 22 z balonem 5-10ml oraz w rozmiarze 14-24 z balonem 30-50ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3, dotyczy pakiet 7, poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 7 cewnika dwudrożnego z zakończeniem typu Tiemann do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką z jednym otworem, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 4, dotyczy – pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii, w której składzie znajduje się cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH8/11/14, dł. całkowita 43cm dla CH8 oraz 48cm dla CH11/14, reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 5, dotyczy - pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy zestawu do cystostomii z cewnikiem posiadającym osiem oczek drenażowych wewnątrz pętli.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 6, dotyczy - pakiet 22, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 sterylnego zestawu do pomiaru diurezy godzinowej. Dren dwuświatłowy długości 150 cm, łącznik do cewnika Foley z bezigłowym portem dostępu do pobierania próbek strzykawkami typu Luer i zastawką jednokierunkową chroniącą przed cofaniem się moczu do cewnika Foley. Dren na wejściu do komory pomiarowej zabezpieczony spiralą antyzakałaniową. Komora pomiarowa wyposażona w hydrofobowy filtr powietrza o minimalnej powierzchni 300 mm² oraz zawór umożliwiający spuszczenie moczu z komory do worka, z workiem zbiorczym na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkową zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do komory pomiarowej oraz zawór spustowy do opróżniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml. Zestaw wyposażony w elastyczne paski oraz okrągły hak do zawieszenia systemu przy łożku pacjenta. Bez lateksu i DEHP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem parametru opróżniania komory bez manewrowania nią.

Pytanie 7, dotyczy - pakiet 22, poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drewnu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 8, dotyczy - pakiet 2, poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 igieł 0,3 x 12,5 mm zamiast 0,3 x 13 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1/2"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 9, dotyczy - pakiet 2, poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 igieł 0,5 x 25 mm zamiast 0,5 x 40 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 10, dotyczy - pakiet 2, poz 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 igieł 0,6 x 32 mm zamiast 0,6 x 30 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 1/4"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 11, dotyczy - pakiet 2, poz 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 igieł 0,7 x 32 mm zamiast 0,7 x 30 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 1/4"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Pytanie 12, dotyczy - pakiet 2, poz 9 i 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 9 i 10 igieł krótkościętych SB/BS

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 13, dotyczy - pakiet 2, poz 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 11 igieł tępych z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45 °, co zapobiega defragmentacji korka i zapobiega zakłuciu przez osobę przygotowującą lek

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 14, dotyczy - pakiet 3, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 cewnik do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylny, z medycznego PCV, miękki (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory odbarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwi szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, wewnętrzna część lejka gładka, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie folia- papier ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania. Cewniki w rozmiarach odpowiednio CH06 – CH08 długość cewnika 49 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 15, dotyczy - pakiet 3, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 cewnik do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylny, z medycznego PCV, miękki (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory odbarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwi szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, wewnętrzna część lejka gładka, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie folia- papier ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania. Cewniki w rozmiarach odpowiednio CH06 – CH08 długość cewnika 49 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 16, dotyczy - pakiet 3, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 cewnik do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylny, z medycznego PCV, miękki (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory odbarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwi szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, wewnętrzna część lejka gładka, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie folia- papier ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania. Cewniki w rozmiarach CH10-CH18 długość cewnika 57 cm.



Odpowiedź: Dopuszcza powyższe z zachowaniem kodu kolorystycznego również na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 17, dotyczy - pakiet 4, poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 1-2 oczekuje zaoferowania przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru średnicy wewnętrznej przez Zamawiającego.

Pytanie 18, dotyczy - pakiet 4, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 kranika o całkowitej objętości wypełnienia zestawu 1,19 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 19, dotyczy - pakiet 9, poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 Zestaw do szynowania moczowodów w skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, otwarty-otwarty lub otwarty/zamknięty do wyboru - do URS 4.8CH popychacz sterowalny o długości 83 cm, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową o dł. 150 cm o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika z ruchomym rdzeniem, zacisk Dostępne długości: 24/26/28/30/32 cm

Oraz

-popychacz prosty o dł. 43 cm, prowadnica z powłoką teflonową o dł. 150cm dla O/O oraz 100 cm dla O/Z. Rozmiary: CH4.8, CH6, CH7, długości: 22/24/26/28 cm - do wyboru

Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 20, dotyczy - pakiet 9, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 zestawu do szynowania moczowodów. Cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem: prosty dla zestawu do URS o dł. 75cm oraz sterowalny dla zestawów cystoskopowych dł. 40cm, prowadnica z rdzeniem nitinolowym hydrofilna na całej długości o średnicy 0.035" dł. 150 cm. System otwarty/otwarty. Rozmiar: CH4.8, CH6, CH7, CH8. Długość: 22-28 cm (co 2 cm) dla rozmiaru 4.8CH(URS), 22-30 cm (co 2 cm) dla rozmiaru 4.8CH (cystoskop), 22-30 cm dla rozmiaru 6/7CH, 26-30 cm dla rozmiaru 8CH. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 21, dotyczy – pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje cewnika dwuwarstwowego miękkiego na zewnątrz dla większego komfortu pacjenta oraz sztywnego w środku dla łatwiejszego wprowadzania z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 22, dotyczy - pakiet 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 zestawu do szynowania wewnętrznego z wężeń moczowodu stosowany przy pieloplastyce. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z silikonu, rozmiar: CH8 na pętlach oraz CH12 wzmocniona część prosta przy zwiężeniu miedniczkowym moczowodu, przewodnica 0.035" o dł. 150cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz sterowalny 40cm. Cewnik otwarty-otwarty, długości 26, 28, 30 cm - do wyboru przez Zamawiającego. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylony.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 23, dotyczy - pakiet 10, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 zestawu do nefrostomii wielostopniowej o składzie: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, przewodnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038" (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzeń dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadzie; kranik Luer-Lock; bezłateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Rozmiary cewnika: CH8/10/12. Zestaw sterylony jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 24, dotyczy - pakiet 23, poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 filtra objętości wypełnienia samego filtra 0,15 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 25, dotyczy - pakiet 23, poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 1 i 2 filtr ma być wyposażony w zastawkę antyzwrotną w części dystalnej filtra co zapobiega cofaniu się krwi w kierunku filtra i jego zalaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 26, dotyczy - pakiet 23, poz.3 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 i 4 ramp z wielorazowym uchwytem umożliwiającym zamocowanie rampy w ilości wskazanej przez Zamawiającego (zgodnie z ilością stanowisk na jakim będą używane) . rampy zakończone systemem bezigłowym o przestrzeni martwej max 0,09 ml, przepływ 360 ml/min, czas stosowania do 7 dni lub 140 użyć.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 27, dotyczy - pakiet 23, poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 bezigłowego systemu do 360 użyć , objętość wypełnienia do 0,09 ml. Pozostałe parametry zgodnie w SWZ.

Odpowiedź: Pytanie dotyczy pozycji nr 6 – i do tej pozycji Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 28, dotyczy - pakiet 23,poz.5

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 bezigłowego systemu do 700 użyć (zamiast 720). Przepływ grawitacyjny 165 ml, pod ciśnieniem 600 ml/min. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Pytanie dotyczy pozycji nr 6 – i do tej pozycji Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 29, dotyczy - pakiet 25,poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 koszulki dostępu moczowodowego pokrytą hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzadła, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenia powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego przewodnika. Przewodnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki znajduje się pierścień widoczny w RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami, umożliwiającymi podanie kontrastu z pozostawieniem przewodnicy w miejscu. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH długości 28-45cm do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 30, dotyczy - pakiet 25,poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 przewodnicy czarnej z rdzeniem nitinolowym i powłoką hydrofilową na całej długości, odporna na zgięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez trudne odcinki moczowodu. Zakończenie proste, giętka bezpieczna końcówka o dł. 3cm. Długość 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 31, dotyczy - pakiet 25,poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 nitynowego koszyka do przechwytywania i wydobywania złogów. Specjalna konstrukcja umożliwia lekarzowi chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów stosowany w całym układzie moczowym. Rozmiary 1,5F, 2,0 F długość 120 cm, koszyczek 8-11 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.


Pytanie 32, dotyczy - pakiet 25,poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 Zestaw rozszerzadeł prostych wykorzystywanych do wytworzenia przetoki nerkowej, wykonane z PEBA. Produkt sterylny

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 33, dotyczy - pakiet 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.



Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykającym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 34, dotyczy - pakiet 40, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (18-22G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (22-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

22G- 0,9mm x 25 mm . - przepływ 31ml/min.;

20G- 1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min.;

18G- 1,3mm z 31 mm. - przepływ 100ml/min.;

18G- 1,3mm x 50 mm. - przepływ 90ml/min.;

16G x 1,7 mm x 31 mm – przepływ 183 ml/min;

14G x 2,1 mm x 31 mm – przepływ 272 ml/min do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 35, dotyczy - pakiet 40, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (124G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26-24G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min

24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 36, dotyczy - pakiet 40, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 kranika odcinający do terapii dożylniej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatozem położenia otwarty/ zamknięty ,3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętkę luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,26 ml, bez znaczników (czerwony i niebieski) , uniwersalny , pokrętło w kolorze niebieskim . Sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu) , opakowanie medyczne typu blister.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 37, dotyczy - pakiet 45, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) ,), igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS ,Odpowietrznik zaopatrzone w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,9999941-oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%. (potwierdzone wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór /pochewka) ,nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 180 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 38, dotyczy - pakiet 45, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 180 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 39, dotyczy - pakiet 45, poz.1 – 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w pozycjach 1-2 zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu, napisu lub innego międzynarodowego oznakowania potwierdzającą brak zawartości ftalanów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 40, dotyczy - pakiet 52, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 strzykawki 3-częściowej, jałowa, końcówka luer-lock - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 41, dotyczy - pakiet 52, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 strzykawce 3-częściowej, jałowa, końcówka luer-lock - 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 42, dotyczy - pakiet 52, poz.1,2,5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w pozycjach 1,2,5 zaoferowania strzykawek kompatybilnych z lekami cytostatycznymi, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 43, dotyczy - pakiet 52, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 strzykawki trzyczęściowej, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z



podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papierfolia, opakowanie 85 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 44, dotyczy - pakiet 52, poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 strzykawki trzyczęściowej, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papierfolia. opakowanie 85 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 45, dotyczy - pakiet 52, poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 5 jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer-lock, pojemność 10 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków) -potwierdzone oświadczeniem producenta, czarna niezmywalna, pojedyncza skala co 0,2 ml, podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka, logo producenta na cylindrze, opakowanie 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 46, dotyczy - pakiet 52, poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 strzykawki doustnej 10 ml z purpurowym tłokiem, skalowana w łyżeczkach ml, sterylna, pakowana pojedynczo razem z koreczkiem do zamknięcia na czas transportu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 47, dotyczy - pakiet 59, poz.2,3,4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje w pozycjach 2,3,4 dostawy cewników moczowodowych z mandrynem metalowym lub poliestrowym do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 48, dotyczy - pakiet 83, poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w pozycji 1 dostawy igieł do nefrostomii, dwuczęściowych skalowanych co 1 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 49, dotyczy - pakiet 83, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 zestawu rozszerzadeł prostych z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadzie, wykorzystywany do wytworzenia przetoki nerkowej. Rozmiar CH6, CH8 + rozrywalna koszulka. Produkt sterylny.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 50, dotyczy - pakiet 83, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 zestawu rozszerzadeł prostych z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle, wykorzystywany do wytworzenia przetoki nerkowej. Rozmiar CH6, CH8, CH11 + rozrywalna koszulka. Produkt sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 51, dotyczy - pakiet 92

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego – przezroczysta, stożkowa probówka 13,5ml, pokrywka umożliwiająca oznaczenie próbki i jej transport, żeński łącznik do podłączenia z urządzeniem ssącym i męski łącznik zakończony końcówką schodkową z kontrolą odsysania do połączenia z cewnikiem do odsysania. Produkt sterylny, wolny od lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 52, dotyczy - pakiet 1, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 strzykawki trzyczęściowej do insuliny 1 ml, U-100, bezpieczna, z wbudowaną igłą w rozmiarze 29 G 0,33 x 12,5 mm wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 53, dotyczy - pakiet 1, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 strzykawki trzyczęściowej do tuberkuliny 1ml, bezpieczna, z wbudowaną igłą w rozmiarach do wyboru Zamawiającego 25 G 0,5 x 16 mm, 27 G 0,4 x 12,5 mm lub 26 G 0,45 x 10 mm wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała dobrze widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku lateksu, op. 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 54, dotyczy - pakiet 1, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 strzykawki cewnikowa, janeta, do płukania cewnika, pęcherza 100 ml z podwójnym gumowym uszczelniaczem tłoka. Opakowanie 45 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.




Pytanie 55, dotyczy - pakiet 1, poz.3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 3 oczekuje zaferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Adamczyk

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

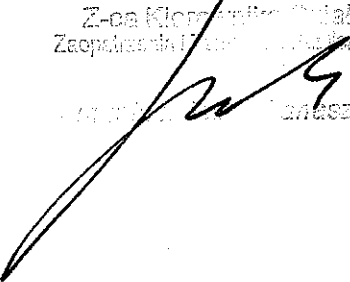Małgorzata Cierpka

Z-ca Kierownika Biura
Zaproszenia i Wykonania Zamówień Publicznych

Janusz