



Słupsk, dnia 07.05.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa odczynników laboratoryjnych i pisaków laboratoryjnych”- nr postępowania 33/PN/2024

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

PYTANIE 1 – część 6, pozycja 18

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu (części) pozycji nr 18 z części 6 – pojemnik z PP 120 ml z białą zakrętką z PE – autokl., co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy części 3, poz. 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy części 3, poz. 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów zawierających 25 sztuk w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Dotyczy części 9 – czy Zamawiający wymaga testu kasetkowe z czasem odczytu 5 minut?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy części 9 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 100% i swoistości 95,2% względem mikroskopii?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy części 10, poz. 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kasetkowych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Dotyczy części 10, poz. 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów zawierający 20 sztuk w opakowaniu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Dotyczy części 10, poz. 2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów zawierający 20 testów w opakowaniu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Dotyczy części 10, poz. 2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości i swoistości >99,9% dla rotawirusa i adenowirusa, o czułości 87,3% i swoistości >99,9% dla norowirusa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Dotyczy części 10, poz. 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów zawierający 150 testów w opakowaniu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Dotyczy części 10, poz. 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 82% i swoistości 89%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Dotyczy części 10, poz. 6 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch oddzielnych testów: do wykrywania grypy A, grypy B, RSV i adenowirusa w próbkach wymazów z nosogardzieli, popłuczyn z nosogardzieli i aspiratów o wskazanej przez Zamawiającego czułości i swoistości oraz do wykrywania SARS-CoV-2 (bez oznaczania bakterii *Mycoplasma pneumoniae*)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13:

Dotyczy części 23 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch oddzielnych testów: do wykrywania grypy A, grypy B, RSV i adenowirusa w próbkach wymazów z nosogardzieli, popłuczyn z nosogardzieli i aspiratów o wskazanej przez Zamawiającego czułości i swoistości oraz do wykrywania SARS-CoV-2?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:

Dotyczy część 11 poz. 2 : Czy Zamawiający dopuszcza Kasetki histopatologiczne z przykrywką Kolor: pomarańczowym, różowym, zielonym, żółtym, niebieskim, pistacjowym, fioletowym, szarym. Wym. kasetki 6mmx28mmx40,5, 62 kwadratowe otwory o wymiarach 2mmx2mm w obu częściach Skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Dotyczy część 11 poz. 4 : Kasetki histopatologiczne biopsyjne z przykrywką Kolor: pomarańczowym, różowym, zielonym, żółtym, niebieskim, pistacjowym, fioletowym, szarym. Kwadratowe otwory o wymiarach 1mmx1mm. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Dotyczy część 11 poz. 5 : Torebki histopatologiczne do przeprowadzania bardzo drobnych wycinków 30 x 50 mm; torebki wykonane z siateczki z materiału odpornego na odczynniki?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 17:

1. Czy Zamawiający w części 4 pozycji 2 dopuści probówki o pojemności 10 ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 18:

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w części 3 pozycji 3 chodzi o 2000 oznaczeń czy 2000 opakowań przyjmując, że opakowanie zawiera 5 oznaczeń?

Odp. Zamawiającego: Oznaczenia. Zmieniony załącznik nr 2 formularz asortymentowo-ilościowy w załączeniu do odpowiedzi.

Pytanie nr 19:

3. Czy Zamawiający w części 9 dopuści test charakteryzujący się czułością na poziomie 95,1% oraz swoistością na poziomie 97,7%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

4. Czy Zamawiający w części 10 pozycji 1 dopuści test o parametrach czułość > 99,9% oraz swoistość 99,7% w konfekcji 40 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 21:

5. Czy Zamawiający w części 10 pozycji 2 dopuści test o parametrach: czułość: dla Rotawirusów 97,3%, dla Adenowirusów 95,2%, dla Norowirusów >99,9% Specyficzność: dla Rotawirusów 97,1%, dla Adenowirusów 97,7%, dla Norowirusów 98,1%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22:

6. Czy Zamawiający w części 10 pozycji 3 dopuści konfekcję opakowania 250 testów z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 23:

7. Czy Zamawiający w części 10 pozycji 6 dopuści test o parametrach czułość i specyficzność dla poszczególnych oznaczeń $\geq 91\%$?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 24:

8. Czy Zamawiający w części 14 pozycjach 3-6 dopuści 50 sztuk po 0,75 ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25:

9. Czy Zamawiający w części 15 dopuści opakowanie zawierające 80 fiolek?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 26:

10. Czy Zamawiający w części 23 dopuści test immunochromatograficzny do diagnostyki w wymazach z nosogardła wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B, wirusa RSV, Adenowirusa, SARS-Cov-2 oraz dodatkowo Mycoplasma pneumoniae?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane od wartości netto?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28:

Dotyczy pkt. 2c) Formularza ofertowego oraz §5 ust. 1 wzoru umowy dostawy dla części 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu z terminem ważności min. 6 m-cy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Dotyczy §1 ust. 5 umowy dostawy oraz pkt 2d) i e) Formularza ofertowego: Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów na zgodne ze wzorem umowy tj. „Ponadto zobowiązuję się okazać w/w dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego. (dotyczy wyrobów medycznych).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30:

Dotyczy informacji pod formularzem cenowym dla Części 17: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na samodzielne pobieranie przez Zamawiającego kart charakterystyki ze wskazanych przez Wykonawcę stron internetowych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 31:

1. Czy w części nr 2, pkt. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkich testów immunochromatograficznych pakowanych po 10 szt. z możliwością fakturowania opakowań ułamkowych np. 0,25 opakowania, czyli 5 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań w tabeli?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 32:

2. Czy w części nr 2, pkt. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkich testów Immunochromatograficznych AMP/COC/OPI/THC/MET/BAR/BZD/TCA/MTD/MDMA, do których zostaną dodane testy kasetkowe BUP?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33:

3. Czy w części nr 2, w pkt. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkich testów immunochromatograficznych do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale, o czułości 100% i specyficzności 98%, umożliwiające wykrycie hemoglobiny ludzkiej w stężeniu ≥ 10 ng/ml.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34:

4. Czy w części nr 2, w pkt. 2 Zamawiający dopuści szybkie testy immunochromatograficzne w opakowaniu zbiorczym po 20 sztuk z możliwością fakturowania opakowań ułamkowych np. 0,25 opakowania, czyli 5 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań w tabeli?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 35:

Dotyczy Załącznik nr 2 do IDW_Formularz asortymentowo-ilościowy, część 22

1.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w punkcie 8 tabeli przeciwciała Inhibina - klon MRQ-63.

Uzasadnienie: Przeciwciała Inhibina - klon R1 zostało wycofane z oferty w 2020 roku.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 36:

Dotyczy Załącznik nr 2 do IDW_Formularz asortymentowo-ilościowy, część 22

2.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego przeciwciała oczekuje w pozycji 12?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w Części nr 22 poz. 12 powinno być Cytokeratyna 19 – klon A53-B/A2.26. Zmieniony załącznik nr 2 formularz asortymentowo-ilościowy w załączeniu do odpowiedzi.

Pytanie nr 37:

Dotyczy Załącznik nr 2 do IDW_Formularz asortymentowo-ilościowy, część 22

3.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w punkcie 21 tabeli przeciwciała CD117 EP10.

Uzasadnienie: Przeciwciała CD117 9.7 zostało wycofane z oferty w 2020 roku.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 38:

Dotyczy Załącznik nr 2 do IDW_Formularz asortymentowo-ilościowy, część 22

4.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiego klonu oczekuje w pozycji 39 bcl-2 ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie ma to znaczenia.

Pytanie nr 39:

Dotyczy Załącznik nr 2 do IDW_Formularz asortymentowo-ilościowy, część 22

5.Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy omyłkowo nie wpisał Jm a'51 zamiast Jm a'50 w punkcie 61 tabeli "β-catenina".

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że omyłkowo wpisano w kolumnie Jm a'51 zamiast a'50. Zmieniony załącznik nr 2 formularz asortymentowo-ilościowy w załączeniu do odpowiedzi.

Pytanie nr 40:

Dotyczy Załącznik nr 2 do IDW_Formularz asortymentowo-ilościowy, część 22

6.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wyceny poszczególnych pozycji dla punktu 62 tabeli "Detekcja na 8 000 oznaczeń". Swoją prośbę argumentujemy koniecznością podania i wycenienia poszczególnych składowych w celu ułatwienia późniejszego procesu składania i realizacji zamówień.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 41:

Dotyczy Załącznik nr 2 do IDW_Formularz asortymentowo-ilościowy, część 22

7.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania odczynników gotowych do użycia i przystosowanych do pracy z aparatem oraz posiadających minimum 9 miesięczny termin przydatności do użycia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza dla Części nr 22.

Pytanie nr 42:


8.Dot. części 22 przedmiotowe środki dowodowe:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą folderu oferowanego analizatora oraz oświadczenia o posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego ulotek oferowanych odczynników. Jednocześnie w ofercie wskażemy adres strony internetowej gdzie ww dokumenty są dostępne całodobowo.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 43:

9.Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ? Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

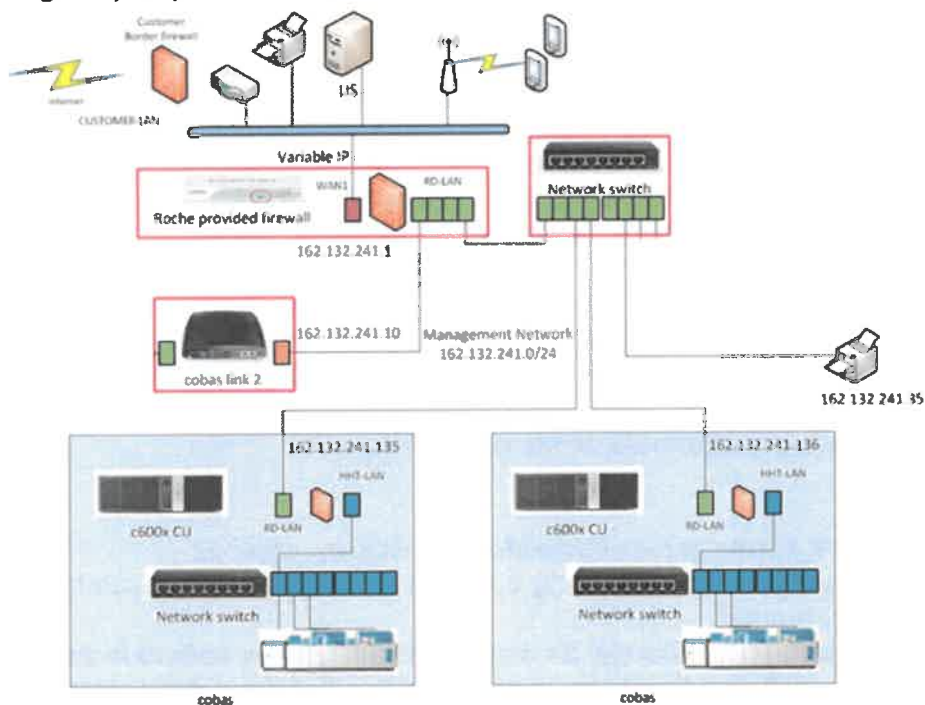

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas18.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rin-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Część II - Wzór Umowy

par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (email, strona internetowa)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 45:

Część II - Wzór Umowy

par. 3 ust. 8-11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 46:

Część II - Wzór Umowy

par. 3 ust. 8-11

czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47:

Część II - Wzór Umowy

par. 5 ust.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie:

Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza dla Części nr 17.

Pytanie nr 48:

Część II - Wzór Umowy

par. 7 ust. 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 49:

Część II - Wzór Umowy

par. 8 ust. 3 pkt 14- 18 W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę?

1.Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §6 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).

2.Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).

3.Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.

4.Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.

5.Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.

6.W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.

7.W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.

8.W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.

9.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.

10.Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50:

Część II - Wzór Umowy

par. 8 ust. 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 51:

Wzór umowy dzierżawy CZ. II dla cz. 22

par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zrezygnować z wersji pisemnej instrukcji i pozostać przy formie elektronicznej tj. pliku przesyłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej? Rozwiązanie takie należy uznać za optymalniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zapewniające Zamawiającemu bieżący i nieograniczony dostęp, zwłaszcza wobec postępującego procesu elektronicznej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 52:

Wzór umowy dzierżawy CZ. II dla cz. 22

par. 3 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 53:

Wzór umowy dzierżawy CZ. II dla cz. 22

par.3 ust. 12 i13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni kalendarzowe" na "dni robocze"?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54:

Wzór umowy dzierżawy CZ. II dla cz. 22

par. 4 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 55:

Dotyczy: Część 4

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłoża gotowe na płytkach 90 mm w pozycji nr 12 podłoża Schaedler Agar + 5% Sheep Blood + Vitamin K3?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 56:

Dotyczy: Część 4

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłoża płynne w probówkach gotowe do użytku w pozycjach nr 1-3 podłoży z terminem ważności 12 miesięcy od daty produkcji i minimum 10 miesięcy od daty dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 57:

Dotyczy: Część 4

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłóża płynne w probówkach gotowe do użytku w pozycji nr 4 podłóża z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 58:

Dotyczy: Część 4

4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłóża gotowe na płytkach 90 mm w pozycjach nr 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15-20, 22 oraz 23 podłóży z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 59:

Dotyczy: Część 4

5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłóża gotowe na płytkach 90 mm w pozycji nr 3 podłóża z terminem ważności 12 miesięcy od daty produkcji i minimum 10 miesięcy od daty dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 60:

Dotyczy: Część 4

6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłóża gotowe na płytkach 90 mm w pozycji nr 1 podłóża z terminem ważności 56 dni od daty produkcji i minimum 7 tygodni od daty dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 61:

Dotyczy: Część 4

7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłóża gotowe na płytkach 90 mm w pozycjach nr 5, 12 i 21 podłóży z terminem ważności 45 dni od daty produkcji i minimum 5 tygodni od daty dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 62:

Dotyczy: Część 4

8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłóża gotowe na płytkach 90 mm w pozycji nr 6 podłóża z terminem ważności 55 dni od daty produkcji i minimum 6 tygodni od daty dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 63:

Dotyczy: Część 4

9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłóża gotowe na płytkach 90 mm w pozycji nr 9 podłóża z terminem ważności 65 dni od daty produkcji i minimum 8 tygodni od daty dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 64:

Dotyczy: Część 4

10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłoża gotowe na płytkach 90 mm w pozycji nr 14 podłoża z terminem ważności minimum 3 miesiące od daty dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 65:

Dotyczy: Część 4

10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w sekcji podłoża płynne w probówkach gotowe do użytku w pozycji nr 3 podłoża, które nie zostało sklasyfikowane jako wyrób medyczny?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 66:

Dotyczy: Część 15

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 zestawu Cryobank, który w opakowaniu zawiera 80 fiolek?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 67:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 w przedmiotowym postępowaniu:

1.Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 2 test o poziomie wykrywalności 10 ng/ml (przewyższające wymagania SIWZ). Test o czułości 98 % oraz swoistości 98,7%

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 68:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 9 w przedmiotowym postępowaniu:

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 testu o czułości 96,2 % oraz swoistości 97,8%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 69:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 10 w przedmiotowym postępowaniu:

3.Prosimy o wyłączenie pozycji 3, 4 z pakietu 10 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 10 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 70:

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycji 2 testu o :

- dla norowirusa – czułość 95,7 %, swoistość 91,7 %
- dla rotawirusa – czułość 97,3 %, swoistość 97,1 %

- dla adenowirusa – czułość 95,2 %, swoistość 97,7 %

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 71:

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycji 6 testu o:

- dla SARS-CoV- 2: czułość 96,4%, swoistość 99,0 %
- dla Grypy typu A: czułość 95%, swoistość 99,1 %
- dla Grypy typu B: czułość 92,9%, swoistość 99,1%
- dla RSV: czułość 94,3%, swoistość 96,2%
- dla adenowirusa: czułość 96,9%, swoistość 98,6%
- dla M. Pneumoniae: czułość 91,8%, swoistość 98,0 %

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 72:

SWZ:

1.Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, 5 i 6 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 73:

Projekt umowy:

2.Dotyczy paragrafu 3 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 74:

Projekt umowy:

3.Dotyczy paragrafu 3 ust. 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Zamawiający zastrzega, że minimalny poziom zamówienia wyniesie 70% wartości zamówienia”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 75:

Przedmiotu zamówienia:

4.Dotyczy części nr 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści dzbanek miarowy o poj. 3000 ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 76:

Przedmiotu zamówienia:

5. Dotyczy części nr 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści ezy z oczkiem 10 µl z zakończeniem typu igła?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 77:

Przedmiotu zamówienia:

6. Dotyczy części nr 6, pozycja 25

Prosimy o dopuszczenie probówek o poj. 10 ml (Φ16x105 mm), stożkowych, z PS, ze znacznikami poj.: 1; 2,5; 5 i 10 ml - kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1 ml osadu moczu



Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 78:

Przedmiotu zamówienia:

7. Dotyczy części nr 6, pozycja 25

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. Nr 6 prosimy o dopuszczenie probówek o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), okrągłodennych, z PS, bez znaczników.



Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 79:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr 24, pozycji nr 1 i 2, zestawu transportowego składającego się z wymazówki oraz probówki transportowej z podłożem do transportu wirusów w ilości 1000 szt. takich zestawów?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 80:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 81:

Pytanie nr 2

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 82:

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 83:

Pytanie nr 4

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 84:

Pytanie nr 5

Część 11, poz. 1 i 2:

Z uwagi na możliwą omyłkę pisarską Zamawiającego (prawie identyczny opis w ww. pozycjach), wnosimy o dokładną weryfikację opisów w poz. 1 i 2 i przedłużenie możliwości zadawania pytań we wspomnianym zakresie po ewentualnych modyfikacjach w pakiecie. Z opisów wynika, że zarówno w poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga kasetek bez przykrywki.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 85:

Pytanie nr 6

Część 11, poz. 1 / 2:

Czy jeśli Zamawiający oczekuje w poz.1 / 2 kasetek z przykrywką, Zamawiający dopuści kasetki histopatologiczne o standardowych wymiarach, dostępnych w różnych kolorach. Kasetki posiadające po 120 otworów w podstawie i przykrywce o wymiarach 2x2mm; otwór mocujący kompatybilną przykrywkę o wymiarach 4mm. Skośna faktura przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego nr badania każdą techniką.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 86:

Pytanie nr 7

Część 11, poz. 1 i 2:

Prosimy o dopuszczenie kasetek o standardowych wymiarach tj. 6x27x40mm, dostępnych w kolorach: żółte, białe, morskie, niebieskie, zielone, purpurowe, pomarańczowe, różowe, brzoskwiniowe, beżowe.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 87:

Pytanie nr 8

Część 11, poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie kasetek z przykrywką na zawiasie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 88:

Pytanie nr 9

Część 11, poz. 3 i 4:

Czy Zamawiający nie oczekuje w poz. 3 i 4 tej samej kasetki z wewnętrzną komorą o wymiarach otworów 0,35mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 89:

Pytanie nr 10

Część 11, poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie kasetki bez wewnętrznej komory, posiadającą otwory o wymiarach 1x1mm; dostępnej w kolorach: żółte, białe, niebieskie, zielone, pomarańczowe, różowe, beżowe.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 90:

Pytanie nr 11

Część 11, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 31x43 mm ?

Odp. Zamawiającego: zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 91:

Pytanie nr 12

Część 11, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści metalowe przykrywki, kompatybilne z kasetkami z poz.1 / 2; posiadające 34 okrągłe otwory o średnicy 2mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 92:

Pytanie nr 13

Część 11, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu. Umożliwi to złożenie oferty większej ilości wykonawców, niż tylko firmie Anga, która posiada w ofercie określony uchwyt, co jest ograniczeniem konkurencji.

Odp. Zamawiającego: zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 93:

Pytanie nr 14

Część 19, poz. 3, 4, 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie formaliny buforowanej 10% - produkt posiadający IVD, bezbarwnej, klarownej cieczy, pH w 25st.C = 7,2-7,4, zawartość formaldehydu 3-5%. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak

Formularz asortymentowy_ilościowy

Załącznik nr 2

Część 22

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość Jm	Wartość netto za Jm	Wartość netto razem	VAT %	Cena (wartość brutto) razem	Producent nazwa handlowa	nr katalogowy a dla poz. 63 również NR SERYJNY
1	PSA - klon Polyclonal	a'50	2						
2	Desmina - klon DE-R-11	a'50	3						
3	Chromogranina A - klon LK2H10	a'50	3						
4	CD20 - klon L26	a'50	4						
5	p53 - klon BP-53-11	a'50	4						
6	Cytokerylina (Pan) - klon AE1/AE3 & PCK26	a'50	15						
7	Aktyna Smooth Muscle (SMA) - klon 1A4	a'50	2						
8	Inhibina - klon R1	a'50	2						
9	EMA - klon E29	a'50	2						
10	PSAP - klon PASE/4LJ	a'50	1						
11	CD45 (LCA) - klon RP2/18	a'50	3						
12	Cytokeratyna 19 - klon A53-B/A2.26	a'50	4						
13	GFAP - klon EP672Y	a'50	2						
14	HSA - klon OGH1E5	a'50	2						
15	HER2 szkiełka kontrolne	a'10	17						
16	Progesteron 1E2	a'50	8						
17	S-100 4C4.9	a'50	2						
18	Vimentyna V9	a'50	3						
19	CD34 - klon QBEnd/10	a'50	3						
20	CD68 - klon KP-1	a'50	2						
21	CD117 C-kit - klon 9.7	a'50	2						
22	Melan A - klon A103	a'50	3						
23	HER2 - klon 4B5	a'50	11						
24	Ki-67	a'50	16						
25	Estrogen - klon SP1	a'50	9						
26	CD3 - klon 2G16	a'50	4						
27	CD31 - klon JC70	a'50	2						
28	CD23 - klon SP23	a'50	2						
29	Cytokeratyna HMAW 34BE12	a'50	9						
30	Melanosome (HMB45) - klon HMB45	a'50	2						
31	Cytokeratyna 20 - klon SP33	a'50	4						
32	CD10 - klon SP67	a'50	2						
33	Cyklina D1 - klon SP4-R	a'50	2						
34	p63 - klon 4A4	a'50	10						
35	E-keadheryna - klon 36	a'50	3						
36	CD5 - klon SP19	a'50	2						
37	Glypikan 3 - klon GC33	a'50	1						
38	Cytokeratyna 7 - klon SP52	a'50	10						
39	bcl-2	a'50	1						

Formularz asortymentowo_ilościowy

Część 3

Lp	Przedmiot zamówienia	Jm	ilość jm	Wartość netto za jm	Wartość netto razem	VAT %	Cena (wartość brutto) razem	Producent nazwa handlowa	nr Katalogowy
1	Szybki test immunochromatograficzny kasekowy (jedna lub dwie kasetki) do identyfikacji 5 karbapenemaz w jednym oznaczeniu (OXA-48, KPC, NDM, VIM i IMP) (1 op = 20 testów)	op.	40						
2	Szybki test immunochromatograficzny kasekowy do identyfikacji minimum trzech karbapenemaz typu OXA dla Acinetobacter spp. (OXA-23, OXA-40, OXA-58) (1 op = 20 testów)	op	30						
3	Test wykrywający karbapenemazy u Enterobacteriaceae i Pseudomonas oparty na metodzie Carba NP.	ozn.	2000						
4	Szybki test immunochromatograficzny kasekowy do wykrywania minimum dwóch B-laktamaz typu CTX-M (CTX-M-14 i CTX-M-15)	ozn	200						

* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego iden

W przypadku produktów sklasyfikowanych jako substancje niebezpieczne konieczna Karta Charakterystyki, dostarczona z pierwszą dostawą lub na adres e-mail i.gierszynska@szpital.slupsk.pl

