



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Elbląg, dnia 25.06.2024r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Nr sprawy **ZP/20/2024**.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie:

ręcznik 40 cm x 40 cm – 4 szt

osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x150 cm w kształcie worka, ze wzmocnieniem włókninowym o wym. min. 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy. Łączna gramatura serwety min. 70 g/m² – 1 szt

Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m²- 1 szt

Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x260 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m² , ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m² - 1 szt

10. serweta anestetyczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymiarze 45x65 cm

wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m², ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m² , - 1 szt.

Taśma samoprzylepna włókninowa 10x50 cm – 1 szt

Fartuchy Zgodny z normą PN EN 13795-1.

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 -1
wymagania wysokie

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie:

ręcznik 40 cm x 40 cm – 4 szt

osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x150 cm w kształcie worka, ze wzmocnieniem włókninowym o wym. min. 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy. Łączna gramatura serwety min. 70 g/m² – 1 szt

Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m²- 1 szt

serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m² - 1 szt

9. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m², z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m²- 1 szt

Taśma samoprzylepna włókninowa 10x50 cm – 1 szt

Fartuchy Zgodny z normą PN EN 13795-1.

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 -1
wymagania wysokie

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie:

ręcznik 40 cm x 40 cm – 4 szt

osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x150 cm w kształcie worka, ze wzmocnieniem włókninowym o wym. min. 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy. łączna gramatura serwety min. 70 g/m² – 1 szt

taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 10x50 cm- 1 szt

8. serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m² - 1 szt

9. serweta do operacji stawu kolanowego o wymiarach 320x225 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m², z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m²- 1 szt

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 -1

wymagania wysokie

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie:

Ręczniki 40x40 cm- 2 szt

3. Serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt

4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56(+/- 0,5) g/m²- 1 szt

5. Osłona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt

6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m², z samouszczelniającym się neoprenowym podwójnym otworem o średnicy 6 i 7 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz ze zintegrowanym uchwytem typu rzep, z workiem do zbiórki płynów oraz zaworem do podłączenia drenu- 1 szt

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 -1

wymagania wysokie

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie:

Ręczniki 40x40 cm- 2 szt

3. Serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt

4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56(+/- 0,5) g/m²- 1 szt

5. Osłona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt

6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m², z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w obszarze krytycznym 109 (+/- 0,5) g/m², ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów- 1 szt

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 -1

wymagania wysokie

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie:

Ręczniki 40x40 cm- 2 szt

3. Serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x90 cm- 1 szt

4. serweta do operacji kończyny o wymiarach 300x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m², z samouszczelniającym się



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożeń pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

otworem o średnicy 3 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w strefie krytycznej 109 (+/- 0,5) g/m², ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów- 1 szt

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 -1

wymagania wysokie

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 1 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie:

Ręczniki 40x40 cm- 4 szt

3. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x150 cm, warstwa chłonna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o wymiarach 75 x 90 cm , bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 130 g/m²– 1 szt

4. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m²- 1 szt

5. Taśma samoprzylepna włókninowa 10x50 cm- 1 szt

8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m² - 1 szt

9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x260 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56,5 g/m² , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m² - 1 szt

10. serweta anestetyczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymiarze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE)

o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m² , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m² - 1 szt

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 -1

wymagania wysokie

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie:

Osłona na stolik Mayo 80 cm x150 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana standardowo

d) ręczniczki 40 cm x 40 cm – 2szt.

Serweta główna wykonana z materiału 3-warstwowego (włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej), gramatura min. 70 g/m², , odporność na przenikanie cieczy >190 cm H₂O.

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 -1

wymagania wysokie

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie:

ręczniki 40 x 40 cm- 2 szt

3. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 150 cm- 1 szt

4. serweta samoprzylepna o wymiarze 75x90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m²- 2 szt

5. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m² (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm) –1 szt

6. serweta samoprzylepna anestetyczna o wymiarze 150x240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 (+/- 0,5) g/m² (dzielony pasek samoprzylepny na dłuższym boku 15+70+15 cm)

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 -1

wymagania wysokie

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepek chirurgicznego tylko w jednym kolorze, niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 9 poz. 2-3

Proszę o dopuszczenie czepków chirurgicznych w typie furażerka, wiązanego na troki, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4

Proszę o dopuszczenie czepków typu beret w opakowaniu 100 szt. – folia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

- 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem aseptyki

- 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

- 1 serweta do operacji kończyn 225 x 300 cm z elastycznym otworem z neoprenu (19x26cm) o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów, otwór umieszczony centralnie w odległości min. 100cm od krótszej krawędzi serwety

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z materiału 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej), gramatura 55 g/m², z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m² (łącznie gramatura 110g/m²), odporność na przenikanie cieczy >125 cm H₂O, Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/mokro odpowiednio min. 140 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Sterylizacja tlenkiem etylenu. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Produkt dostarczany ma być w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (brązowy)+karton wewnętrzny (biały). Karton wewnętrzny etykietę wyrobu oraz perforowany brzeg – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. W skład zestawu wchodzi:

1 taśma przyklepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przyklepne 75 x 90 cm

1 serweta przyklepna 180 x 180 cm (taśma przyklepna min. 80cm)

1 serweta przyklepna 150 x 240 cm (taśma przyklepna min. 80cm)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m². Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy.

Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: min. 147/144 kPa

Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczoną lokalizację w polu operacyjnym

Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 4 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego, klej hipoalergiczny

Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające min. następujące informacje: nazwa marki, LOT, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Sterylizacja tlenkiem etylenu.

przechowywania w warunkach bloku operacyjnego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 14 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o wymiarach 75x100cm z regulowany otworem 0-26 x 11cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 14 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z otworem o wymiarach 5x7cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 14 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z laminatu trzywarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 65g/m², spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny o wymiarach: 101cm (+-2cm) x 225cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 12 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta dotyczące wchłaniałości podkładu, w zamian za badania akredytowanego laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 12 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści nazwę produktu i nazwę producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 12 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 152cm x 102cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści warstwę chłonną o wymiarach 51 x 129cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetą z wycięciem „U” większą niż wymagana tj. w wymiarze 225x280cm, spełniającego pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 3

Prosimy o dopuszczenie zastawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację)

1 serweta operacyjna wzmocniona do operacji ręki w kształcie litery "T" 370/175 cm x 365 cm z poszerzonym ekranem anestetycznym oraz samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożeń pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach (100 cm x 65 cm, +/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5g/m²). Odporność na przenikanie płynów min. 174 cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 280/270 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 10 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaferowania uchwytu typu rzep do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 2,5 x 20/ 24 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaferowania folii chirurgicznej o powierzchni lepnej:

40x35cmw miejsce 40x45cm

45x50cm w miejsce 45x55 cm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: W niniejszym postępowaniu nie ma Pakietu nr 16. Zamawiający wnioskuję, że Wykonawca ma na myśli Pakiet nr 13 – Folia operacyjna.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 16 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaferowania folii chirurgicznej o powierzchni lepnej 45 x 50 cm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: W niniejszym postępowaniu nie ma Pakietu nr 16. Zamawiający wnioskuję, że Wykonawca ma na myśli Pakiet nr 13 – Folia operacyjna.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 14 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaferowania serwety o wymiarach 38x45cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 14 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaferowania serwety z otworem o średnicy 8cm,, spełniającej pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 14 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaferowania serwety samoprzylepnej o wymiarach 75 x 90 cm z możliwością regulacji otworu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie zestawu obłożeń pola operacyjnego przy operacji dłoni o poniższym składzie i parametrach:

a)Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 140cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 80x190cm – 1 szt.

b)Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 60 cm x 145 cm, składana teleskopowo do wewnątrz – 1 szt.

c)Serweta chirurgiczna o wymiarach 220x320cm do operacji ręki z elastycznym elementem z neoprenu (30 cm x 30 cm) i umieszczonym w nim otworem o średnicy 3 cm, (otwór w odległości około 125 cm od krótszej krawędzi serwety)

d) Ręczniczki 30 cm x 40 cm – 2szt.

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP+PE 62 g/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m², gramatura w strefie wzmocnionej min. 132 g/m², odporność na przenikanie cieczy >240 cm H₂O, Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/mokro odpowiednio min. 200 kPa. Sterylizacja



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50


https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

tlenkiem etylenu. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Podwójne opakowanie transportowe: karton zewnętrzny oraz wewnętrzne zabezpieczenie w postaci foliowego worka w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie zestawu obłożenia pola operacyjnego przy operacji dłoni o poniższym składzie i parametrach:

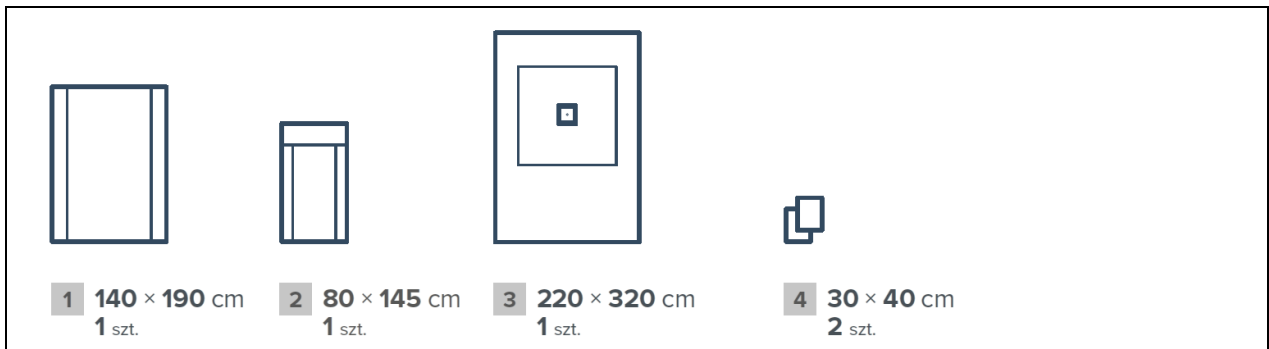

a) Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 140cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 80x190cm – 1 szt.

b) Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 60 cm x 145 cm, składana teleskopowo do wewnątrz – 1 szt.

c) Serweta chirurgiczna o wymiarach 220x320cm do operacji ręki z elastycznym elementem z neoprenu (30 cm x 30 cm) i umieszczonym w nim otworem o średnicy 3 cm, (otwór w odległości około 125 cm od krótszej krawędzi serwety)

d) Ręczniczki 30 cm x 40 cm – 2szt.


Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP+PE 62 g/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace 70 g/m², gramatura w strefie wzmocnionej min. 132 g/m², odporność na przenikanie cieczy >240 cm H₂O, Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/mokro odpowiednio min. 200 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Podwójne opakowanie transportowe: karton zewnętrzny oraz wewnętrzne zabezpieczenie w postaci foliowego worka w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie zestawu uniwersalnego o poniższym składzie i parametrach:

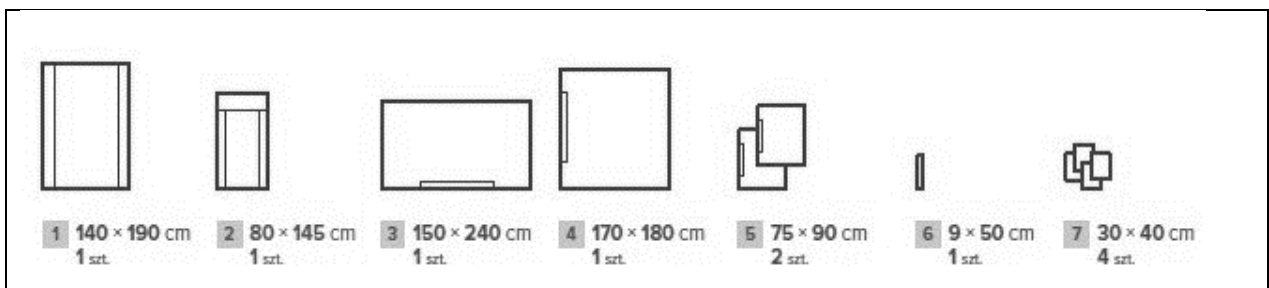



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłoża pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

1. serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)- 1 szt
 2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt.
 3. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt.
 4. serweta samoprzylepna o wymiarze 75x90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62 g/m²- 2 szt.
 5. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 170x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m² (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm) –1 szt
 6. serweta samoprzylepna anestetyczna o wymiarze 150x240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m² (dzielony pasek samoprzylepny na dłuższym boku 15+70+15 cm) –1 szt
- Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorpcji płynów laminatu 200 ml/ m².
Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa
Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.
Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału.
Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie.
Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, odporności na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa
Sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², o odporności na penetrację płynów 188 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
 - 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
Sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Pytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocnioną chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, z warstwą chłonną 60x145cm, składana teleskopowo

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, z warstwą chłonną 65x190cm

Sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami, pasek samoprzylepny nie dzielony na dłuższym boku 5x85cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami, pasek samoprzylepny na dłuższym boku 5x85cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa

Sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 226 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 268,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 141,5 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Pytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści 24 etykiety zawierające informację: REF, nazwa producenta, LOT, data ważności, kod kreskowy lub kod QR?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepyłającej włókniny (25g/m²+ 25g/m² + 25g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepyłającej włókniny (25g/m²+ 25g/m² + 25g/m²), troki zgrzewane ultradźwiękowo, poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną wiązana na troki typu antifog typ IIR?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 200szt czy 200 op=50szt?

Odpowiedź: 200 sztuk.

Pytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny o konstrukcji umożliwiającej zabezpieczenie oraz szyi, wykonany z włókniny perforowanej 25g/m², z możliwością zawiązania na końcu. Kolor zielony, bez wstawki przeciwpotnej. Opakowanie w formie kartonika z możliwością pojedynczego wyjmowania, ilość w opakowaniu 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Pytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę wykonany z folii PE o gramaturze 0,035mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 56 – dot. Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę o średnicy 80cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę w rozmiarze 90x100cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58 – dot. Pakietu nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 12 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną poliuretanową o grubości 0,03mm, paroprzepuszczalności 850g/m²/24h, posiadające na dwóch bokach nieprzylepne paski?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię o następujących powierzchniach lepnych:

- 15 x 22cm

- 30 x 22cm

- 45x22cm

- 45x49cm

- 45x49cm lub 55x51cm

- 55x51cm lub 84x50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

czy zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietem z elastycznym ściągaczem o szerokości ok. 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku, w rozmiarze uniwersalnym, nie mniejszym niż standardowy rozmiar L - Mankiet 5 cm, Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm); Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko; Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm; Opakowanie x 10 szt. ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Pytanie nr 63 – dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64 – dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 65 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną wiązana na troki ; trójwarstwowa o gramaturze 25g/m² – jednej warstwy; odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, pakowana w kartonik w formie podajnika. 50 szt w kartoniku, w kolorze niebieskim; Spełnia normę PN EN 14683 II

Długość 175 mm +/- 5%

Szerokość złożona 100 mm +/- 5%

Szerokość rozłożona 175 mm +/- 5%

Długość górnego paska 425 mm +/- 5%

Długość dolnego paska 385 mm +/- 5%

Zagłębienie na nos 130 mm +/- 5%

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 66 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2

czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną trzywarstwową z gumką o gramaturze 25 g/m² jednej warstwy, warstwa wewnętrzna typu Meltblown, TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych, opakowanie 50 szt. w kartonik w formie podajnika , w kolorze niebieskim Długość 175 mm Szerokość złożona 95mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 67 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 68 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez możliwości wywiniecia; z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 12 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 13 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70 – dot. Pakietu nr 9 poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę obłoża pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Pytanie nr 71 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4

czy zamawiający dopuści włókninowy czepik chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty delikatną, nieuciskającą gumką z nieperforowanej włókniny PP, przewiewnej, o gramaturze ok. 16 g/m² , w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72 – dot. SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? Podmioty występujący wspólnie ponoszą wspólną odpowiedzialność, dlatego ograniczenie rozliczenia wyłącznie z liderem wydaje się być bezzasadne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 73 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następujących parametrach:

STERYLNY ZESTAW UNIWERSALNY

1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm – 1 szt.

2. ręczniczki 20 cm x 40 cm – 2szt.

3. Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz – 1 szt.

4. Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 90 cm x 75 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² - 2 szt.

5. Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 180 cm x 170 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² – 1 szt.

6. Serweta chirurgiczna z przylepcem o wymiarach 240 cm x 150 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.55g/m² – 1 szt.

Laminat serwet głównych wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej. Odporność na penetrację płynów min. 300 cm H₂O. Zdolność absorpcji płynów laminatu 218 ml/ m² wg. PN-EN ISO 9073-6 Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: min. 245 kPa

Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.

Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.

Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie.

Sterylicacja tlenkiem etylenu. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Produkt dostarczany w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (szary lub brązowy)+karton wewnętrzny (biały). Karton wewnętrzny musi posiadać uchylną klapkę z etykietą wyrobu– w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74 – dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75 – dot. wzoru umowy

Zważywszy na treść § 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Zamawiający zawarł stosowane zapisy w §7 ust. 7 wzoru umowy – Załącznik nr 3.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:

ZP/20/2024

Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy obłożenia pola operacyjnego, odzieży ochronnej i innych materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Pytanie nr 76 – dot. wzoru umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 77 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej z gumką, typu IIR zgodnie z normą europejską EN 14683, ciśnienie różnicowe < 60 Pa/cm² ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 78 – dot. Pakietu nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm? Pozostałe parametry serwety zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 79 – dot. Pakietu nr 14 poz. 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 50 cm? Pozostałe parametry serwety zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 80 – dot. Pakietu nr 14 poz. 4

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z SWZ, jednakże z otworem samoprzylepnym Ø7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski