



Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych **na dostawę sprzętu medycznego, jednorazowego użytku.**

Nr sprawy: [ZP/P/04/22](#)

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. Pytanie 1 dotyczy pakietu 2 poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści maskę pakowaną tylko w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

2. Pytanie 2 dotyczy pakietu 2 poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści maskę dla dorosłych z drenem o długości powyżej 2,0 m (z tolerancją 5%) pakowaną tylko w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

3. Pytanie 3 dotyczy pakietu 2 poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści maskę dla dzieci z drenem o długości powyżej 2,0 m (z tolerancją 5%) pakowaną tylko w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

4. Pytanie 4 dotyczy pakietu 2 poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści maskę dla dorosłych z nebulizatorem i drenem o długości powyżej 2,0 m (z tolerancją 5%) pakowaną tylko w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

5. Pytanie 5 dotyczy pakietu 2 poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści maskę dla dzieci z nebulizatorem i drenem o długości powyżej 2,0 m (z tolerancją 5%) pakowaną tylko w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

6. Pytanie 6 dotyczy pakietu 2 poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny pakowany tylko w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

7. Pakiet nr 2 poz. 8- Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa umożliwiający bezpieczny przezskórny dostęp do jamy opłucnej, otrzewnej oraz worka osierdziowego dzięki zastosowaniu igły Veressa. Zestaw przeznaczony jest do drenażu płynów, oraz może być wykorzystywany do pobierania próbek do celów diagnostycznych lub infuzji w celach terapeutycznych. Wbudowany system zastawek automatycznych zabezpiecza pacjenta

przed ryzykiem powrotnego dostania się powietrza lub płynu a wbudowane łączniki i zawór pozwalają na obejście zastawki i umożliwiają drenaż na wiele sposobów, takich jak grawitacyjny do worka drenażowego, za pomocą podłączenia mieszków niskociśnieniowych (w oparciu o zasadę pompy ssąco-tłoczącej), bądź poprzez podłączenie do zestawu drenażowego. Poliuretanowy cewnik jest widoczny w rtg, odporny na odkształcenia oraz zmniejsza ryzyko zamknięcia światła. Może pozostawać w ciele pacjenta do 29 dni. Cewnik z zawiniętą końcówką typu Pig Tail pozwala na drenaż w przypadku np. ropni, traumatycznych odm opłucnowych czy podskórnych i śródpiersiowych krwiaków opłucnej. Cewnik o długości 40cm umożliwia np. nakłucie jamy opłucnowej u pacjentów otyłych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.

8. Pakiet nr 2 poz. 11, 12, 13, 14 - Czy Zamawiający dopuści z drenem o długości 2,1 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

9. Pakiet nr 2 poz. 15- Czy Zamawiający dopuści duoskop – macintosh 4 / macintosh 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

10. Pakiet nr 2 poz. 22- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

11. Pakiet nr 2 poz. 23- Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

12. Pakiet nr 5 poz. 1- Czy zamawiający dopuści dodatkową gałąź o długości 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 5) do SWZ.

13. Pakiet nr 5 poz. 2- Czy zamawiający dopuści port do odsysania zamykany manualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

14. Pakiet nr 5 poz. 2- Czy zamawiający dopuści objętość oddechową 200-1000 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

15. Pakiet nr 5 poz. 3- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

16. Pakiet nr 5 poz. 3- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

17. Pakiet nr 5 poz. 4- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

18. Pakiet nr 5 poz. 8- Czy zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

19. Pakiet nr 5 poz. 8- Czy zamawiający ma na myśli rurkę intubacyjną zbrojoną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

20. Pakiet nr 5 poz. 10- Czy zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 5) do SWZ.

21. Pakiet nr 5 poz. 13- Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych o długości 60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 5) do SWZ.

22. Pakiet nr 5 poz. 14- Czy Zamawiający wymaga, aby szczoteczka do zębów z możliwością odsysania była wyrobem medycznym klasy IIa? W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, szczoteczka do zębów lub gąbkę z odsysaniem należy traktować jako inwazyjne wyroby medyczne stosowane przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami medycznymi, przeznaczone do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym (źródło ssania) klasy IIa lub wyższej (reguła 5 lit.b). Wobec powyższego stanowią one wyroby medyczne klasy IIa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe.

23. Pakiet nr 5 poz. 15- Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

24. Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane w pakiecie 3, poz. 16. Elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z zaleceniami producenta i wymienione w CE i instrukcji obsługi?

W związku z brakiem powiązań prawnych z producentami elektrod niewymienionych w CE defibrylatora i braku testów potwierdzających pełną kompatybilność, producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

25. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji nr 16 „ Elektroda do defibrylacji do defibrylatora Lifepak 12”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

26. Pakiet nr 4 poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.3 z pakietu nr 4 i utworzenie nowego, odrębnego pakietu 4a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

27. Pakiet nr 4 po. 3- która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora w poz.3?

Connectors available



Odpowiedź:


Zamawiający informuję, że używa końcówkę BD.

- 28.** Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu ze zbiornikiem wyrównawczym z tradycyjnym systemem kroplowym. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ w poz.3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

- 29.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie linii do pomiaru ciśnień z połączeniem bezpinowym w poz.3 zgodnie z poniższym schematem?:

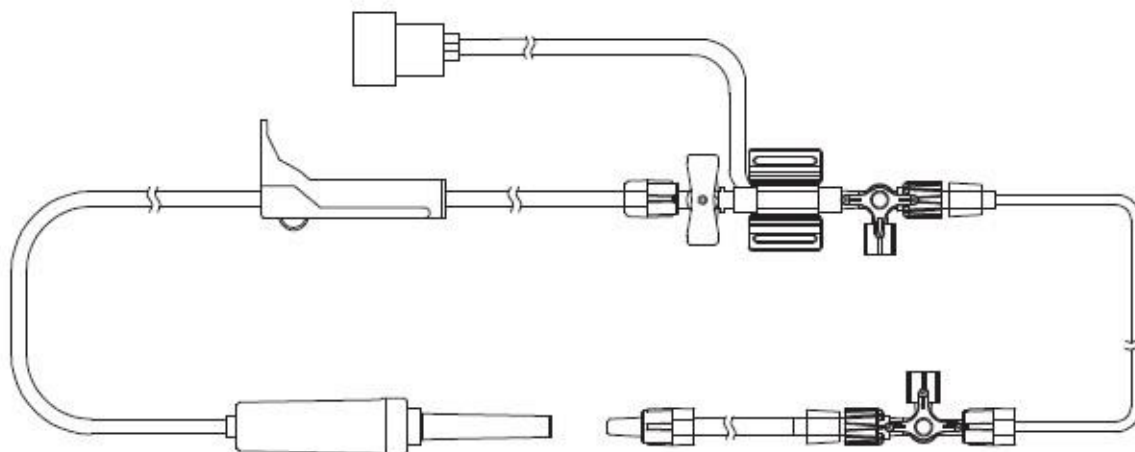

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

- 30. Zadanie 1 pozycja 25** - Czy Zamawiający dopuści dren o długości 80cm? Reszta parametrów jak w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 1) do SWZ.

- 31. Zadanie 1 pozycja 27** - Czy Zamawiający dopuści wycenę ochraniaczy za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem na zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 1) do SWZ. Jednocześnie informuje, że wycena opakowania powinna zostać sporządzona z ewentualnym zaokrągleniem do pełnych ilości w górę przez Wykonawcę.

32. Zadanie 1 pozycja 37- Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem na zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 1) do SWZ. Jednocześnie informuje, że wycena opakowania powinna zostać sporządzona z ewentualnym zaokrągleniem do pełnych ilości w górę przez Wykonawcę.

33. Zadanie 1 pozycja 39 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 1) do SWZ.

34. Zadanie 1 pozycja 41- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 2 litrów o wysokości 246mm, średnicy dolnej 95mm oraz z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm jak na poniższym zdjęciu?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 1) do SWZ.

35. Zadanie 1 pozycja 42 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik 30 litrów o pokrywie z otworem wrzutowym o średnicy 75mm oraz wymiarach:

| POJEMNIKI ZBIORCZE | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| POJ. (dm ³) | Wysokość (mm) | Średnica górna i dolna (mm) | Waga (kg) |
| 60 | 664 | 390 / 322 | 2,40 |
| 30 | 322 | 390 / 322 | 1,70 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemniki 30 litrowe o pokrywie z otworem wrzutowym o średnicy 75mm oraz wymiarach: poj.30 dcm³, wysokość 322 mm, średnica: górna/dolna 390/322 mm. Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 1) do SWZ.

36. Zadanie 1 pozycja 51 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania CH 21, pakowana podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnętrzne, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

37. Zadanie 2 pozycja 8- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 60ml? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

38. Zadanie 2 pozycje 15, 16, 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

39. Zadanie 2 pozycja 20- Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opakowanie a' 100 szt. wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ. Jednocześnie informuje, że wycena opakowania powinna zostać sporządzona z ewentualnym zaokrągleniem do pełnych ilości w górę przez Wykonawcę.

40. Zadanie 2 pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ


41. Zadanie 2 pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

42. Zadanie 5 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o opisie:

Wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PVC
Uniwersalne połączenie 15F/22M oraz 22F
umożliwiające podłączenie do kompatybilnych
produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej
lub aparatu do znieczulenia
Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm
Regulowana długość obwodu umożliwiająca
dopasowanie długości układu oddechowego oraz
optymalizację przestrzeni martwej
Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3
litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci)
Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm
Kolanko z portem luer-lock
Wyrób sterylny
Jednorazowego użytku
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ftalanów
Do krótkotrwałego użytku (od 60 minut do 30 dni)
Opakowanie foliowe

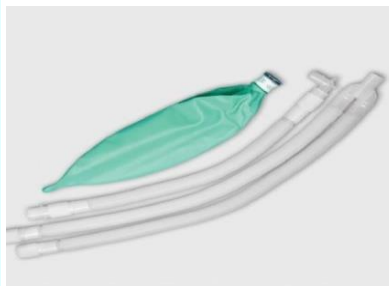

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

43. Zadanie 5 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną? Reszta parametrów jak w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

44. Zadanie 5 pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 2,5, 3,4 i 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ

45. Dotyczy pakietu 4 poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do pompy infuzyjnej ALARIS GW o długości 220 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 4) do SWZ

46. Pytanie 2 dotyczy pakietu 4 poz. 5 – W związku ze zmianą sposobu pakowania, prosimy o dopuszczenie zestawu pakowanego po 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ. Jednocześnie informuje, że wycena opakowania powinna zostać sporządzona z ewentualnym zaokrągleniem do pełnych ilości w górę przez Wykonawcę.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Z poważaniem,
/podpis na oryginale/