



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

NZZ/17/P/20

Bydgoszcz, dnia 15.07.2020 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Dostawa odzieży ochronnej i operacyjnej jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych. Dostawa systemu bezdotykowego wydawania rękawic, dostawa materiałów medycznych używanych podczas zabiegów ortopedycznych

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 11, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 maseczki mocowane na elastyczne i rozciągliwe tasiemki o szerokości 1,5 cm +/- 0,3 zapewniające wysoki komfort nawet przy długim użytkowaniu?

Odpowiedź na zapytanie:

Mając na uwadze modyfikacje SIWZ, Zamawiający wymaga tylko maseczek w typie II. Zamawiający dopuszcza maseczki mocowane na elastyczne i rozciągliwe tasiemki o szerokości 1,5 cm +/- 0,3 zapewniające wysoki komfort nawet przy długim użytkowaniu.

Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 11, poz. 1

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści maseczki typu II, wyprodukowane w warunkach zgodnych z certyfikowanym systemem jakości ISO 13485, zapewniających poziom czystości mikrobiologicznej maksymalnie 30 CFU/g, maseczki

z warstwą wewnętrzną filtracyjną zapewniającą skuteczność filtracji bakteryjnej na poziomie min. 98%, a przy tym dające wysoki komfort dzięki ciśnieniu różnicowemu na poziomie 20 Pa/cm²?, a jeśli nie czy Zamawiający dopuści złożenie oferty częściowej - wyłącznie na pozycję nr 2?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY - w zakresie grupy 11. Maski typ IIR nie są po dokonanej modyfikacji przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga tylko maseczek w typie II.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 11, poz. 1,2

Czy w poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga zaoferowania masek chirurgicznych zarejestrowanych jako wyrób medyczny, posiadających aktualne i ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP?

Odpowiedź na zapytanie:

Maski klasy IIR nie są po dokonanej modyfikacji przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu (pozycja 1 przed modyfikacją)

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek chirurgicznych typ II zarejestrowanych jako wyrób medyczny, posiadających aktualne i ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP.

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 14

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMS jako typ włókniny SMMMS, różniącą się ilością warstw włókniny meltblown, ale bez wpływu na wymagane w SIWZ przez Zamawiającego parametry?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza włókninę SMS jako typ włókniny SMMMS, różniącą się ilością warstw włókniny meltblown, ale bez wpływu na wymagane w SIWZ przez Zamawiającego parametry.

Pytanie nr 5 - dotyczy grupy 26

Czy w poz. 1 - 4 Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny o gramaturze 17 g/m²?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza czepki wykonane z włókniny o gramaturze 17 g/m².



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 6 - dotyczy grupy 26

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści czepkę ze wstawką chłonącą pot w części przedniej czepka?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza czepki ze wstawką chłonącą pot w części przedniej czepka.

Pytanie nr 7 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15a wzoru umowy stawka kary umownej 10% została zastąpiona stawką 2%? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na jakiegokolwiek inne obniżenie stawki kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 16a wzoru umowy?

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”. W przypadku naruszenia §3 ust. 1a wzoru umowy poprzez wystawienie kilku faktur zamiast jednej faktury, Zamawiający nie poniesie żadnej szkody. Zatem wysokość kary umownej wynosząca 10% wartości brutto zamówienia jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8- dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy wyrażenie „bez wezwania do jej należytego wykonania” zostało zastąpione wyrażeniem „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 19 wzoru umowy wyrażenie „10% minimalnej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy przewidzianej do realizacji” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy grupy 15

Czy w Grupie nr 15 Zamawiający dopuści shunty o średnicach 8, 9, 10 F (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy grupy 18 - Śruba kaniulowana typu Herberta

Czy Zamawiający dopuści tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotną, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3 mm i długościach od 12 do 34 mm. Gwint na głowie śruby o średnicy 4mm mm, średnica rdzenia śruby 1,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 3mm. Kaniulacja ϕ 1,1mm.



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 12 - dotyczy grupy nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał modyfikacji PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie grupy 11. W wyniku dokonanej modyfikacji wymagane jest zaoferowanie tylko masek chirurgicznych typ II.

Pytanie nr 13 - dotyczy grupy nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trójwarstwowej maski chirurgicznej z gumkami spełniającej normy EN 14683 w typie I. Maski pakowane w opakowanie foliowe a'50 sztuk.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający po dokonanej modyfikacji oczekuje masek typie II. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie masek chirurgicznych w typie I

Pytanie nr 14 - dotyczy grupy 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej z gumkami typu KN95 będącej wyrobem medycznym, technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 - posiada poziom filtracji BFE $\geq 98\%$ (testy zgodnie z EN149 z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy grupy 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do naprawy łąkotki, techniką ALL-INSIDE, zbudowany z białej rękojeści i czarnego suwaka, wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych plecioną nicią z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0? Urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji oraz giętą igłę umożliwiającą przebicie torebki stawowej i struktur łąkotki. Implanty są wypychane z wnętrza igły na zewnątrz poprzez przesunięcie/aktywację czarnego suwaka.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zestaw do naprawy łąkotki, techniką ALL-INSIDE, zbudowany z białej rękojeści i czarnego suwaka, wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych plecioną nicią z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji oraz giętą igłę umożliwiającą przebicie torebki stawowej i struktur łąkotki. Implanty są wypychane z wnętrza igły na zewnątrz poprzez przesunięcie/aktywację czarnego suwaka.

Pytanie nr 16 - dotyczy grupy 13, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści sterylny marker chirurgiczny z podziałką co 0,1 cm (od 0 do 6 cm)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza sterylny marker chirurgiczny z podziałką co 0,1 cm (od 0 do 6 cm).

Pytanie nr 17 - dotyczy grupy 13, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści sterylny marker chirurgiczny z dodatkową miarką tekturową z podziałką co 0,1 cm (od 0 do 15,2 cm)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza sterylny marker chirurgiczny z dodatkową miarką tekturową z podziałką co 0,1 cm (od 0 do 15,2 cm).

Pytanie nr 18 - dotyczy grupy 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę, która po rozłożeniu ma rozmiar 127 cm



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza osłonę, która po rozłożeniu ma rozmiar 127 cm.

Pytanie nr 19 - dotyczy grupy 1

Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania drutów o średnicach: od 1,0mm do 2,4mm – skok max. co 0,2mm oraz drutu o średnicach 2,5 i 3,0mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drutów o średnicach: od 1,0mm do 2,4mm – skok max. co 0,2mm oraz drutu o średnicach 2,5 i 3,0mm.

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy 12

Czy Zamawiający w Grupie 12 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: belki wykonane z włókna węglowego proste, średnica 11 mm, długość od 100 do 500 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 21 - dotyczy grupy 12

Czy Zamawiający w Grupie 12 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: belki wykonane ze stali nierdzewnej proste, wygięte 30° i 90°, średnica 11 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 22 - dotyczy grupy 12

Czy Zamawiający w Grupie 12 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: klamry belka/belka, belka/pin 2D?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 23 - dotyczy grupy 12

Czy Zamawiający w Grupie 12 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: piny stalowe lub tytanowe o średnicy 5mm i 6 mm długości od 150 do 250 mm, gwint 60-80 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy grupy 12

Czy Zamawiający w Grupie 12 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania: klamry wielorzędowe, do dwóch belek, odległość między belkami 81/92 mm, możliwość równoległego ułożenia belek?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczy grupy 18

Czy Zamawiający w Grupie 18 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej typu Herberta z gwintem na głowie o średnicy 3,9mm zamiast 3,8 mm, śruby w długościach od 12 do 40mm zamiast od 10 do 40 mm, z gniazdem śruby sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26 - dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne osłonki na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych posiadające kołnierz ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy o następujących wymiarach

Wysokość samego uchwytu: 8 cm

Wysokość całkowita: 8,5 cm

Średnica otworu: 3 cm



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Średnica kołnierza: 13 cm




Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27 - dotyczy grupy 8

Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierzem ochronnym, zapobiegającym przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.

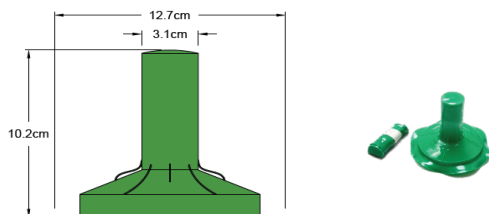

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28 - dotyczy grupy 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a'250 szt. dla rozm. S-L, oraz a'240 szt. dla rozm. XL z przeliczeniem zaofertowanej ilości na 2400 op.?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane wielkości opakowań. Zamawiający określił wymaganą ilość rękawic i minimalną wielkość opakowań w załączniku nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY. Zamawiający wymaga łącznie zaofertowania 600 000 sztuk produktu. Zgodnie s SIWZ – Rozdział 5 - W przypadku wielkości opakowań nie pozwalających na przeliczenie ilości oferowanego przedmiotu zamówienia na ilości wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający zezwala wyłącznie na zaofertowanie odpowiedniej ilości z zaokrągleniem w górę – co nie będzie miało wpływu na wybór oferty. Przy obliczaniu punktacji wg wzoru opisanego w SIWZ, będą brane pod uwagę ceny brutto za poszczególne części zapisane w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 29 - dotyczy grupy 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną zgodną z normą 14683 w typie II?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY - w zakresie grupy 11. Maski typ IIR nie są po dokonanej modyfikacji przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga tylko maseczek w typie II.



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

Pytanie nr 30 - dotyczy grupy 14 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w kolorze niebieskim. Zgodne z normą EN 13795. Występujące w rozmiarach od S do XXL?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 31 - dotyczy grupy 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny przedłużany, ściągany z tyłu gumką, z wstawką antypotną w części czołowej? Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej. Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością. Gramatura 25g/m²?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza czepek chirurgiczny przedłużany, ściągany z tyłu gumką, z wstawką antypotną w części czołowej? Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej, włóknina cechująca się wysoką chłonnością i wytrzymałością. Gramatura 25g/m².

Pytanie nr 32 - dotyczy grupy 26, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny typu furażerka ściągany z tyłu gumką wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej? Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością. Gramatura 25g/m²?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza czepek chirurgiczny typu furażerka ściągany z tyłu gumką wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej, włóknina cechująca się wysoką chłonnością i wytrzymałością. Gramatura 25g/m².

Pytanie nr 33 - dotyczy grupy 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny typu beret wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej charakteryzującej się doskonałą przepuszczalnością powietrza, o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza czepek chirurgiczny typu beret wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej charakteryzującej się doskonałą przepuszczalnością powietrza, o gramaturze 25g/m².

Pytanie nr 33 - dotyczy grupy 2

Czy w Grupie 2 „Implanty do szycia łokotki” Zamawiający dopuści system do szycia łokotki typu all-inside o poniższej charakterystyce:

„Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łokotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa prosta lub wygięta 14stopni, zakończona igłą o śr.1,6mm”
bez zachowanie dotychczasowych wymagań?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 34 - dotyczy grupy 5

Czy w Grupie 5 „Implanty do stabilizacji więzozrostu” Zamawiający dopuści:

w poz.1 - Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu piszczelowego-strzałkowego składający się z:

„1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm

2. ostro zakończony z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant”, bez zachowania pierwotnych wymagań

Instrumentarium – użyczenie na czas trwania umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 35 - dotyczy grupy 5

Czy w Grupie 5 „Implanty do stabilizacji więzozrostu” Zamawiający dopuści w poz. 2 - Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obończykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytkę z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant, bez zachowania pierwotnych wymagań.

Instrumentarium – użyczenie na czas trwania umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w grupie 5 „Implanty do stabilizacji więzozrostu” dopuszcza w poz. 2 - Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obończykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytkę z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant, bez zachowania pierwotnych wymagań.

Instrumentarium – użyczenie na czas trwania umowy?

Pytanie nr 36 - dotyczy grupy 21

Czy w Grupie 21 KANIULE ARTROSKOPOWE w poz. 2 Zamawiający dopuści kaniule artroskopowe z obturatorem, jednorazowe, z podwójnym uszczelnieniem, przezroczyste, o średnicy 7-8,5mm i długości 75-130mm, bez zachowania pierwotnych wymagań?



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza kaniule artroskopowe z obturatorem, jednorazowe, z podwójnym uszczelnieniem, przezroczyste, o średnicy 7-8,5mm i długości 75-130mm.

Pytanie nr 37 - dotyczy grupy 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z GRUPY 21 KANIULE ARTROSKOPOWE poz.2 do odrębnej podgrupy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 38 - dotyczy Projektu umowy (Zał. 3A: § 6 ust. 4, Zał. 3B: § 7 ust. 4):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy Zamawiający zdając sobie sprawę, że nie może zastrzegać w umowie kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawców tj. korzystania z produktów finansowych umożliwiających zabezpieczenie zapłaty ze strony zamawiających, czy dochodzenia na drodze sądowej zapłaty zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika, jako niezgodnych z obowiązującym prawem,



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

wykreśli ww. zapisy z projektu umowy?

Powyższe stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie zespołów arbitrów i KIO:

- zgodnie z **wyrokiem KIO z dnia 25 października 2013 roku** sygn. akt KIO 2397/13 Izba nakazała usunięcie zapisów dotyczących kar umownych niezwiązanych z uchybieniami wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Zdaniem Izby „uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy

nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać”

Tym samym, Izba stwierdziła, że zastrzeżone kary umowne nie mają żadnego związku z uchybieniami wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

- **wyrokiem KIO z dnia 27 marca 2014 roku** Sygn. akt: KIO 487/14 Izba stwierdziła, że „zastrzeżone kary umowne winny zmierzać do zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pozostawać w związku z zasadniczymi obowiązkami wykonawcy, wynikającymi z przedmiotu zamówienia”. Zdaniem Izby zastrzeżenie kar umownych w sytuacji, gdy zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia

i sankcjonowanie podejmowania przez wykonawcę prób zmierzających do odzyskania wierzytelności jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego i stanowi nadużycie przez zamawiającego jego prawa podmiotowego do kształtowania postanowień umowy”.

Mając na uwadze powyższe wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 39 - dotyczy Projektu umowy depozytu (Zał. 3D § 1 ust. 5):

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 ww. projektu umowy.

Taka kwota kary, w pełni odpowiada funkcji kompensacyjno – odszkodowawczej stymulującej wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania i nie odbiega swą wysokością od kwot ogólnie przyjętych w umowach o udzielenie zamówienia publicznego na podobny asortyment.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 40 – dotyczy Projektu umowy depozytu (Zał. 3D):

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o **sprecyzowanie / dodanie** do obecnego brzemienia **projektu umowy depozytu**, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na **8 miesięcy** przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt **niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.**

2. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 41 - dotyczy grupy 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do szycia łąkotki typu all inside z implantami załadowanymi na 2 osobne igły jednorazowe z kątem zagięcia igły 12 stopni, bez sygnału dźwiękowego w momencie implantacji. Zestaw spełniający wszystkie wymagania i funkcjonalności wymagane przez zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 42 - dotyczy grupy 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego zestawu jako produktu równoważnego ?

zestaw jednorazowy do stabilizacji więzozrostu stawu strzałkowo-piszczelowego składający się z guzika tytanowego w kształcie wąskiego prostokąta o zaokrąglonych rogach o długości min 12 mm i drugiego



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

okrągłego guzika z czterema otworami ϕ 6,5mm. Guziki połączone w specjalistyczną samozaciskową pętlą o grubości 5, w sposób pozwalający na płynne dociągnięcie guzików. Dodatkowa nić prowadząca z jednej strony zakończona igłą długości min. 10cm z drugiej dołączona do prostokątnego guzika, zestaw sterylny, instrumentarium wielorazowe dedykowane do ww. asortymentu, dostarczone na czas realizacji umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw jednorazowy do stabilizacji więzozrostu stawu strzałkowo-piszczelowego składający się z guzika tytanowego w kształcie wąskiego prostokąta o zaokrąglonych rogach o długości min 12 mm i drugiego okrągłego guzika z czterema otworami ϕ 6,5mm. Guziki połączone w specjalistyczną samozaciskową pętlą o grubości 5, w sposób pozwalający na płynne dociągnięcie guzików. Dodatkowa nić prowadząca z jednej strony zakończona igłą długości min. 10cm z drugiej dołączona do prostokątnego guzika, zestaw sterylny, instrumentarium wielorazowe dedykowane do ww. asortymentu, dostarczone na czas realizacji umowy

Pytanie nr 43 - dotyczy grupy 18:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Grupie nr 18 niżej wymienionego asortymentu:

Śruba kompresyjna, tytanowa kaniulowana z gwintowaną główką, samotną, samogwintująca

- średnica śrub 2,5mm, 3,0mm, 4,3mm

- konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej

- dostępne śruby w długościach od 8 do 80mm

- gniazdo śruby gwiazdkowe (Torx / Hexalobe)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza śrubę kompresyjną, tytanową kaniulowaną z gwintowaną główką, samotną, samogwintującą

- średnica śrub 2,5mm, 3,0mm, 4,3mm

- konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej

- dostępne śruby w długościach od 8 do 80mm

- gniazdo śruby gwiazdkowe (Torx / Hexalobe)

Pytanie nr 44 - dotyczy grupy 7

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłone o wymiarze 85 x 150 cm – pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza osłonę o wymiarze 85 x 150 cm – pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 45 - dotyczy grupy 7

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony na przewody w rozmiarze 13 x 250 cm - pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza osłony na przewody w rozmiarze 13 x 250 cm - pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 46 - dotyczy grupy 26

Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepka wykonanego z włókniny o gramaturze min. 15g/m² - pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania czepka wykonanego z włókniny o gramaturze min. 15g/m² - pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 47 - dotyczy - Wzór umowy:

Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

Siła Wyższa

1. *Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).*
2. *Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.*
3. *Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*
4. *Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.*
5. *W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 48 - dotyczy grupy 4

W związku z tym, iż w grupie nr 4 poz. 1-3 Zamawiający oczekuje dwóch wersji trokara (z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym), natomiast w opisie przedmiotu zamówienia podany został parametr „karbowana kaniula” która w przypadku fiksacji trokara za pomocą balona nie ma uzasadnienia, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli dwie wersje trokara: 1. Z żebrowaną kaniulą. 2. Z balonem i dyskiem mocującym (bez żebrowania) do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem dwóch wersji trokara (z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym) dla każdej z pozycji w grupie (do wyboru przez Zamawiającego).

Pytanie nr 49 - dotyczy grupy 4

Zamawiający w grupie nr 4 poz. 1-3 używa określenia trokar optyczny. Proszę o doprecyzowanie czy poprzez trokar optyczny rozumieć należy trokar, którego obturator posiada uszczelkę oraz możliwość wprowadzenia optyki do niego tak, aby możliwe było przejście przez przebijane powłoki pod kontrolą wzroku?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający używając określenia trokar optyczny rozumie trokar, którego obturator posiada uszczelkę oraz możliwość wprowadzenia optyki do niego tak, aby możliwe było przejście przez przebijane powłoki pod kontrolą wzroku.



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 50

Zamawiający w siwz nie wprowadził wymogu podania numerów katalogowych oferowanych produktów. Brak wymogu podania numeru katalogowego uniemożliwia Zamawiającemu jednoznaczną weryfikację ofert i tym samym stwarza ryzyko uzyskania ofert niezgodnych z siwz oraz konieczności dokonania wyboru oferty niespełniającej wymogów Zamawiającego, tylko w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. Czy w celu uzyskania możliwości weryfikacji zgodności ofert z zapisami siwz Zamawiający wprowadzi wymóg podania w ofertach numerów katalogowych oferowanych produktów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie. Informacje taka proszę zamieścić w 2 lub 3 kolumnie załącznika nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY.

Zamawiający



SZPITAL
AKREDYTOWANY