

Dreżdenko, dnia 25 czerwca 2024 roku

**Do Wykonawców,  
ubiegających się o zamówienie**

**P2**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bielizny zabiegowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/12/2024, 2024/BZP 00371284/01 z dnia 2024-06-18,

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień i wprowadza zmiany treść SWZ:

#### **Pytanie 1**

##### **Pakiet 1, poz. 1, składowa 4**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę serwety Mayo 87g/m<sup>2</sup>?

##### **Odp. do pytania 1**

Wymaga się złożenia oferty zgodnie ze SWZ. Zamawiający wymaga, aby serweta Mayo w zestawie miała wagę rzeczywistą nie mniejszą niż 158g.

#### **Pytanie 2**

##### **Pakiet 1, poz. 1, składowa 11**

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapakowany razem z całym zestawem, ale umieszczony na samej jego górze?

##### **Odp. do pytania 2**

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 1 na zestaw, w którym fartuch zapakowany jest na górze zestawu, przy pozostałych parametrach bez zmian.

#### **Pytanie 3**

##### **Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

##### **Odp. do pytania 3**

W SWZ dopuszczono, aby opakowanie wewnątrz miało postać kartonu lub worka foliowego biologicznie czystego.

#### **Pytanie 4**

##### **Pakiet 1, poz. 2, składowa 2**

Czy zamawiający dopuści serwetę 200/260x310cm z otworem 30x30cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 16 x 18 cm, zintegrowana z workiem do zbiórki płynów ze sztywnikiem i zaworem na odprowadzenie płynów, wykonana z laminatu dwuwarstwowego?

##### **Odp. do pytania 4**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 2 pkt. 2 - na serwetę o rozmiarze 200/260x310cm z otworem 30x30cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 16x18 cm, zintegrowaną z workiem do zbiórki płynów ze sztywnikiem i zaworem na odprowadzenia płynów, wykonana z laminatu dwuwarstwowego.

#### **Pytanie 5**

##### **Pakiet 1, pozycja 2, składowa 4**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z gazy 17-nitkowej?

##### **Odp. do pytania 5**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

#### **Pytanie 6**

##### **Pakiet 1, poz. 2, składowa 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany przy karku na rzep, bez wyraźnej regulacji?

##### **Odp. do pytania 6**

Zamawiający wyjaśnia, że nie stawia szczególnych wymagań w zakresie sposobu regulacji zapięcie fartucha. Zapięcie winno gwarantować jego umocowanie na plecach w okolicy karku.

#### Pytanie 7

##### Pakiet 1, poz. 2, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalność w obszarze wzmocnionym 102cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie w strefie wzmocnionej na sucho/mokro 107,74/110,8kPa?

##### Odp. do pytania 7

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

#### Pytanie 8

##### Pakiet 1, poz. 2, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści odporność na przenikanie cieczy 35 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 80,60/76kPa?

##### Odp. do pytania 8

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

#### Pytanie 9

##### Pakiet 1, poz. 2, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapakowany razem z całym zestawem, ale umieszczony na samej jego górze?

##### Odp. do pytania 9


Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 2 na zestaw, w którym fartuch zapakowany jest na górze zestawu, przy pozostałych parametrach bez zmian.

#### Pytanie 10

##### Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


- 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

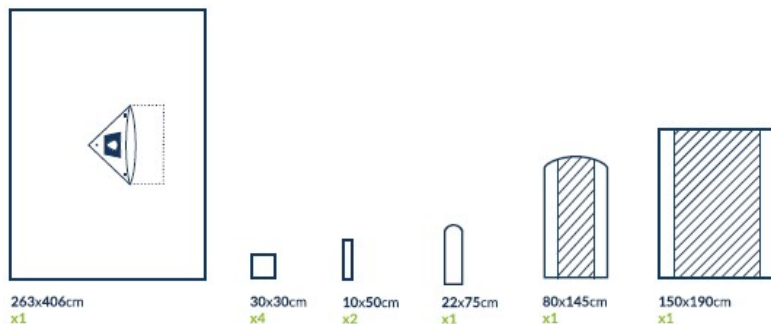

##### Odp. do pytania 10

Zamawiający **dopuszcza** możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 poz. 1 na zestaw o składzie:


- 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cmx100cm
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cmx30 cm
  - 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cmx50cm
  - 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22cmx75 cm
  - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cmx145cm
  - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm,
- przy pozostałych parametrach bez zmian.

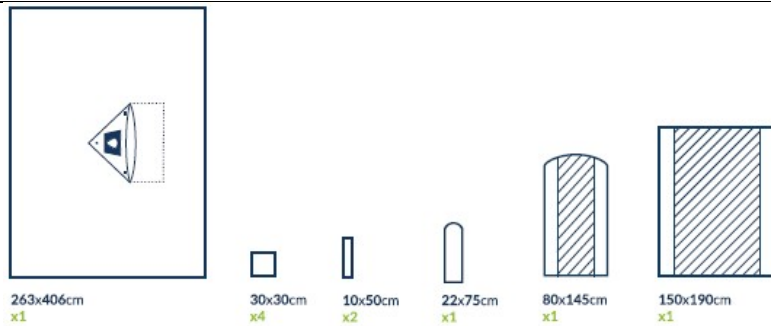

**Pytanie 11**  
**Pakiet 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


- 1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm
- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

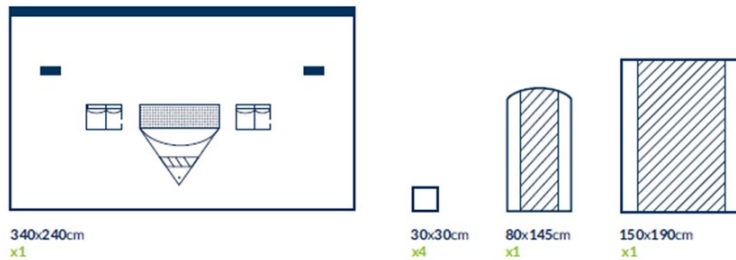

**Odp. do pytania 11**

Zamawiający **dopuszcza** możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 poz. 2 na zestaw o składzie:

- 1x serweta o wymiarach 340cmx240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cmx80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cmx30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cmx12cm
  - 4 x ręczniki chłonne 30cmx30cm,
  - 1 x osłona na stolik Mayo 80cmx145cm,
  - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cmx190cm,
- przy pozostałych parametrach bez zmian.

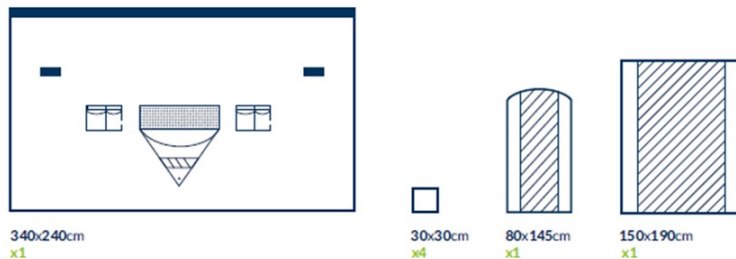

**Pytanie 12**  
**Pakiet 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści mankiety o długości 7,5cm (+/- 1cm)? Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w następujących rozmiarach: M, L, XL oraz XXL (długość fartucha XXL 157 cm (+/- 3 cm))?

**Odp. do pytania 12**

**Dopuszczono** możliwość złożenia oferty w pakiecie 3 poz. 1 na fartuch z mankietem o długości 7,5cm (+/- 1cm) z dostępem do rozmiarów: M, L, XL oraz XXL (długość fartucha XXL 157 cm (+/- 3 cm)).

**Pytanie 13**

**Pakiet 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży zabiegowej wykonany z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, składający się z bluzy z krótkim rękawem zakończonym obszyciem, wyposażoną w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi), z dekoltem wyposażonym z przodu w zapięcie na biały nap oraz spodni wiązanych na troki w pasie, wyposażonych w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap?

**Odp. do pytania 13**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 3 poz. 2 na komplet odzieży zabiegowej wykonany z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, składający się z bluzy z krótkim rękawem zakończonym obszyciem, wyposażoną w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi), z dekoltem wyposażonym z przodu w zapięcie na biały nap oraz spodni wiązanych na troki w pasie, wyposażonych w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap.

**Pytanie 14**

**Pakiet 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży zabiegowej pakowany osobno (osobno bluza i osobno spodnie)?

**Odp. do pytania 14**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 3 poz. 2 na komplet odzieży zabiegowej pakowany osobno (osobno bluza i osobno spodnie).

**Pytanie 15**

**Pakiet 3, poz. 3, 4**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie, aby serwety pakowane były w dyspenser?

**Odp. do pytania 15**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 16**

**Pakiet 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm, o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, spełniającą pozostałe wymagania?

**Odp. do pytania 16**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 17**

**Pakiet 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170 x 300 cm, o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, spełniającą pozostałe wymagania?

**Odp. do pytania 17**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 18**

**Pakiet 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, z zakładką do aseptycznej aplikacji 25 cm, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm?

**Odp. do pytania 18**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 3 poz. 5 na serwetę porodową o wymiarach 114cmx150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cmx50cm, z zakładką do aseptycznej aplikacji 25cm, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cmx80cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.


**Pytanie 19**

**Pakiet 3, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard, SMS 35g/m<sup>2</sup>, XL (138 cm)
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, SMS 35g/m<sup>2</sup> + wzmocnienie, XXL (157 cm)
- 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

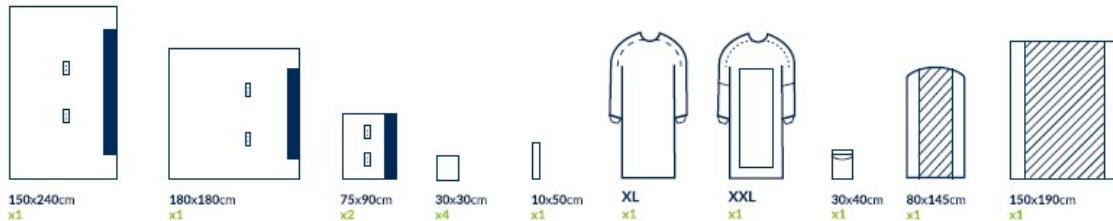

### **Odp. do pytania 19**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

### **Pytanie 19**

#### **Pakiet 3, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści rzep o wymiarach 2x22cm, pakowany w standardowy karton zbiorczy + worek foliowy wewnętrzny?

#### **Odp. do pytania 19**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 3 poz. 7 na rzep o wymiarach 2x22cm, pakowany w standardowy karton zbiorczy + worek foliowy wewnętrzny.

### **Pytanie 20**

#### **Pakiet 3, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści folię o nieco większych wymiarach: pow. całkowita 30 x 28cm, pow. lepna 30 x 22cm?

#### **Odp. do pytania 20**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 3 poz. 8 na folię o powierzchni całkowitej 30x28cm, powierzchnia lepna 30x22cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

### **Pytanie 21**

#### **Pakiet 3, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, z długimi rękawami zakończonymi białymi, elastycznymi mankietami, wyposażoną w 2 duże kieszenie na dole bluzy oraz w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją, zapinaną na białe napy?

#### **Odp. do pytania 21**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 3 poz. 9 na bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, z długimi rękawami zakończonymi białymi, elastycznymi mankietami, wyposażoną w 2 duże kieszenie na dole bluzy oraz w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją, zapinaną na białe napy, dostęp do rozmiarów bez zmian.

### **Pytanie 22**

#### **Pakiet 4, poz. 1-10**

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane w standardowy karton zbiorczy + worek foliowy wewnętrzny?

#### **Odp. do pytania 22**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

### **Pytanie 23**

#### **Pakiet 4, poz. 1, 2, 4, 6**

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane w karton o wymiarach: wysokość x długość x szerokość: 48x60x38cm?

#### **Odp. do pytania 23**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 24**

**Pakiet 4, poz. 3, 5**

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane w karton o wymiarach: wysokość x długość x szerokość: 29x60x38cm?

**Odp. do pytania 24**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 25**

**Pakiet 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane w karton o wymiarach: wysokość x długość x szerokość: 45x60x38cm?

**Odp. do pytania 25**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 26**

**Pakiet 4, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane w karton o wymiarach: wysokość x długość x szerokość: 48x60x38cm?

**Odp. do pytania 26**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 27**

**Pakiet 4, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 100x150cm?

**Odp. do pytania 27**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 2 na serwety w rozmiarze 100x150cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Pytanie 28**

**Pakiet 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem owalnym 6x8 cm?

**Odp. do pytania 28**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 5 na serwetę z otworem owalnym 6x8cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Pytanie 29**

**Pakiet 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 50x75cm?

**Odp. do pytania 29**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 5 na serwety o wymiarach 50x75cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Pytanie 30**

**Pakiet 4, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 30 x 40cm?

**Odp. do pytania 30**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 11 na kieszeń o wymiarach 30x40cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Pytanie 31**

**Pakiet 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze materiału podstawowego 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp. do pytania 31**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 32**

**Pakiet 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 102cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej, wytrzymałości na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 107,74 / 110,8 kpa?

**Odp. do pytania 32**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 33**

**Pakiet 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze materiału podstawowego 40g/m<sup>2</sup>?

**Odp. do pytania 33**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 5 poz.1 na fartuch wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze materiału podstawowego 40g/m<sup>2</sup>, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Pytanie 34**

**Pakiet 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 113,5cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej, wytrzymałości na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 193/190 kpa?

**Odp. do pytania 34**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 35**

**Pakiet 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach: M, L, XL, XXL?

**Odp. do pytania 35**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 36**

**Pakiet 5, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. do pytania 36**

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach, w sytuacji kiedy jednostką miary jest sztuka.

**Pytanie 37**

**Pakiet 7, poz. 1, 2, 3**

Czy nie doszło do omyłki – pozycje z formularza asortymentowo-cenowego nie pokrywają się z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp. do pytania 37**

Zamawiający wyjaśnia, że dodatku nr 2 do SWZ pakiet 7 poz. 1-3 zaistniała omyłka. Dodatek nr 3 do SWZ zawiera właściwe produkty, będące przedmiotem zamówienia.

Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w ww. zakresie. W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ.

**Pytanie 38**

**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp. do pytania 38**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 39**

**Pakiet 7, poz. 1, 3, 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. do pytania 39**

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach, w sytuacji kiedy jednostką miary jest sztuka.

**Pytanie 40**

**Pakiet 7, poz. 2, 4, 12, 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. do pytania 40**

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach, w sytuacji kiedy jednostką miary jest sztuka.

**Pytanie 41**

**Pakiet 7, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m<sup>2</sup>, niejałowy, kolor zielony, zawierający: prześcieradło: 150cmx210cm, poszwę na koldrę 160cmx210cm, poszwękę na poduszkę: 70cmx80cm?

**Odp. do pytania 41**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 42**

**Pakiet 7, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. do pytania 42**

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach, w sytuacji kiedy jednostką miary jest sztuka.

**Pytanie 43**

**Pakiet 7, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne wykonane z papieru (23g/m<sup>2</sup>) laminowanego folią (17g/m<sup>2</sup>) wzmocnione 48 nitkami tylko w rozmiarze 80x210cm, miękkie, wodoodporne, chłonne i wytrzymałe, w kolorze białym z niebieskimi nitkami?

**Odp. do pytania 43**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 7 poz. 8 na jeden rozmiar prześcieradła medycznego, tj.: rozmiarze 80x210cm.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 7 poz. 8 na prześcieradło medyczne wykonane z papieru (23g/m<sup>2</sup>) laminowanego folią (17g/m<sup>2</sup>) wzmocnione 48 nitkami, miękkie, wodoodporne, chłonne i wytrzymałe, w kolorze białym z niebieskimi nitkami, posiadające właściwości antystatyczne, nieprzewodzące prądu elektrycznego.

**Pytanie 44**

**Pakiet 7, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. do pytania 44**

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach, w sytuacji kiedy jednostką miary jest sztuka.

**Pytanie 45**

**Pakiet 7, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przyklepne 3 x 100 cm?

**Odp. do pytania 45**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 46**

**Pakiet 7, poz. 11**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą 13795? Norma ta nie ma zastosowania w przypadku wyrobów foliowych.

**Odp. do pytania 46**



**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 7 poz. 10 i 11 na produkt, który nie jest zgodny ze wskazaną normą.

**Pytanie 47**

**Pakiet 7, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>?

**Odp. do pytania 47**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 7 poz. 12 na czepek o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>.

**Pytanie 48**

Pakiet 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści czepek z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odp. do pytania 48**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 49**

**Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm
- 6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Iglotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock
- 1 x Iгла iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Iгла iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 6 cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2 warstwowa, z przylepcem?

**Odp. do pytania 49**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 50**

**Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m<sup>2</sup>.
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 3 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

**Odp. do pytania 50**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 11 poz. 1 na zestaw o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65cmx190cm i gramaturze 37g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m<sup>2</sup>.
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cmx30cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cmx145cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60cmx145cm i gramaturze 37g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22cmx75cm
- 3 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10cmx50cm
- 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150cmx190cm

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm o wymiarach 230cmx300cm, wzmocnienie o wymiarach 100cmx50cm
- przy pozostałych parametrach bez zmian.

#### **Pytanie 51**

##### **Pakiet 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w standardowy karton zbiorczy + worek foliowy wewnętrzny?

##### **Odp. do pytania 51**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

#### **Pytanie 52**

##### **Pakiet 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w karton o wymiarach wysokość x długość x szerokość: 31 x 58 x 33cm?

##### **Odp. do pytania 52**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

#### **Pytanie 53**

##### **Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia operacyjnego do cięcia cesarskiego zgodnego z wymaganiami SWZ, jednakże w którym tufery okrągłe gazowe do mycia pola operacyjnego mają rozmiar po rozłożeniu 47cm x 40cm?

##### **Odp. do pytania 53**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 2 na zestaw, w którym rozmiar tupferów wynosi po rozłożeniu 47cmx40cm.

#### **Pytanie 54**

##### **Pakiet 4 poz.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49 g /m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry serwet zgodne z wymaganiami SWZ.

##### **Odp. do pytania 54**

**Dopuszcza** się możliwość zaoferowania w pakiecie 4 poz. 1-7 na serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49g/m<sup>2</sup>, przy pozostałych parametrach bez zmian.

#### **Pytanie 55**

##### **Pakiet 9 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta chirurgiczna metalowa 12 cm
- 6 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x igłotrzymacz 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 x 60 cm

##### **Odp. do pytania 55**

**Dopuszcza** się możliwość zaoferowania w pakiecie 9 poz. 1 na zestaw do zakładania szwów o składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta chirurgiczna metalowa 12 cm
- 6 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x igłotrzymacz 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

- 1 x serweta włókninowa 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 x 60 cm

#### **Pytanie 56**

##### **Pakiet 11 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie o następującym składzie:

- Serweta na stolik narzędziowy 150 x 190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z folii PE i hydrofilowej włókniny PP stanowiącej wzmocnienie w rozmiarze 75 x 190cm
- Ręczniki 33 x 30cm - 4 sztuki
- Serweta na stolik Mayo 80 x 145cm zbudowana z 2-warstwowego laminatu: hydrofilowej włókniny i folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu kleju. Gramatura folii minimum 55g/m<sup>2</sup>, gramatura laminatu minimum 80g/m<sup>2</sup> - 1szt.
- Oslona na kończynę 35cm x 80 cm – 1szt.
- Taśma samoprzylepna 10cm x 50cm - 1szt.
- Serweta operacyjna 190cm x 150cm – 1szt.
- Serweta na kończynę 225cm x 320cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 5x 7cm, z padem chłonnym z wiskozy. Wbudowany uchwyt Velcro. Wokół otworu wzmocnienie o wymiarach 130cm x 75cm – 1szt.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego wzmocnienie o wymiarach 130x75cm. Opakowanie zestawu zgodne z SWZ.

#### **Odp. do pytania 56**

**Dopuszcza** się możliwość zaoferowania w pakiecie 11 poz. 1 zestawu o ww. składzie

#### **Pytanie 57**

##### **Pakiet nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1. – Czepek medyczny - niesterylny, typu "beret" damski, wykończony nieuciskającą gumką, wykonany z włókniny o gramaturze minimum 17g/m<sup>2</sup>, włóknina dobrze przepuszczająca powietrze pakowane w sztywnych trwałych, biologicznie czystych kartonikach z dyspenserem, stanowiących jednocześnie opakowanie użytkowe o wymiarach 254x286x159 mm (szer x dł x wys) (nie więcej niż 150 sztuk w kartonie)?

#### **Odp. do pytania 57**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 8 poz. 1 na czepek medyczny - niesterylny, typu "beret" damski, wykończony nieuciskającą gumką, wykonany z włókniny o gramaturze minimum 17g/m<sup>2</sup>, włóknina dobrze przepuszczająca powietrze pakowane w sztywnych trwałych, biologicznie czystych kartonikach z dyspenserem, stanowiących jednocześnie opakowanie użytkowe o wymiarach 254x286x159 mm (szer x dł x wys) (nie więcej niż 150 sztuk w kartonie).

#### **Pytanie 58**

##### **Pakiet nr 8 poz. 5 pkt. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5. – Sterylne obłożenie operacyjne do laparoskopii słony na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm?

#### **Odp. do pytania 58**

**Dopuszcza** się możliwość złożenia oferty w pakiecie 8 poz. 5 pkt.13 na osłonę na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm.

#### **Pytanie 59**

##### **Pakiet nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar S-XXL?

#### **Odp. do pytania 4**

Zamawiający wyjaśnia, że dodatek nr 2 do SWZ w pakiecie 7 poz. 1-3 zawiera omyłkę (patrz odpowiedź na pytanie 37). Zgodnie z dodatkiem nr 3 do SWZ przedmiotem zamówienia w poz. 2 jest fartuch foliowy.

#### **Pytanie 60**

##### **Pakiet nr 7 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuszcza prześcieradło włókninowe lub włókninowe-podfoliowane? Czy Zamawiający dopuszcza dowolny rozmiar?

### **Odp. do pytania 60**

Zamawiający wyjaśnia, że w dodatku nr 3 do SWZ dla pozycji 8 wymagane jest złożenie oferty na prześcieradło z dostępem do dwóch rozmiarów. W odpowiedzi na pytanie 43 dopuszczono dostęp do jednego rozmiaru. Wymagane jest prześcieradło wykonane z materiałów wskazanych w dodatku nr 3 do SWZ, z uwzględnieniem wprowadzonych dopuszczeń.

2. Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3 i art. 286 ust. 3 Ustawy wprowadza zmianę terminu składania i otwarcia ofert określonego w pkt. 25 i 26 SWZ. **Nowy termin składania ofert: do dnia 28.06.2024 godz.: 10:00. Otwarcie ofert 28.06.2024 godz.: 10:05.**
3. Zmiana terminu składania ofert wymaga także zmiany terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 27 SWZ – nowy termin związania - do końca dnia 27.07.2024 r.
4. W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 i 3 do SWZ.

Z poważaniem

**Prezes Zarządu**

**Agnieszka Banaszek**

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust.7 i art. 271 ust. 4 Ustawy wyjaśnienia, zmiany i ogłoszenie o zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 25.06.2024 r.