




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

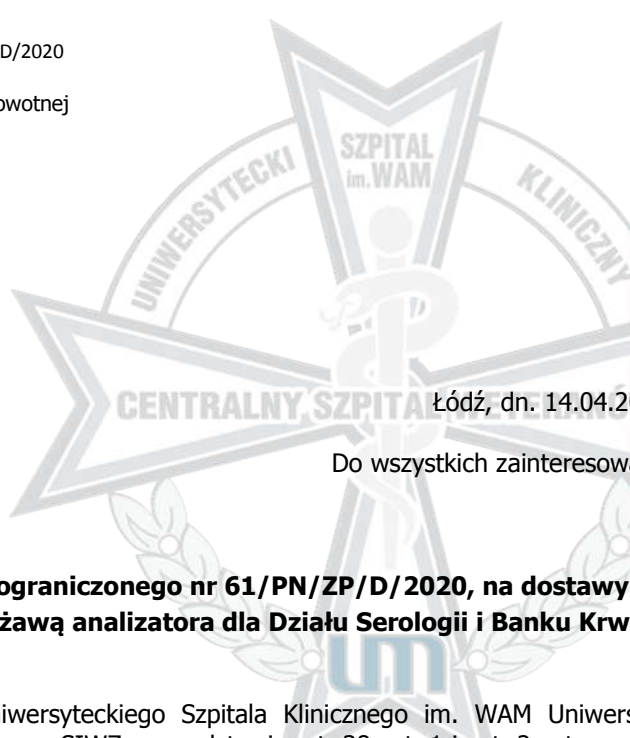

Łódź, dn. 14.04.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego nr 61/PN/ZP/D/2020, na dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora dla Działu Serologii i Banku Krwi

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącym SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

DOTYCZY SIWZ:

1. Pytanie: *Prosimy o informację, czy mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz związane z nią utrudnienia w międzynarodowych relacjach handlowych (import/eksport), Zamawiający dopuści aby dostawa przedmiotu dzierżawy w zakresie dostawy analizatora podstawowego (nowego) odbyła się w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ?*

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

2. Pytanie: *Prosimy o potwierdzenie, czy wymóg dotyczący spełniania przez oferowane towary, wymogów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, odnosi się do oferowanych produktów będących wyrobami medycznymi i tym samym nie dotyczy takich artykułów jak końcówki do pipet, zewnętrznlaboratoryjna kontrola, płynów eksploatacyjnych czy wyposażenia komputerowego niezbędnych do pracy oferowanych urządzeń?*

Odpowiedź: Tak, nie dotyczy takich artykułów jak końcówki do pipet, zewnętrznlaboratoryjna kontrola, płynów eksploatacyjnych czy wyposażenia komputerowego niezbędnych do pracy oferowanych urządzeń.

3. Pytanie: *Prosimy o doprecyzowanie, czy parametr „Wymagane jest, aby wszystkie odczynniki były gotowe do użycia” nie dotyczy płynów systemowych i eksploatacyjnych niezbędnych do pracy oferowanego analizatora?*

Odpowiedź: Parametr „Wymagane jest, aby wszystkie odczynniki były gotowe do użycia” nie dotyczy płynów systemowych i eksploatacyjnych niezbędnych do pracy oferowanego analizatora.

4. Pytanie: *Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem „Wykonywanie zawiesin w jednorazowych naczynkach”, o którym mowa w opisie pozacenowego parametru ocenianego, Zamawiający rozumie w szczególności wykonywanie zawiesin przez oferowany analizator w jednorazowych porcjach/mikroprobówkach kaset z odczynnikiem do zawieszania?*

Odpowiedź: Pod pojęciem „Wykonywanie zawiesin w jednorazowych naczynkach”, o którym mowa w opisie pozacenowego parametru ocenianego, Zamawiający rozumie wykonywanie zawiesin przez oferowany analizator w jednorazowych porcjach/mikroprobówkach kaset z odczynnikiem do zawieszania.

5. Pytanie: *Prosimy o potwierdzenie, że zapis o którym mowa w rozdziale II SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 7 dotyczący podziału na części (pakiety) znalazł się w dokumentacji omyłkowo, gdyż zgodnie z pozostałą treścią SIWZ oraz ogłoszenia przedmiotowe zamówienie nie jest podzielone na części i stanowi tylko jeden pakiet?*

Odpowiedź: Zamówienie stanowi całość, jest to jeden pakiet.

Z poważaniem