



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : (85) 869 35 50 fax: (85) 869 35 66
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



Białystok, 21 listopada 2019 r.

EAZP.2344.33.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pakiet 27 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie równoważnych ustników o wymiarze otworu głównego 23 x 27 mm, nie zawierających lateksu, wykonanych z polietylenu, z tekstylną opaską mocującą. Pakowanych indywidualnie, z datą produkcji i datą ważności na każdym opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu dyspenser kartonowy = 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 48 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie równoważnych jednorazowych szczoteczek do czyszczeni kanału endoskopów, zawierających dwie szczoteczki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania o przeciągania szczotek przez kanał endoskopu. Długość robocza 230 cm, szczotki o średnicy 6 mm oraz o długości włosia 20 mm oraz druga szczotka o średnicy 10 mm i długości włosia 20 mm, co pozwala na bardziej skuteczne czyszczenie kanału dłuższą powierzchnią szczotki. Na obu końcach plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze typu dyspenser/podajnik kartonowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w poz. 1 aparat do infuzji sterylizowany tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 korki innego producenta przy zachowaniu całkowitej kompatybilności z innymi wyrobami z pakietu 17.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pakiecie 19 w igły do znieczuleń podpajęczynówkowych pencil point: 25Gx88 z prowadnicą 21Gx38; 26Gx88 z prowadnicą 21Gx38 i 27Gx88 z prowadnicą 22Gx38

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 46 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody prostokątnej przeznaczonej do Holtera o wymiarach 55x40, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

u
u
BKU

Pakiet nr 46 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody prostokątnej przeznaczonej do Holtera o wymiarach 55x53, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 46 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie wymaganego żelu: stały czy ciekły ?

Odpowiedź: Stały.

Pakiet nr 46 poz.1

Czy w powyżej pozycji Zamawiający oczekuje elektrody z podłużnym otworem służącym do przełożenia i zamocowania przewodu kabla EKG ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 46 poz.1

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Projekt umowy par. 9 ust.2 ppkt. b)

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Projekt umowy- §9 pkt. 3

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 9 ust. 3. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 PZP.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Pakietu 34 poz. nr 10 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela w/w pozycję z pakietu nr 34 i tworzy pakiet nr 49, wadium do pakietu 49 - 15,00 zł; wadium do pakietu nr 34 - 955,00 zł

Pakiet nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do artroskopii - skład i wymiary zestawu :

- serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x300cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7cm otoczony warstwą wysokochłonną o wymiarach 80x75cm z organizatorami przewodów - 1 szt.
- osłona na kończynę 36x65cm - 1szt.
- taśmy samoprzylepne 9x50cm - 2szt.
- ręczniki chłonne 30,5x34cm - 4szt.

10

AKM

14

- osłona na stół MAYO 79x145cm - 1szt.

- serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt.

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilna PP/folia polietylenowa) 60g/m² w strefie mniej krytycznej z dodatkową łatą chłonną o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części krytycznej 140g/m². Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do artroskopii - skład i wymiary zestawu :

- serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x300cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7cm otoczony warstwą wysokochłonną o wymiarach 80x75cm z organizatorami przewodów - 1 szt.

- osłona na kończynę 36x65cm - 1szt.

- taśmy samoprzylepne 9x50cm - 2szt.

- ręczniki chłonne 30,5x34cm - 4szt.

- osłona na stół MAYO 79x145cm - 1szt.

- serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt.

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilna PP/folia polietylenowa) 60g/m² w strefie mniej krytycznej z dodatkową łatą chłonną o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części krytycznej 140g/m². Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795.

- kieszeń dwukomorowa samoprzylepna z zakładką usztywniającą 15+25cm x 30cm - 1szt. – dostarczana oddzielnie

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 1 dopuści zgłębniki o długości 120cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w Pakiecie 33 w pozycji 3 dopuści zgłębnik z obciążeniem 5g spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy EZPiP.2344.33.2019 pakiet 15 pozycja 3 1. Czy Zamawiający w pozycji 3,4 część 7 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawką 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 15 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. W pakiecie nr 15 nie ma pozycji 3 i 4.

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga przedłużacza do pompy infuzyjnej posiadającego Średnice wewnętrzna drenu 1,2 mm??

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów z komorą kroplową wolną od PVC, posiadającego specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop

M
M BKM

zapobiegający przedostaniu się powietrza do linii gdy butelka jest pusta, spełniający rolę zastawki (pływak) ? Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów z filtrem hydrofobowym na końcu drenu zabezpieczającego przed wyciekami płynu z drenu podczas jego wypełniania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aparatu zgodnego z SIWZ.

Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów posiadającego elastyczną komorę kroplową, wolną od PVC, i ftalanów (do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta), przystosowany do infuzji grawitacyjnej, z dodatkowym łącznikiem Y, długość drenu 180 cm. Posiadający specjalny zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiegający przedostaniu się powietrza do linii gdy butelka jest pusta, i utrzymujący stały poziom płynu. Przyrząd wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu. Pomaga zapobiegać zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI). Pomaga zmniejszać straty w płynach infuzyjnych poprzez ograniczeniu do zera niekontrolowaną utratę płynu poprzez kapanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17, poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby obi pozycje pochodziły od jednego producenta takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczka w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 100 szt., pod warunkiem oddzielnego sterylnego opakowania każdego koreczka.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów oraz worka pakowanego osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z wycięciem na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z wycięciem w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga worka do osłony przed światłem z dodatkowym paskiem klejącym pozwalającym na zamknięcie worka ?

Czy Zamawiający wymaga aby przepuszczalność światła folii z której wykonane są osłonki do leków światłoczułych była potwierdzona badaniami z wynikiem nie większym niż 10 % przy 200 – 450 nm. zgodnie z metodą badawczą dla opakowań wyrobów światłoczułych USP 37 „Light transmission test”? Przy braku wymagań w tym zakresie Zamawiający może dostać ofertę na worki foliowe na odpady.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający w SIWZ określił, iż zaferowany asortyment musi spełniać wymagania konieczne dla wyrobów medycznych.

N

22/4

22/4

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worka do leków światłoczułych o poj. 3000 l w rozmiarze 35 mm x 55 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową o dł. 55 mm w części przezroczystej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z igłą ściętą trójpłaszczyznowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd do przetaczania płynów bursztynowych który posiada: uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem; Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu (część przezroczysta 55 mm). Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 0,1 ml), 15 µm filtr płynu. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Logo producenta na zaciskaczu. Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogeny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Opakowanie typu blister. Wolny od ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 27, poz. 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowy ustnik z gumką silikonową wykonany z polietylenu o wymiarach 21 x 26,5 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm


1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm

i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

24 BKL

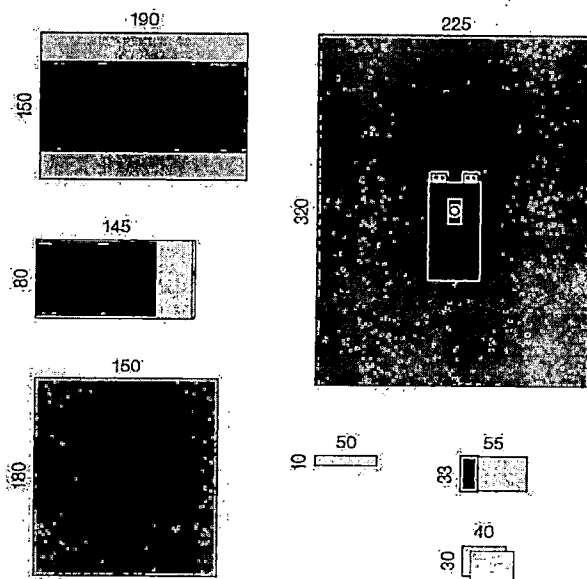

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm


1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

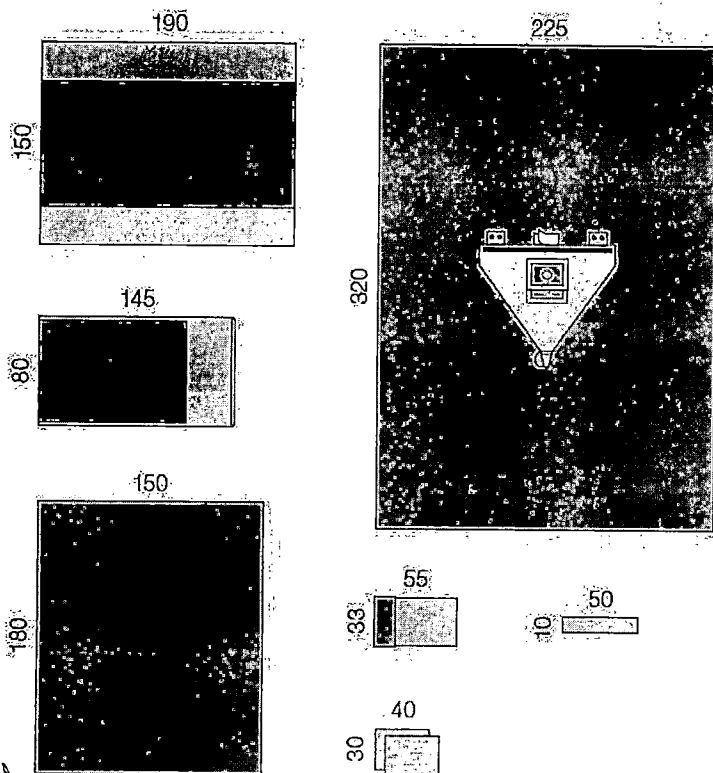

kl

2024

42

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 24 –

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego z niżej wymienionych zestawów?

Zestawy wykonane są z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa/folia polietylenowa, o gramaturze 55 g/m², spełniają wymogi normy PN EN 13795.

Nazwa produktu	Rozmiar cm	Jednostka miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Zestaw do artroskopii I 4 zestawy 938703 1				
Skład zestawu:				
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190			
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145			
1 serweta nieprzylepna	150 x 175			
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, otwory 5 x 7 cm	320 x 245			
1 osłona na kończyne	35 x 80			
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50			
4 ręczniki celulozowe	30 x 33			
Zestaw do artroskopii II 7 zestawów 938729 1				
Skład zestawu:				
1 serweta na stolik narzędziowy Protect	100 x 150			
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145			
1 serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm)	300 x 200			
1 osłona na kończyne	35 x 55			
3 taśmy samoprzylepne	10 x 50			
1 osłona na kamerę	13 x 250			

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 45 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu do wkłucia centralnego:

Skład:

- 6 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 45 x 75 cm (barierowa)
- 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (barierowa)
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze — skalpel, 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz, 13 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 10 x 15 cm, (zapakowany)

Całość zapakowana jest w opakowanie typu twardy blister, opatrzone samoprzylepną, dwudzielną etykietą, z datą ważności, identyfikacją wytwórcy, informacją o kodzie wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

M
M
BKU

Pakiet nr 48

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 250 cm, z włosiem o średnicy 5 mm i długości 20 mm z jednej strony i z włosiem o średnicy 10 mm i długości 30 mm z drugiej strony, końce szczotki zabezpieczone plastikową kulką.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 24, poz. 1.

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 24, pozycji 1 poniższego zestawu do Artroskopii.

Zestaw do Artroskopii w składzie: serweta 228cm x 300cm z otworem rozciągliwym elastometrycznym o średnicy 3cm, serweta nieprzylepna 150cm x 150cm, serweta na stół instrumentariuszki 200cm x 150cm, serweta na stół Mayo 78cm x 144cm, osłona na kończynę 35cm x 60cm, 4 serwetki do rąk, 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm.

Materiał dwuwarstwowy: włóknina ekologiczna na bazie roślinnej bez celulozy i wiskozy, odnawialne surowce roślinne : minimum 90% włókniny lub 60% włókniny z laminatem, gramatura max. 65g/m², I klasa palności, antystatyczny, z akrylowym klejem repozycjonowalnym, opakowanie multi-vac z podwójną , samoprzylepną metką z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służącą do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zgodny z wymogami EN 13795+A1:2013-06 dla obszarów krytycznych na całej powierzchni obłożenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego nie jest on w stanie jednoznacznie określić minimalnego poziomu realizacji umowy, jej realizacja odbędzie się zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 2 lit. b) i c) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 33

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 33 pozycje 1 do oddzielnego zadania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 9 ust. 2 lit. b) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 16:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie worka na mocz z drenem o długości 60 cm z możliwością przycięcia do pożądanej długości, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 46 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrody o wymiarach 42 x 56 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

M

OKM

M

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Nie

Czy w pakiecie nr 48 p. 1 Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe dwustronne szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów o następujących wymiarach: średnica szczotek - 5/5 mm, długość szczotek - 20 mm, średnica cewnika - 1,75 mm i całkowita długość - 2300 mm, pasujące do kanałów endoskopów o śr. 2.8mm-4.2mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy w pakiecie nr 48 p. 2 Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe szczoteczki do czyszczenia gniazd endoskopów dwustronne o średnicy szczotek 5,2mm i 11 mm, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 48 p. 1, aby szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów posiadały włosie nylonowe, były zakończone plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych oraz pakowane pojedynczo w foliowy blister, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii i datą produkcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pakiecie nr 48 p. 1, wymaga, aby na zewnętrznym opakowaniu szczoteczki posiadały odklejane etykiety zawierające informacje o nr serii (etykieta stanowić będzie dokument w karcie pacjenta)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy w pakiecie nr 27 Zamawiający wymaga, aby ustnik endoskopowy jednorazowy z gumką był wolny od DEHP (ftalanów), substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 27 ustnik endoskopowy jednorazowego użytku, wykonany z nietoksycznego materiału poliwęglanowego, wyposażony w elastyczną, regulowaną opaskę, niezawierający lateksu oraz DEHP (ftalanów), posiadający porty boczne pozwalające na odsysanie płynów z jamy ustnej, zabezpieczający endoskopy giętkie o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 20 mm podczas badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 27 ustnik pakowany pojedynczo w foliowy blister, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii i datą produkcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 23 poz. 1

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie testów pakowanych po 500 szt., odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przeliczenie do 1 pełnego opakowania.

§ 8 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w opóźnieniu w dostarczeniu towaru do wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

M

BKM

Czy w pakiecie nr 5 poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie nitinolowych koszyków w wymiarach systemu wprowadzającego śr. 1.9CH/120cm, z bezgłówkowym koszyczkiem śr. 12mm i długości 25mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 2 wyrazi zgodę na dostarczenie nitinolowych koszyków w wymiarach systemu wprowadzającego śr. 2.2 lub 3.0CH/90cm, z 4 drutowym główkowym helikalnym lub prostym koszyczkiem śr. 12mm i długości 25mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy w pakiecie nr 5 poz. 4,5,6, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów jak w opisie lecz w rozmiarach 4.8Fr/ 6Fr/7Fr?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy w pakiecie nr 5 poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów jak w opisie wykonanych w technologii dwuwarstwowej (zew. warstwa miękka/ wew. warstwa sztywna wzmacniająca kanał stentu)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 27

Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych ustników z gumką do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego .Wymiary otworu głównego 54 Fr lub 60 Fr. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, nie zawierający lateksu; opakowanie niepodzielne zawierające 100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 23

Asortyment ujęty we wskazanym pakiecie nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 23 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk. Wykonawca zaoferuje 1 pełne opakowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pakietu nr 23 pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści testy biologiczne do sterylizacji gazowej o odczycie po 48 h?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczyzną, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml \pm 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostko

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

14
11
12

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ.

Pakiet 17, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co aparat do infuzji, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co aparat uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 12-15

Czy zamawiający wydzieli poz.12-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 12

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od dnia otrzymania reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy dostawy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

a) opóźnienia w dostarczaniu depozytu w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie,

b) opóźnienia w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości 0,5% wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwych towarów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych (poz. 2) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe o gramaturze papieru 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 6 i 8 ustawy o wyrobach medycznych, który mówi, że znak CE umieszcza się na opakowaniu handlowym wyrobu oraz że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej? Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości? Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i wynosiła 150-220° C?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z folią 7-warstwową łącznie z warstwą kleju?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 48

Czy Zamawiający określając wymiary szczoteczki do czyszczenia endoskopów może doprecyzować i określić czy będzie wymagał następujących parametrów: długość całkowita szczoteczki 2300 mm; wymiary głowki czyszczącej 1: długość szczoteczki 30 mm, szerokość 10 mm, długość włosa 5 mm; wymiary głowki czyszczącej 2: długość szczoteczki 20 mm, szerokość 6 mm, długość włosa 3 mm średnica szczoteczki: 2,4 mm?

Do endoskopów o kanale roboczym 2,0 mm (typu slim) zmienia się długość robocza szczoteczki na 1600 mm zaś średnica szczoteczki wynosi 1,8 mm – by pasować do w/w kanału. Pozostałe parametry bez zmian. Ilość poszczególnych szczoteczek do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 27

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ustnik z gumką wykonaną z materiału do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Wymiary otworu głównego 22x26 mm, wykonany z polipropylenu, taśma mocująca wykonana z materiału. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, opakowanie 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 48, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie szczotki do endoskopów dwustronnej o średnicy osłonki 1,7mm,

- długości roboczej 2500mm i średnicy włosa 6mm/6mm lub

- długości 2300mm i średnicy włosa 5mm/10mm,

długość szczoteczki 20mm, szczotki zakończone obustronnie plastikową oliwką chroniącą kanał roboczy endoskopu przed zarysowaniem, pakowane po 50 sztuk, do kanału 2,8-4,2mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 48, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie szczotki do czyszczenia gniazd endoskopów o długości roboczej 155mm i średnicy włosa 5mm/10mm, Do kanału 2,8mm?

M

W

W

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 27, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustnika z gumką tekstylną (tkaną), która w przeciwieństwie do silikonowej nie sprawia dyskomfortu pacjentom (nie ciągnie za włosy), ustniki pakowane po 100 szt.? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 27

Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować jednorazowy ustnik z gumką tekstylną do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Wymiary ok. 20mm x 26mm. Ustnik i taśma mocująca bez zawartości lateksu. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 48– poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować jednorazowe szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów o długości roboczej 230cm, szczotki dwustronne o długości włosa 20mm i średnicy szczotki 6mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy § 4, ust.8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów przedmiotowego ust.

zgodnie z poniższym:

„....Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt wadliwej części dostawy na towar wolny od wad w terminie 7 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji .”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy § 5,

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do przedmiotowego paragrafu kolejnego ustępu o poniższej treści :

„W przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni, Wykonawca ma prawo wstrzymania dostaw do czasu całkowitego uregulowania zaległych należności przez Zamawiającego „

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów umowy § 8,

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych odpowiednio:

a) z 1% na 0,5%

z 1% na 0,5%

z 10% na 5%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 2 poz 5 na złożenie oferty na: zestaw do nefrostomii firmy RUSCH w rozmiarze 8 i 10 Ch z rozszerzadłami 14 i 16 Ch w skład, którego wchodzi:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 2 poz 6 na złożenie oferty na: Zestaw do wymiany cewnika nefrostomii 8 ,10 Ch firmy RUSCH?

ay
OKU

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 2 poz 10 na złożenie oferty na: Igła do nefrostomii 17,5G x 20cm firmy RUSCH?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wydzieli z pak 2 poz 4, 9, 10,11,12?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 5 poz 1 na złożenie oferty na: Koszyczek Dormia wykonany ze stali nierdzewnej , o śr.systemu wprowadzającego CH i dł. 1215cm , śr. koszyczka 12mm , dł. 20mm. Narzędzie bardzo giętkie , rączka rozmontowywalna , atraumatyczne zakończenie firmy RUSCH?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 5 poz. 2 na złożenie oferty na: Koszyczek Dormia wykonany ze stali nierdzewnej , o śr. systemu wprowadzającego 2,5 CH i dł. 90 cm , śr. koszyka 12mm, dł. 20mm . Rozmontowywalna rączka , kulkowe zakończenie , 4 druty helikalne firmy RUSCH?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 5 poz. 4 na złożenie oferty na: Zestaw moczowodowy typu Double Pigtail , cewnik wykonany z poliuretanu, posiada znacznik wokół całej średnicy, o średnicach: 4,8 CH, 6CH, 7CH i długościach między pętlami 24, 26, 28 cm; przewodnik z pokryciem PTFE z elastyczną końcówką, popychacz o dł. 45cm, zacisk firmy RUSCH?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 5 poz 5 na złożenie oferty na: Zestaw moczowodowy typu Double Pigtail do aplikacji długoterminowej (do 365 dni), cewnik wykonany z poliuretanu o śr. 4,8 CH, 6CH, 7CH posiada znaczniki wokół całej średnicy i długościach między pętlami 24, 26 cm; przewodnik z pokryciem PTFE z elastyczną końcówką, popychacz o dł. 45 cm , zacisk firmy RUSCH ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 5 poz 6 na złożenie oferty na: Zestaw moczowodowy typu Double Pigtail do zastosowania z ureterorenoskopem , cewnik wykonany z poliuretanu o śr. 4,8 CH, posiada znaczniki wokół całej średnicy i długościach między pętlami 24, 26 cm; przewódnik o śr. 0,035" z pokryciem PTFE z elastyczną końcówką, popychacz o dł. 90 cm firmy RUSCH?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 5 poz 7 na złożenie oferty na: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double Pigtail zawierający cewnik poliuretanowy z dodatkowym wzmocnieniem wewnętrznym w postaci siatki, utrzymującym drożność , o średnicy 6CH, 7CH, 8CH długościach 26, 28 cm ; przewodnik o dł. 150 cm z pokryciem PTFE ze zmiękczaną końcówką ; popychacz o dł. 45 cm firmy RUSCH ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 5 poz 8 na złożenie oferty na: Zestaw do dwustopniowej nefrostomii w nomenklaturze producenta, zawierający cewnik o średnicy 8 lub 10CH i dł.30 oraz igłę dwuczęściową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 6 poz 1 na złożenie oferty na:

Zestaw do szynowania moczowodów :

- poliuretanowy cewnik typu JJ otwarty jednostronnie lub obustronnie
- rozmiary : 4,8 ; 6,0 ; 7,0 ; 8,0 Ch/długość 24- 30 cm
- popychacz (w rozm. 4,8 - 90cm w zestawach o długości 24, 26, 28cm)
- przewodnik teflonowy
- zacisk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 6 poz 2 na złożenie oferty na: Cewnik pooperacyjny , 3-drożny, silikonowy z końcówką Dufour , rozmiary :20Ch - 24Ch , balon 75ml ; kanał do płukania z łącznikiem Luer Lock; zapakowany sterylnie?

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pak 6 poz 3 na złożenie oferty na: Hydrofilna prowadnica z nitalowym rdzeniem, prosta /typu J ,dł. 150 cm , średnica 0,018'', 0,035'', 0,038''?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 34 Poz.1

Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Załącznik nr 5. W ocenie wykonawcy oświadczenia o których mowa w pkt 4 p.pkt c,d,i e SIWZ znajdują się w Załączniku 5a, zaś Załącznik nr 5 zawiera oświadczenia, które znajdują się w treści JEDZ

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga złożenia załącznika nr 5 a jedynie załącznik nr 5a.

Pakiet nr 29

Czy Zamawiający dopuści system biopsyjny bez rękojeści RTG ?

Wyjaśniam, że rękojeść RTG wykorzystuje się do badań na mammografie, który wyposażony jest w przystawkę stereotaktyczną. Posiadany przez szpital mammograf nie jest wyposażony w/w element, więc rękojeść pod RTG będzie zbędna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników hydraulicznych do rozszerzenia zwężeń moczowodu. Cewnik 5F dł. 75 cm, balon do wyboru 12CH/15CH/18CH, kompatybilny z prowadnicą 0,035'' z pompką do wysokociśnieniowego napełniania balonu. Balon dł. 4 cm ze znacznikami RTG na końcach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów Tumorstent zawierającego: cewnik pigtail z materiału 2 warstwowego innego niż poliuretan specjalnie wzmocnionego, prowadnica hydrofilna Terumo i popychaczem sterowalnym umożliwiającym cofanie i obracanie cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby cewniki były wykonane z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan – tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu obierania próbek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka o pojemności 1500 ml, niesterylnego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 24

Poz.1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy zestawu do artroskopii, skład zestawu:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50µ z wzmocnieniem 75x190 +/-2cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm składana rewersowo
- 1 x osłona na kończynę 38x73 +/-2 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przyklepna 9 x 50 cm

- 2 x ręcznik chłonny z mikrosiesią zabezpieczającą przed rozerwaniem 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem \varnothing 5 cm wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m² odpornego na przenikanie płynów (> 200cm H₂O), odpornego na rozrywanie na sucho/mokro (>195kPa), odpornego na penetrację mikrobiologiczną na mokro- IB 6,0. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 30

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu:

Sterylna poliuretanowa folia operacyjna o grubości 0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, paroprzepuszczalność na poziomie min. 800g/m²/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości 3,5cm (+/-0,5cm) ułatwiające aplikację. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Opakowanie jednostkowe- papier silikonowany. Opakowanie handlowe 10 szt.

Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Rozmiary:

15x28cm

28x30cm

45x28cm.

Pakiet nr 45

Poz.1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego zestawu do wklucia centralnego, skład zestawu:

1 x Serweta na stół narzędziowy 100 x 110 cm,

10 x Gazik 17N, 12W, 7,5 x 7,5 cm

1 x Taca dwukomorowa 12x23x5cm, niebieska

1 x Patek z gąbką do dezynfekcji, długość 18 cm

1 x Serweta nieprzylepna do okrycia pacjenta 90 x 150cm bilaminat, 58 g/cm²

2 x Serweta typu U, przylepna 45 x 75cm bilaminat, 58 g/cm²

Zestaw zapakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada samoprzylepną etykietę do dokumentacji medycznej zawierającą: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12 pozycja 1.

Czy zamawiający w pakiecie 12 pozycji 1 oczekuje zestawu uniwersalnego grawitacyjnego do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą w którego skład wchodzi plastikowy koszyczek do zawieszenia butelki bądź worka na stojaku? Pozostały zapis zgodny z Siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa składanie i otwarcie ofert na 29.11.2019 r.; godziny bez zmian

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA
w Białymstoku

Alicja Skindzielowska

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych / Zaopatrzenia

Urszula Małgorzata Kosiorek

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Gospodarczych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zubrycka-Klecz

H. Grzed