



0ZPZ- 2353- 1466 /24

Olsztyn, dnia 25.03.2024r.

**P.T.
Wykonawcy**

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby oddziałów szpitalnych, w szczególności Oddziału Urologii, OIT, Bloku Operacyjnego”. Sprawa nr ZPZ-84/12/23

Zgodnie z art. 135 ust.2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023r., poz. 1605 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu oraz informuje o zmianie treści SWZ:

Pytanie 1

Zadanie nr 19, pozycja nr 1.

Zwracam się do Zamawiającego z pytaniem czy wymaga aby ostrza do strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą, obracały się o 360° w wielu płaszczyznach, pod wpływem nacisku na skórę pacjenta, bez konieczności przekręcania ostrza dłonią operatora ?

Odpowiedź:

Zamawiający **wymaga** aby ostrza do strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą obracały się o 360 stopni w wielu płaszczyznach pod wpływem nacisku na skórę pacjenta, bez konieczności przekręcania ostrza dłonią operatora. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ (Formularza cenowego) w powyższym zakresie.

Pytanie 2

Pytanie dot. Część 15:

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy system płuczaco-ssący, składający się z ergonomicznej przejrzystej rękojeści z dwoma przyciskami oznaczonymi kolorystycznie: niebieskiego, który służy do dostarczania płynów irygacyjnych oraz czerwonego, który służy do ewakuacji płynów, krwi, resztek tkanek oraz dymu z pola operacyjnego; z wbudowaną sondą ze stali nierdzewnej z kanałem średnicy 5 mm na całej długości, długość robocza 33 cm, elastyczne dreny typu dual-bag o długości ok. 3 m, minimalizujące zwijanie się?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ w zakresie średnicy zewnętrznej i wewnętrznej drenów i „końcówki wykonanej z włókna szklanego”.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pak 21 poz. 1 dopuści: Wkłady do automatycznego wstrzykiwacza Optivantage składające się ze strzykawki 200 ml ładowanej do przodu, drenu oraz kolec do nabierania środka kontrastowego?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 13 cewników do drenażu przezskórnego w dostępnych rozmiarach: Średnice: 8F; 10F - Długość 25 cm w zestawie z kompatybilną igłą trokar.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 66 sztywnej prowadnicy Lunderquista w dostępnej długości 820 mm

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 6

Pakiet 40, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na uchwyty do lamp operacyjnych, jałową, uniwersalną, jednorazową, do uchwytów lamp o śr. 20-40mm, wykonaną z twardego plastikowego kołnierza, średnica dysku zewnętrznego 11,8cm, wymiary woreczka 9,5 x 15cm, woreczek z polietylenu, wolna od lateksu, biokompatybilna, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100szt., zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745., termin ważności 3 lata?

Konstrukcja osłony- 16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony.

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 7

Dot. część 39, pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego, markera chirurgicznego do skóry z dwustronną końcówką 0,5 mm oraz 1,0 mm, szybko schnący, odporny na środki dezynfekujące, w zestawie giętka linijka o dł. 15cm/6',zapewniająca dokładne odmierzenie nawet na nierównych powierzchniach, dodatkowa skala pomiarowa o dł. 6 cm na markerze, fioletowy atrament /fiolet gencjanowy/,sterylizowany radiacyjnie.

Zaferowany marker chirurgiczny jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego możliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 8

Dot. część 69, pozycja 1:

Czy Zamawiający wymaga przewodu do cystoskopu lub resektoskopu o średnicy drenu 4,8 mm x 6,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy części nr 8

Czy ze względu na fakt, iż opisane w części 8 dreny, pakowane są w opakowania handlowego 10 sztuk w opakowaniu, Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 8 poz.1 dreny w opakowaniach i dokona modyfikacji w formularzu cenowym jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz skoryguje wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania (4 opak.)?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie w części 8 drenów w opakowaniach po 10 szt.

Wykonawca, który zaoferuje dreny w opakowaniach po 10 szt. w Formularzu cenowym zmieni jednostki miary na „opakowania”, wpisze wymaganą „ilość” w przeliczeniu na opakowania (4 opak.)

Pytanie 10

Dotyczy Części nr 8

Czy w związku z tym, że oferowane w części nr 8 dreny są pakowane przez producenta w opakowania handlowe po 10 szt. w opakowaniu, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach – 10szt.?

Odpowiedź:

W przypadku asortymentu pakowanego w opakowania po 10 szt. – **Zamawiający potwierdza**, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach.

Pytanie 11

Dotyczy Części nr 8

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w części nr 8 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części nr 8 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie terminu dostawy. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12

(Dotyczy terminu ważności dostarczonych produktów min. 12m-cy.) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy. **Dotyczy Części nr 8.**

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ (wzoru umowy) w tym zakresie.

Pytanie 13

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie i zwłokę w dostawie produktu wolnego od wad z 1% do 0,2% niezrealizowanej lub wadliwej części dostawy za każdy dzień zwłoki? Ustalone kary są wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 14

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze przyszłej umowy §7ust.2 pkt. a) z 5% do 2% ? Ustalone kary są wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 15

Część 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 8-10 ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 16

Część 25

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny Kwadratowa (tzw. płasta) butelka Redona o pojemności 200 ml. Butelka wypełniona ciśnieniem 0,9 bar z zawieszka do powieszenia na ramie łóżka wyposażona w gumowe złącze z zaciskiem blokującym. Produkt sterylny bez lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Część nr 40

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny sterylna osłona na rękojeść lampy operacyjnej z trzyczęściowym systemem mocowania. Umożliwia manewrowanie lampą bez zanieczyszczenia jej

uchwyty.

Długość osłony 12 cm lub 15 cm – do wyboru Osłona wykonana z przezroczystego materiału, umożliwiającego widoczność uchwytu lampy operacyjnej. Zakończona kontrastowym kolorystycznie systemem mocowania w kształcie okręgu, posiadającego od wewnątrz elastyczne ząbki. Osłona nie zawiera lateksu oraz nie zawiera ftalanów DEHP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Część 31 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr.31 worków do ochrony przed światłem : poz 1 – 1000 - 3000 ml (25 cm + 5 cm + 5 cm (rozszerz.) x 40 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 19

Część 31 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr. 31 worków do ochrony przed światłem : poz 2 – 500 ml – rozmiar – 13 cm x 35 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 20

Część 31 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr. 31 worków do ochrony przed światłem : poz 3 – 100-250 ml – rozmiar – 13 cm x 28 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 21

1. Czy Zamawiający dopuści w Części 36 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 µm ;porowatość max.: 2314 µm ;grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ? **oraz**

1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, z niebieską metalową rączką do zakładania przez otwory zasłonowe ?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w części 66 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki XXXX zgodnie z opisem:

Sztywna prowadnica Lunderquista do PCNL, pokryta PTFE z atraumatyczną zagiętą końcówką w kształcie J lub prosta. Długość 800 mm – 900 mm, średnica 0,035”, sterylna.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w części 67 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki XXXX zgodnie z opisem:

Zestaw do nefrostomii dwustopniowej jednorazowego użytku bez rozszerzań; skład zestawu: igła dwuczęściowa ostrze typu chiba – zakończenie igły wzmocnienie widoczne w USG; prowadnica Lunderquista (twarda) o długości 70 cm, z bezpiecznym końcem typu J; cewnik wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem na odcinku pierwszych 9 cm, z końcówką Pigtail bez balonu, zakończenie dystalne typu luer-lock; poprzecznie rowkowany w celu łatwego podszycia; długość około 30 cm; 6 oczek drenujących; kranikodcinający z łącznikiem do worka na mocz; rozmiar CH 8 i CH 10 do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 24

Pakiet 39

Poz.1 Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta?

Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakkolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

poniżej przesyłam pytania do projektu umowy:

Kara za nieterminową dostawę naliczana od zbyt wysokiej wartości%:

Czy w § 7 ust. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% ? Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 26

poniżej przesyłam pytania do projektu umowy:

Wniosek o dopisanie:

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do

godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 27

Pakiet 40, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyty do lamp operacyjnych, jałową, uniwersalną, jednorazową, do uchwytów lamp o śr. 20-40mm, wykonaną z twardego plastikowego kołnierza, średnica dysku zewnętrznego 11,8cm, wymiary woreczka 9,5 x 12cm, woreczek z polietylenu, wolna od lateksu, biokompatybilna, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100szt., zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745., termin ważności 3 lata? Konstrukcja osłony- 16 zębów do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 28

Pakiet 32

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie worków o pojemności 1500 ml, wymiary 20 x 26 cm, do trokara 12 mm. Dno worka wzmocnione szwem, wykonany z poliamidu pokrywanego wewnątrz poliuretanem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 29

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie worka o pojemności 1100 ml, worek chowany do tulei przed wprowadzeniem. Wymiary worka 170 x 240 mm, średnica trzonu 12 mm przechodząca przez trokar 12 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 30

Dot. zadanie 47 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie: Jednorazowy Cyfrowy Ureterorenoskop Giętki. Płaszcz giętki na całej długości z kanałem roboczym 3,6 Fr., zagięcie końcówki 285st. w obu kierunkach, wbudowane źródło światła LED. Średnica zewnętrzna końcówki 7,2 Fr, średnica zewnętrzna płaszcza 9,0 Fr, długość robocza 65 cm. Sterownik umożliwiający podłączenie endoskopu do każdego monitora przy zakupie minimum 30 szt. Sterowniki wliczone w cenę oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 31

Dot. zadanie 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie: Zestaw do Cystostomii (zestaw nadłonowy) zawierający cewnik Foley wykonany z silikonu, rozrywany trokar, skalpel. Rozmiary 10F/12F/14F długość 33-40 cm, sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ (Formularza cenowego) w zakresie długości cewnika.

Pytanie 32

Dot. zadanie 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie: Sztywna prowadnica Amplatz do PCNL, pokryta PTFE z atraumatyczną zagiętą końcówką w kształcie J. Długość 750mm, średnica 0,035", sterylna?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 33

Część 50

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z poliamidu w zestawie z łącznikiem do worka moczu, igłą dwuczęściową, kranikiem jednodrożnym, kołnierzem mocującym z opaską zaciskową. Rozmiary 6F oraz 9F.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 34

Część 53

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników moczowodowych wykonanych z poliamidu z mandarynem metalowym, skalowanych do 5cm. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 35

Część 54

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników moczowodowych wykonanych z poliamidu z mandarynem metalowym, skalowanych do 5cm. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 36

Część 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu do cystostomii z poliuretanowym cewnikiem

o dł.45cm, końcówką pigtail, zakończonym łącznikiem do worka na mocz, z igłą rozrywalną, z kołnierzem mocującym z opaską zaciskającą, strzykawką luer-lock 10 ml oraz skalpelem.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuści** zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 37

Część 67

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii z poliuretanowym radiocieniującym cewnikiemkończówkątypupigtail(zotworamiwewnątrzpętli),zoznaczeniami głębokości wprowadzenia,zzaciskiemdoregulacji przepływu,złącznikiemkompatybilnymzworkiem na mocz,rozszerzaczem (radiocieniującym, z końcówką atraumatyczną), rozszerzaczem z koszulką rozrywalną (radiocieniującym z końcówką atraumatyczną), przewodnikiem sztywnym z końcówką „J” , igłą dwuczęściową widoczną w USG, strzykawką, skalpelem, kołnierzem mocującym z opaską zaciskową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 38

Załącznik1 do SIWZ–Formularz cenowy

Część numer 47–Jednorazowy ureterorenoskop

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ureterorenoskop o średnicy zewnętrznej końcówki 9,6Fr,średnicy zewnętrznej płaszczka 8,4 Fr oraz długości roboczej 67 cm +-5% ? Reszta parametrów Zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 39

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 46, poz. 2: Zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych Amplatz. Cieniodajny cewnik zPTFE o rozmiarze 8 FR, 3 cieniodajne rozszerzacze 6 do 10 FR, 11 rozszerzaczy w rozmiarze 12-30 FR, pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8 FR, cieniodajne koszulki Amplatz z PTFE z czterema największymi rozszerzaczami. W zestawie 13 rozszerzaczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 40

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 46, poz. 3: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,8 FR i 6 FR o/o (pozostałe parametry zgodnie z SWZ),

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 41

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 46, poz.4:Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,8FR i 6FR o/z (pozostałe parametry zgodnie z SWZ),

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 42

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 46, poz. 5: Zestaw stentu moczowodowego do czasowego drenażu wewnętrznego z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza z poliuretanu pokrytego fosforylocholiną,

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 43

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 46, poz.6:Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4FR; 4,7FR i 6FR o/z (pozostałe parametry zgodnie z SWZ),

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 44

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 46, poz. 7: Koszulka dostępu moczowodowego o śr. 10 FR oraz 12 FR. I dł 35 cm i 45 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 45

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 46, poz. 8: Nitinolowy koszyk bezkońcówkowy do przechwytywania i wydobywania złogów o śr 1,7 oraz 2,2 Fr i dł. 115 cm. Rozmiar koszyka 9-12 mm (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 46

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 46, poz. 9: Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, umożliwiający przechwycenie złogu i w razie potrzeby uwolnienie z mechanizmem otwierającym. Mechanizm powracający do pierwotnej postaci po odkształceniu. 4 drutowy, rozmiary: 1.5 FR/120 cm, 2,2 FR/120 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 47

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 50, poz. 1: Zestaw do drenażu przezskórnego składzie:

- a. Dobrze widoczny w RTG cewnik pigtail z poliuretanu o śr. 7 i 8 Fr i dł. 22-30 cm oraz tubą do prostowania cewnika,
- b. igła Chiba 18G/20cm,
- c. igła typu trokar 18G/20cm,
- d. metalowy obturator,
- e. 3 rozszerzadła,
- f. Prowadnica Lunderquist z igłą 0.038"
- g. Skalpel,
- h. Lejek oraz kranik Luer-Lock,
- i. Łącznik doworka,
- j. Worek poj. 2l,
- k. Kołnierz mocujący z opaską zaciskową

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 48

uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 53: Cewniki moczowodowe, cylindrycznie zamknięte wykonane z poliuretanu, skalowane co 1 cm, z mandrynem metalowym. Rozmiary 4, 5, 6, 7, 8 FR / 70cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 49

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 55 : Zestaw do cystostomii z silikonowym cewnikiem Foley z balonem o poj. 5ml i dł. 40cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 50

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 58, poz. 1: Cewnik Dufour, sterylny, rozmiary: 16 FR z balonem 40 ml, 18 FR z balonem 50ml, 20FR z balonem 60ml, 22FR z balonem 70ml, 24FR z balonem 80ml. Wykonany z silikonu 100%.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu, pod warunkiem, że zaferowane wyroby posiadają zastawkę uszczelniającą balon.

Pytanie 51

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 58, poz. 2: Cewnik Foley 3- drożny wykonany z silikonu 100% z balonem o poj. 30ml w rozm. 16-24Ch

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu, pod warunkiem, że zaferowane wyroby posiadają zastawkę uszczelniającą balon.

Pytanie 52

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 62: Cewnik PCV bez balonu-Tiemann, rozmiary CH8 –24, sterylny, pakowany pojedynczo, długość 400 mm, elastyczny PCV, odporny na załamania i skręcenia.

Odpowiedź:

Zamawiający w pytaniu zawarł opis asortymentu zgodny z SWZ.

Pytanie 53

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 65: Cewnik Foley 2-drożny wykonany z silikonu 100% z balonem o poj. 5-15ml w rozm. 16-24Ch i dł. 40cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 54

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 66: Sztywna prowadnica Lunderquista do PCNL 0,035” o dł. 80 cm (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 55

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 67: Zestaw do nefrostomii dwustopniowej jednorazowego użytku bez rozszerzadeł. Skład zestawu: igła dwuczęściowa ostrze typu chiba, widoczne w USG, prowadnica Schüllera o dł. 100 cm z zakończeniem typu J, cewnik z końcówką Pigtail bez balonu wykonany z poliuretanu, zakończenie typu Luer-Lock, dł. cewnika 22 cm, kranik z łącznikiem do worka na mocz, rozmiar 8 FR.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 56

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Część 67:Zestaw punkcyjny do nefrostomii metodą dwustopniową 8Ch/30cm; 9Ch/30cm: Cewnik poliuretanowy z pojedynczą pętlą, o wymiarach 8Ch/30cm,

Prowadnica ze sztywnym trzonem oraz giętką końcówką typu J, o wymiarach 0.038"/80cm,

Atraumatyczne poszerzadła w ilości 3 szt.

Igła punkcyjna dwuczęściowa typu trokar,

Igła do podania znieczulenia typu Chiba, wyposażona w echogeniczny znacznik, o wymiarach 18G/20cm,

Kranik jednokierunkowy z portem Luer-lock,

Łącznik do worka na mocz,

Dysk mocujący do przyszywania cewnika z opaską zaciskową,

Kołnierz prostujący,

Skalpel,

Worek na mocz."

Co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 57

Pakiet nr 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania taśm silikonowych o szerokości 2,4mm, reszta parametrów zgodna z SWZ. Wyrób pakowany pojedynczo co zapewnia użytkownikowi możliwość bardziej racjonalnego nim gospodarowania.

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 58

Pakiet nr 32

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania jednorazowego worka ekstrakcyjnego o pojemności 1540 ml o wymiarach 20cmx20cm, średnica narzędzia 10 cm. Worek wzmocniony z metalowymi rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w postaci otwartej.

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaferowanie „jednorazowego worka ekstrakcyjnego o pojemności 1540 ml o wymiarach 20 cmx20 cm. Worek wzmocniony z metalowymi rozkładanymi widelkami utrzymującymi go w postaci otwartej”. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ (formularza cenowego) w tym zakresie.

Pytanie 59

Pakiet 33

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania jednorazowego worka laparoskopowego o pojemności 1200 ml wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia. Obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 130 x 205 mm; przewodnik (tuleja) 10 mm x 223 mm; długość popychacza 250 mm

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zaferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 60

Pakiet nr 59

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia, że pistolet posiada trzy widoczne sprężyny umożliwiające odcięcie tkanki w 0,0012 sek., gdyż kwestie rozwiązań konstrukcyjnych nie są normowane zarówno polskimi jak i unijnymi normami technicznymi i o takich szczegółach producenci nie udzielają informacji.

Ponadto, chcemy wyjaśnić, że o skuteczności pistoletu decydują zupełnie inne parametry, a mianowicie:

- rodzaj użytej stali
- klasa dokładności, by nie powstawało zjawisko wibracji podczas wybiegu sztyletu oraz kaniuli
- zachowana optymalna proporcja pomiędzy średnicą sztyletu i kaniuli, dzięki czemu następuje poprawne ścięcie tkanki bez efektu jej strzępienia
- właściwie wykonany szlif łoży, w której pozyskiwany jest wycinek

Siła i szybkość strzału, niewątpliwie również mają na to wpływ, ale o tym nie decyduje ilość sprężyn, lecz ich jakość.

Ponadto, nie jest zrozumiałym, w jaki sposób dla skuteczności wykonanego zabiegu może się przyczynić korpus pistoletu wykonany z przeziernego tworzywa, bo tylko w ten sposób mogą być widoczne wewnątrz sprężyny.

Ponieważ powyższych parametrów Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować na podstawie deklaracji katalogowych, proponujemy zastosować kryterium oceny jakości, dzięki czemu Zamawiający będzie miał możliwość wyboru spośród złożonych ofert, produktu najwyższej jakości.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapis SWZ (Formularza cenowego) w tym zakresie. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 61

Zadanie nr 22 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego oryginalnego układu oddechowego o długości 1,8 m i pozostałych parametrach zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pozostałe wymagania zgodnie z ZWZ.

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ (Formularza cenowego) w tym zakresie.

Pytanie 62

Wzór umowy –zał. nr 2

§ 6 ust. 4

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktur z 60 do 30 dni?

Odpowiedź

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 63

§ 7 ust.1 i 2 lit.a

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2 %?

Odpowiedź

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 64

Część 38 poz. 1

Czy Zamawiający **dopuszcza jako równoważny** układ oddechowy w wersji sterylnej opakowanie folia-papier? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 65

Część 38 poz. 1

Czy Zamawiający **dopuszcza jako równoważny** układ oddechowy z rurą dodatkową o długości 90cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 66

Część 38 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych. W skład, którego wchodzi: maska z napompowanym mankietem, w rozmiarze Medium (odpowiadającym rozmiarowi 5), proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; rezerwuar tlenowy o objętości 2600 ml, przewód tlenowy; zastawka nadciśnieniowa 40cm H₂O, objętość worka 1510 ml. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, dodatkowo (jako oddzielna pozycja z oferty tego samego producenta) manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą liczbową lub kolorystyczną w zakresie 5-60 cm H₂O określającą właściwy poziom ciśnienia w drogach oddechowych podczas resuscytacji, dodatkowo (jako oddzielna pozycja z oferty tego samego producenta) zawór PEEP 1,5-20 cm H₂O?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 67

CZĘŚĆ 19.

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez Zamawiającego. Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzy zakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 68

CZĘŚĆ 19.

Prosimy o odstąpienie od wymogu numeru LOT na każdym ostrzu, w przypadku gdy informacja ta znajduje się na etykiecie opakowania zbiorczego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyrobu jak opisany w pytaniu. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 69

CZĘŚĆ 19.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności (wymóg dyrektywy MDR 2017/745) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności.

Pytanie 70

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 28 poz 1 łyżki jednorazowe do laryngoskopów firmy XXXX o następujących parametrach : w standardzie zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych. Dostępna w rozmiarach : Mac 0/dl 84mm , Mac 1/94mm, Mac2/103mm, Mac 3/132mm, Mac 4 /162mm, Mill 00/68mm, Mill 0/78mm, Mill1/105mm, Mill 2/158mm , Mill3/198mm, Mill4/208mm. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dającego mocne skupione światło. Wyraźne oznakowanie symbolu łyżki, i symbol "nie

do powtórnego użycia" (przekreślona cyfra 2). opakowanie przezroczyste, kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru łyżki.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 71

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 28 poz 2 jednorazowa rękojeść firmy XXX o następujących parametrach: kompatybilna z łyżką światłowodową w standardzie ISO 7376 (zielony standard), z wytrzymałego plastiku, z czterema poprzecznymi frezami, posiadająca trzy baterie AAA w zestawie, wraz żarówką LED, opakowanie indywidualnie folia folia. 20 szt w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 72

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 20 zestaw do konikotomii składający się z rurki do konikotomii, silikonowej przestrzeni martwej, skalpela, strzykawki jednorazowej i opaski szyjnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 73

Ad par.6 ust.5 wzoru umowy Prosimy o dopisanie uściślenia: Wykonawca zobowiązuje się, iż nie wstrzyma dostaw wyrobów będących przedmiotem niniejszej umowy w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone produkty, za wyjątkiem sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 74

Pakiet 1 poz. 1

Czy w związku z wycofaniem produktu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Strzykawki 50-60 ml, trzyczęściowa, do pomp infuzyjnych (Agilla), nazwa strzykawki wymieniona w instrukcji obsługi i menu pompy, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna; strzykawka powinna być wyposażona w czytelną i trwałą skalę, igłę aspiracyjną tempą (18 G 1, średnica1,2 długość 25 – 40 mm)?

Odpowiedź

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 75

Pakiet 1 poz. 1

Czy w związku z wycofaniem produktu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Strzykawki 50-60 ml, z przeznaczeniem do leków światłoczułych, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych (Agilla), nazwa strzykawki wymieniona w instrukcji obsługi i menu pompy, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna; strzykawka powinna być wyposażona w czytelną i trwałą skalę, igłę aspiracyjną tempą tempą (18 G 1, średnica 1,2 długość 25 – 40 mm)?

Odpowiedź:

dot. poz. 2 w Części 1:

Zamawiający w poz. 2 Części 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie „Strzykawki 50-60 ml, z przeznaczeniem do leków światłoczułych, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych (Agilla), nazwa strzykawki wymieniona w instrukcji obsługi i menu pompy, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna; strzykawka powinna być wyposażona w czytelną i trwałą skalę, igłę aspiracyjną tempą tempą (18 G 1, średnica 1,2 długość 25 – 40 mm)”. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 76

Pakiet 19:

Czy Zamawiający dopuści ostrza do strzygarki renomowanej firmy, nieruchome, gdzie LOT umieszczony jest na opakowaniu zbiorczym 50 szt.? Pozostałe parametry bez zmian.



Od XXXX 2022 r. spółka XXX Sp. z o.o. jest częścią XXXXX Sp. z o.o.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 77

Pytanie część 42

Czy zamawiający dopuści w części 42, Silikonowy cewnik Foleya z powłoką hydrożelową
Do użytku długoterminowego

(Czas przebywania cewnika w ciele pacjenta do 12 tygodni)

- Powłoka hydrożelowa zapewnia śliską powierzchnię cewnika

- Żebrowana konstrukcja pozwala zachować integralność balonu cewnika

Dostępne konfiguracje:

- Długość standardowa, żeńska i pediatryczna
- Rozmiary balonu 5 ml, 10 ml i and 30 ml
- Rozmiary Charriere/French 8 - 24
- Dwudrożne kanały cewnika

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 78

Pytanie część 58

Czy zamawiający dopuści w części 58 pozycja 1, Cewniki pooperacyjne lateksowe o wysokim module sztywności pokryte hydrożelem. Cewnik pooperacyjny Dufour dwudrożne, trójdrożne balon 30ml-50ml , 18-24Fr. Cewnik pooperacyjny Dufour dwudrożne, trójdrożne balon 60 ml lub 80ml , 18-24Fr. Balon ożebrowany w celu równomiernego rozłożenia ucisku na lożę po gruczołaku stercza.

Konstrukcja lateksowa o wysokim module sztywności ułatwia wprowadzenie cewnika i chroni przed zagięciem Powłoka hydrożelowa dla optymalnego komfortu pacjenta Zoptymalizowane światło drenażu maksymalne tempo przepływu i zapobieganie powstawaniu zatorów Liczne opcje końcówek i świateł umożliwiają dostosowanie do potrzeb wszystkich pacjentów Zagięta końcówka z gwizdkiem. Do odprowadzania dużych skrzepów i łatwiejszego przemieszczania w jamie prostaty. Oczko drenażowe w końcówce i dwa oczka powyżej balona.

Pakowane po 10 szt.

Odpowiedź

Zamawiający dopusci zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu pod warunkiem, że zaoferowany cewnik będzie posiadał zastawkę uszczelniającą balon.

Pytanie79

Pytanie część 58

Czy zamawiający dopuści w części 58 pozycja 3, Lateksowy cewnik Foley'a pokryty elastomerem silikonowym

Do użytku długoterminowego

(Czas przebywania cewnika w ciele pacjenta do 12 tygodni)

- Żebrowana konstrukcja pozwala zachować integralność balonu cewnika

Dostępne konfiguracje:

- Długość standardowa
- Rozmiary balonu 10 ml i and 30 ml
- Rozmiary Charriere/French 12 - 24

- Dwu- i trójdrożne kanały cewnika

Odpowiedź

Wykonawca zadaje pytanie do poz. 3 , która nie występuje w Części nr 58.

Pytanie 80

Pytanie część 63

Czy Zamawiający dopuści w części 63 pozycja 1, Lateksowy cewnik Foleya pokryty elastomerem silikonowym

Do użytku długoterminowego

(Czas przebywania cewnika w ciele pacjenta do 12 tygodni)

- Żebrowana konstrukcja pozwala zachować integralność balonu cewnika

Dostępne konfiguracje:

- Długość standardowa
- Rozmiary balonu 10 ml i and 30 ml
 - Rozmiary Charriere/French 12 - 24
 - Dwu- i trójdrożne kanały cewnika

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 81

Pytanie część 65

Czy Zamawiający dopuści w części 65 pozycja 1 Silikonowy cewnik Foleya z powłoką hydrożelową

Do użytku długoterminowego

(Czas przebywania cewnika w ciele pacjenta do 12 tygodni)

- Powłoka hydrożelowa zapewnia śliską powierzchnię cewnika
- Żebrowana konstrukcja pozwala zachować integralność balonu cewnika

Dostępne konfiguracje:

- Długość standardowa, żeńska i pediatryczna
- Rozmiary balonu 5 ml, 10 ml i and 30 ml
- Rozmiary Charriere/French 8 - 24
- Dwudrożne kanały cewnika

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 82

Część nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 83

Część nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz skalowane co 50ml od 25ml do 200ml i co 100ml od 200ml do 2000ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 84

Część nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, pod warunkiem, że w opakowaniu zbiorczym, każdy sterylny worek na mocz będzie znajdował się w opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 85

Część nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przewody tlenowe zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 86

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z wyłącznie z nazwą producenta, rozmiarem, średnicą cewnika i rozmiarem balonu bezpośrednio na cewniku na jednym z kanałów?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 87

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z informacją z jakiego jest wykonany potwierdzoną na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 88

Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z wyłącznie z nazwą producenta, rozmiarem, średnicą cewnika i rozmiarem balonu bezpośrednio na cewniku na jednym z kanałów?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 89

Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z informacją z jakiego jest wykonany potwierdzoną na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 90

Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z możliwością utrzymania do 7 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 91

Część nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wycenę igieł za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Wykonawca, który zaoferuje wycenę igieł w opakowaniach a'100 szt. w Formularzu cenowym zmieni jednostki miary na „opakowania”, wpisze wymaganą „ilość” w przeliczeniu na opakowania.

Pytanie 92

Część nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek wydzielin z oskrzeli o pojemności 10ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 93

Część nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek wydzielin z oskrzeli o pojemności 25ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu.
Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ (Formularza cenowego) w tym zakresie.

Pytanie 94

Część nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do pobierania próbek z kontrolą siły ssania czy bez?

Odpowiedź

Zamawiający **nie oczekuje** zestawu do pobierania próbek z kontrolą siły ssania.

Pytanie 95

Część nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 96

Część nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści znaczniki chirurgiczne silikonowe niebieskie, żółte, czerwone do wyboru Zamawiającego o szerokości 2,5mm, długości 40cm, pakowane po 2 nitki (sztuki) w saszetce?

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 97

Część nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę znaczników za opakowanie a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie 98

Część nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu jamy opłucnej z trokarem wyposażony w zintegrowany, uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu skalowany co 2cm, rozmiary 24Fr, 28Fr, 32Fr, 34Fr, 36Fr?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 99

Część nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon dostosowaną do połączenia z drenami o średnicach od 8CH do 16CH?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 100

Część nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren Redon pakowany w formie lekko zwiniętej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 101

Część nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren Redon z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, atraumatycznie, miękko zakończony?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie102

Część nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści marker zaklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa? Marker niższej klasy (klasa I sterylnej), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną, natomiast marker klasy IIa umożliwia dodatkowo kontakt z naruszoną skórą, co umożliwia stosowanie przy wyznaczaniu linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta. Takie rozwiązanie może przynieść jedynie korzyści Zamawiającemu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści (nie wymaga) zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 103

Część nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści marker ze skalą pomiarową do 5cm na korpusie markera oraz w komplecie z elastyczną linijką z podziałką co 1mm do 15cm, niedrażniący skóry atrament fioletowy, opakowanie foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu?


Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 104

Część 40

Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera. Pakowaną pojedynczo w torebkę papierowo-foliową bez etykiet samoprzylepnych?

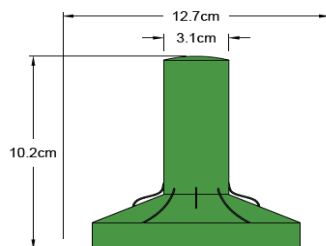

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie105

Część 43 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści płyn przeciw parowaniu optyki o następujących parametrach:

- specjalnie dobrana formuła płynu zapobiegająca parowaniu soczewek optycznych na bazie 7% alkoholu izopropylowego, (pojemnik 6 g)
- nie uszkodzi delikatnej powłoki szkła optycznego,
- każdy pojemnik posiada gąbkę która nie zarysuje soczewki, pojemnik (transparentna buteleczka) można otwierać jedną ręką za pomocą kciuka używając klapki korka (korek „niekapek” dający możliwość dozowania pojedynczych kropeł) lub odkręcając korek. Pojemnik Zamykany na zatyczkę w kolorze niebieskim przymocowaną do nakrętki.
- gąbka widoczna w promieniowaniu RTG,
- wystarczy kilka kropeł na gąbkę do przetarcia soczewki,
- możliwość przyklejenia gąbki do podłoża za pomocą taśmy samoprzylepnej,
- substancja bezwonna, nie zawiera związków kancerogennych,
- zestaw sterylny, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie106

Część 56 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki-zatyczki do cewników wykonane z tworzywa sztucznego (PVC)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 107

Część nr 58, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufor wykonany ze 100% silikonu w następujących rozmiarach:

- Rozmiar od CH18 do CH20, balon 50-80 ml,
- Rozmiar od CH22 do CH24, balon 80-100 ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu, pod warunkiem ,że zaoferowany cewnik posiada zastawkę uszczelniającą balon.

Pytanie 108

Część nr 63,64, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya wyłącznie z nazwą producenta, rozmiarem, średnicą cewnika i rozmiarem balonu bezpośrednio na cewniku na jednym z kanałów?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 109

Część nr 63,64, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z informacją z jakiego jest wykonany potwierdzoną na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 110

Część nr 63,64, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie – wewnętrzne folia (dwie perforacje poprzeczne na obu końcach opakowania), zewnętrzne papier/folia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Pytanie 111

Część nr 65, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley 100% silikon z balonem o pojemności 5-10ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź


Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Zamawiający modyfikuje SWZ (Formularz cenowy) w powyższym zakresie.

Pytanie112

Część nr 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopii i rektoskopii – podwójny (z dwoma kolcami), bez pułapki na pęcherzyki powietrza, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, o konstrukcji jak na zdjęciu?

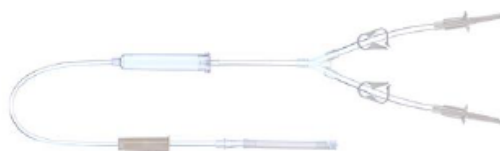

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 113

Część 71

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 96x96x130cm?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 114

Część 28, poz. 1

Czy Zamawiający zgadza się na łyżkę mikrobiologicznie czystą spakowaną w podwójną folię?

Odpowiedź

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie łyżki mikrobiologicznie czystej spakowanej w podwójną folię. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 115

Część 28, poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na rękojeść wykonaną ze stopu metali, wyfrezowaną, aby się nie wyślizgiwała?

Odpowiedź

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie rękojeści wykonanej ze stopu metali, wyfrezowaną, aby się nie wyślizgiwała. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 116

CZĘŚĆ 31 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki w rozmiarze 12x21cm?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 117

CZĘŚĆ 31 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki w rozmiarze 30x50cm?

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 118

Część 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków zawierających śladowe ilości ftalanów nie zagrażające życiu i zdrowiu pacjentów.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 119

Cześć 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worka z możliwością stosowania do 3 dni z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 120

Cześć 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worka z portem, z możliwością stosowania do 7 dni z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczy.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 121

Część 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o długości 550 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 122

Cześć 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do pobierania próbek wydzieliny z pojemnikiem o pojemności 25 ml.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 93. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 123

Cześć 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worka do pomiaru diurezy godzinowej o pojemności 2600 ml oraz komory pomiarowej 400 ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 124

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z gumową zastawką do napełniania balonu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 125

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z oznaczeniem na końcu zastawki do napełniania balonu rozmiarem, średnicą cewnika oraz pojemnością balonu?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** cewnik Foley z oznaczeniem informacji (wymaganych w SWZ) na końcu zastawki do napełniania balonu, tj. logo producenta, materiał z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika, rozmiar balonu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 126

Część nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 5-15ml?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 127

Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley wykonany w całości z silikonu?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 128

Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley ze sztywną zastawką wykonaną z silikonu?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 129

Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z oznaczeniem na końcu zastawki do napełniania balonu rozmiarem, średnicą cewnika oraz pojemnością balonu?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** cewnik Foley z oznaczeniem informacji (wymaganych w SWZ) na końcu zastawki do napełniania balonu, tj. logo producenta, materiał z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika, rozmiar balonu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 130

Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz „martwa przestrzeń” karbowaną wewnątrz i zewnętrznie, nierozciągliwa, bez zbrojenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu

Pytanie 131

Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz „martwa przestrzeń” ze złączem pacjenta 15F/22M i złączem od strony urządzenia 22F?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 132

Część nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz „martwa przestrzeń” ze złączem pacjenta 15F/22M i złączem od strony urządzenia 22F?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 133

Część nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Zawierający: jednoświatłowy dren łączący 120 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, posiada zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony plastikowym zabezpieczeniem, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 stopni bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z wieszakiem, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml. Możliwość podwieszania zestawu na min. 2 niezależne sposoby?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 134

Część nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści znaczniki chirurgiczne o długości 45cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 135

Część nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga wyceny za 1 sztukę znacznika czy za 1 komplet (2 szt.)?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę znacznika.

Pytanie 136

Część nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki jednorazowego użytku do laryngoskopii, światłowodowe typ Macintosh rozmiar od 3 do 5, z lekkiego metalu, bez refleksów świetlnych; światłowód zpolerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło, nieosłonięty, zatopiony w podstawie łyżki; podstawa łyżki z tworzywa sztucznego; zatrask kulkowy zapewniający stabilne połączenie łyżki z rękojeścią; wyraźne oznakowanie na łyżce typu i rozmiaru łyżki, nr seryjnego, symboli CE, pakowane foliowe, bez zawartości lateksu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 137

Część nr 28, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść posiadającą poprzeczne frezy (bez powłoki antypoślizgowej), które zapewniają pewny chwyt rękojeści?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 138

Część nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dwiema rurami o długości 180cm i średnicy 22mm i ramieniem dodatkowym gładkim wewnątrz o długości 120cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 139

Część nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pakowany w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 140

Część nr 38, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny resuscytator parametrach:

- Worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych
- wyrównujący siłę uciśnięć o poj.1650ml
- Rezerwuar tlenu 2000 ml
- Przewód do tlenu o długości 2,1 m
- Maski twarzowe z pompowanym mankietem w rozmiarze 5

- Zawór ciśnieniowy 60cmH₂O
- Obrotowy łącznik od strony pacjenta
- Całość zapakowana w jedno opakowanie?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 141

Część nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści marker z dwiema końcówkami 0,5mm i 1,0mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 142

Część nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści marker ze skalą na korpusie do 6cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 143

Część nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści marker z fioletowym roztworem gencjany?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 144

Część nr 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści marker sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 145

Część nr 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z gumową zastawką do napełniania balonu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 146

Część nr 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z oznaczeniem na końcu zastawki do napełniania balonu rozmiarem, średnicą cewnika oraz pojemnością balonu?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** cewnik Foley z oznaczeniem informacji (wymaganych w SWZ) na końcu zastawki do napełniania balonu, tj. logo producenta, materiał z jakiego wykonany jest cewnik,

rozmiar (CH), średnica zewnętrzna cewnika (mm), rozmiar balonu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 147

Część nr 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie: zewnętrznie papier-folia; wewnętrznie folia z 2 nacięciami (pionowe i poziome w górnej części)?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 148

Część nr 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 5-15ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 149

Część nr 64, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z gumową zastawką do napełniania balonu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 150

Część nr 64, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z oznaczeniem na końcu zastawki do napełniania balonu rozmiarem, średnicą cewnika oraz pojemnością balonu?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** cewnik Foley z oznaczeniem informacji (wymaganych w SWZ) na końcu zastawki do napełniania balonu, tj. logo producenta, materiał z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar (CH), średnica zewnętrzna cewnika (mm), rozmiar balonu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 151

Część nr 64, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley pakowany podwójnie: zewnętrznie papier-folia; wewnętrznie folia z 2 nacięciami (pionowe i poziome w górnej części)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 152

Część nr 64, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 5-15ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 153

Część nr 65, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości ok. 40cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 154

Część nr 65, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik z możliwością stosowania do 29 dni?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zamawiający modyfikuje SWZ i Formularz cenowy w tym zakresie.

Pytanie 155

Część nr 65, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik o pojemności balonu 5-15ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 156

Pakiet 1 i 2

Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z osobno pakowana igła iniekcyjną 2,1 x 40 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 157

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby worek posiadał filtr na przedniej ścianie worka, który zapobiega balonowaniu i pękaniu worków przez wytworzenie się zbyt dużego ciśnienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 158

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje płaskiego bezigłowego portu do pobierania próbek moczu, który zapobiega zakłuciom przez personel medyczny oraz zapewnia skuteczniejszą dezynfekcję portu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 159

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania Igły tępej z filtrem min. 5 µm do pobierania leków z ampułek szklanych, rozmiar min., 1,2x 40 mm i 1,2 x 50 mm – do wyboru Zamawiającego, co pozwala na efektywne pobieranie leku bez straty z pojemników wielodawkowych o różnej pojemności Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Bez lateksu i PCV.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 160

Pakiet 14

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w rozmiarze 8 Fr z igłą 19 G o długości 35 cm oraz z silikonową szpulką mocującą będącą odpowiednikiem kołnierza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu

Pytanie 161

Pakiet 14

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w rozmiarze 10 Fr z igłą 19 G o długości 35 cm oraz z silikonową szpulką mocującą będącą odpowiednikiem kołnierza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 162

Pakiet 16

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta zamawiający będzie w tej pozycji oczekiwał: Sterylny zestaw do pomiaru diurezy godzinowej. Dren dwuświatłowy długości 150 cm, łącznik do cewnika Foley z bezigłowym portem dostępu do pobierania próbek strzykawkami typu Luer i zastawką jednokierunkową chroniącą przed cofaniem się moczu do cewnika Foley. Dren na wejściu do komory pomiarowej zabezpieczony spiralą antyzałamaniową. Komora pomiarowa wyposażona w hydrofobowy filtr powietrza o minimalnej powierzchni 300 mm² oraz zawór umożliwiający spuszczenie moczu z komory do worka, z workiem zbiorczym na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkową zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do komory pomiarowej oraz zawór spustowy do opróżniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml. Zestaw wyposażony w elastyczne paski oraz okrągły hak do zawieszenia systemu przy łóżku pacjenta. Bez lateksu i DEHP.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 163

Pakiet 55

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii z cewnikiem w rozmiarach 8/11/14 Ch o długości 54 cm. W zestawach silikonowa tulejka mocująca umożliwiająca łatwiejsze przyszywanie cewnika.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 164

Pakiet 55

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii z cewnikiem o długości 40 cm z osobno pakowanym workiem na mocz.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 165

Pakiet 58

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta:

Poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour wykonanych z 100% silikonu, który zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych u pacjentów uczulonych na lateks z balonem 30-50 ml w rozmiarach 18-24 Ch.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 166

Pakiet 58

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta

Poz.1:

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour wykonanych z 100% silikonu pokrytego hydrożelem w rozmiarach 18-24 Ch z balonem 50-80 ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 167

Pakiet 58

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta

Poz.1:

3. Czy Zamawiający potwierdza, że cewnik powinien mieć zakończenie Dufour – czyli zaokrąglony, zamknięty koniec (umożliwiający założenie cewnika po mandrynie) z dużym owalnym otworem centralnym oraz dodatkowymi oczkami drenażowymi poniżej?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 168

Pakiet 58

Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley 3-drożnych z 100% silikonu z balonem 50 ml w rozmiarach 18-24 Ch.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 169

Pakiet 60

Prosimy o dopuszczenie: Igła cystoskopowa do iniekcji botoksu, w rozmiarze 22G 5CH, długość ostrza 4 mm z bezpiecznym ogranicznikiem wkłucia, długość całkowita 35 cm. Ostrze posiada nasadkę ochronną, redukującą uszkodzenie kanału roboczego. Produkt wyposażony w adapter typu Touhy Borst blokujący igłę w cystoskopie i ułatwiający pozycjonowanie jej. Do cystoskopu sztywnego. Produkt sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 170

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10 ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 171

Pakiet 7

Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw zawierał naklejkę z miejscem na opis?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aby zestaw zawierał naklejkę z miejscem na opis.

Pytanie 172

Część 1 poz1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z igłą w rozmiarze 2,0 x 30 mm

Odpowiedź

Zamawiającego **dopuszcza** zaoferowanie strzykawki z igłą w rozmiarze 2,0 x 30 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 173

Część 1 poz. 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki identyfikowalnej w menu pompy po nazwie na opakowaniu jednostkowym Braun Perfusor 50 ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wyrobu o parametrach jak w pytaniu.

Pytanie 174

Część 71

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusty trójkątnej wykonanej z włókniny

Odpowiedź

Zamawiającego **nie dopuści** chusty trójkątnej wykonanej z włókniny

Pytanie 175

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami producenta. Zamawiający nie precyzuje innych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 176

Pytania do części 21

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w części nr 21 zestawu do automatycznego wstrzykiwacza Optivantage, w skład którego wchodzi: wkład 200ml, łącznik oraz ostrze typu spike. Informujemy, iż ostrze typu spike oraz napełniacz typu J spełniają tę samą, równoważną funkcję - umożliwiają napełnienie strzykawki, stosowane są w pracowniach zamiennie. Dlatego też Wykonawca zwraca się z prośbą jak wyżej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści do zaoferowania wyrób o parametrach jak opisane w pytaniu, pod warunkiem, że łącznik (opisany w pytaniu) jest drenem łączącym pacjenta z wstrzykiwaczem.

Pytanie 177

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca pozostanie w zwłoce z dostawą zamówionych wyrobów w terminie określonym w § 4 ust. 2 lub pozostanie w zwłoce z dostarczeniem produktu wolnego od wad w terminie określonym w § 9 ust. 4, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej lub wadliwej części dostawy za każdy dzień zwłoki., **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej lub wadliwej części dostawy**

2. (...) W sytuacji opisanej powyżej Wykonawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu produktu objętego zakupem interwencyjnym natomiast będzie zobowiązany do:
a) zapłaty kary umownej w wysokości **2,5 %** wartości niezrealizowanej dostawy brutto w pakiecie, w którym zakup interwencyjny wstąpił, lub (...).

Odpowiedź

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 178

Część 2,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości. Wykonawca, który zaoferuje worki na mocz w opakowaniach po 10 szt. w Formularzu cenowym zmieni jednostki miary na „opakowania”, wpisze wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania.

Pytanie 179

Część 71

Czy zamawiający dopuści wymiar 136x96x96cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobu o parametrach jak opisane w pytaniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Uwaga Wykonawcy:

W przypadku oferowania rozwiązań (parametrów) dopuszczonych przez Zamawiającego w wyniku odpowiedzi na pytania, Wykonawca ma obowiązek opisać w Formularzu cenowym oferowane rozwiązanie (parametry) z zaznaczeniem, nr odpowiedzi na pytanie, które dopuszczają zaoferowane rozwiązanie (parametry).

Sporządziła w imieniu Komisji przetargowej:

Maria Mielniczek

**Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie
dr hab. n. med. Grzegorz Kade
/podpis na oryginale/**